

PERIPHERAL
VASCULAR



NiTIDES

Amphilimus™(Sirolimus + Fatty Acid)
eluting Peripheral Self-Expanding stent

abluminal
reservoir
technology

Manufactured by: CiD S.p.A.

Strada per Crescentino, sn - 13040 Saluggia (VC), Italy

CiD S.p.A. member of Alvimedica Group

www.alvimedica.com



0373




IQ0740.137.101 Issued 202105 Rev.0


NiTIDES

Amphilimus™(Sirolimus + Fatty Acid)
eluting Peripheral Self-Expanding stent


FIGURE 1

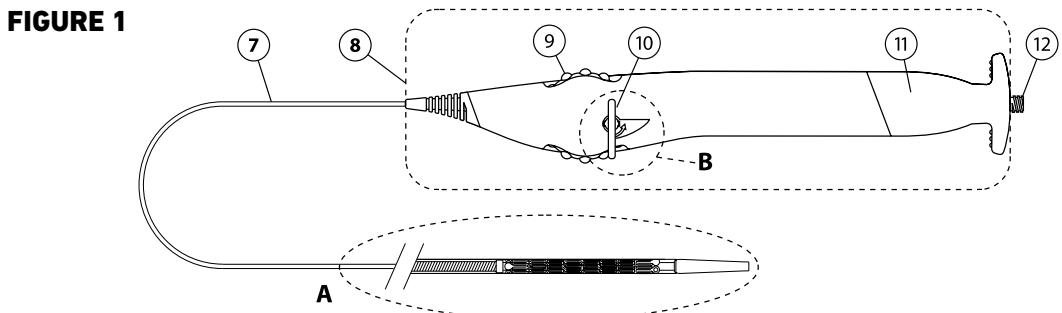

A

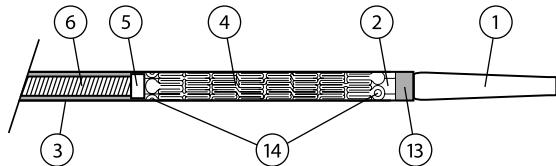

B

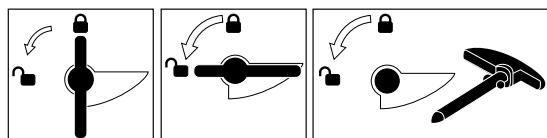

Locked system


Step 1
Unlock the key

Step 2
Extract the key. Ready to release


1	Radiopaque tip
2	Guide wire lumen
3	Outer Sheath
4	Stent
5	Stent stopper
6	Coil
7	Catheter body
8	Handle
9	Thumbwheel
10	Security key (detail B: instruction for use)
11	Pull back
12	Luer hub
13	Radiopaque marker of the sheath
14	Radiopaque markers of the stent

HOW TO UNLOCK THE SYSTEM

Step 1

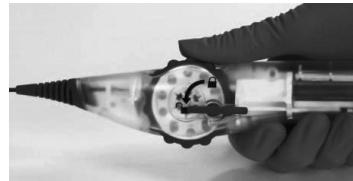


Step 2

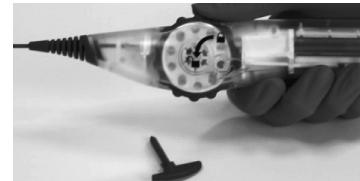


DEPLOYMENT OF THE STENT

Turn thumbwheel

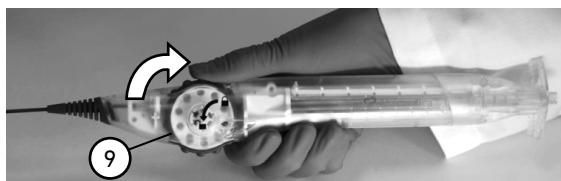

Optional quick release

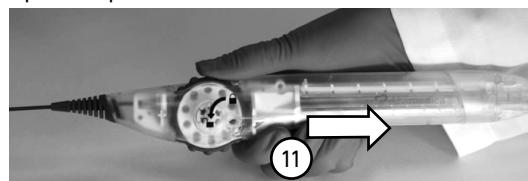

English	2
Français	4
Deutsch	7
Italiano	9
Español	12
Dansk	14
Português	17
Suomi	19
Svenska	22
Nederlands	24
Ελληνικά	27
Türkçe	29
Česky	31
Eesti	34
Magyar	36
Latviski	38
Lietuvių kalba	41
Slovenčina	43
Slovenština	45
Norsk	48
Македонски	50
Srpski	53
Hrvatski	55
Română	58
Polski	60
Български	63
Русский	65
简体中文	68
Bahasa Indonesia	70
Український	72

ENGLISH

NiTIDES

Carbofilm™-coated self-expanding Amphilius™ (Sirolimus+fatty acid) eluting peripheral stent system

1. DEVICE DESCRIPTION

The NiTiDES device family is composed of a self-expanding stent and a delivery system for its correct placement and deployment.

The **stent** is a flexible, self-expanding implantable device. It is made of Nickel and Titanium alloy (Nitinol) and coated with *Carbofilm™*, a thin layer of carbon with a high-density turbostratic structure substantially identical to that of the pyrolytic carbon.

Coating the substrate provides it with the biocompatible and haemocompatible characteristics of pyrolytic carbon, without affecting the physical and structural properties of the substrate itself.

Six radiopaque tantalum markers are applied to the stent (three at each end) to enable correct placement at the site of the target lesion.

The outer surface of the stent has dedicated grooves, fully coated with *Carbofilm™*, for containing the pharmaceutical formulation Amphilius™, which is composed of the drug Sirolimus and a mixture of long-chain fatty acids.

The specific drug dosage for the vessel surface treated is approximately 0.9 µg/mm², which corresponds to a minimum dose of 270 µg on the smaller stent (6.0x20 mm) and a maximum dose of 2420 µg on the larger stent (8.0x150 mm).

The **delivery system** utilized is an over-the-wire type, ensuring that the stent can be positioned and released safely at the lesion. It is shown schematically in Figure 1 and consists of:

- a catheter body (7) 6F in diameter composed of:
 - a retractable outer sheath, the distal, semi-transparent section (3) which contains the stent (4); the sheath has a radiopaque collar (13) near the tip of the catheter;
 - an inner lumen comprising a coil (6) and an inner tube (2) compatible with a 0.035 inch guidewire; the inner lumen extends along the catheter from a luer fitting (12) secured proximally to the handle and terminates distally at the tip (1) in radiopaque material, so as to facilitate the location and placement of the stent when viewed on an imaging system. A stopper (5) integral with the inner lumen prevents axial displacement of the stent during retraction of the outer sheath;
- a handle (8) with a delivery system, which allows the positioning of the catheter and the deployment of the stent *in situ*.

The handle has an ergonomic design allows the operator to grasp it and use it even with one hand. It has a luer port (12) at the proximal end, which is used to flush the guidewire lumen, a safety key (10), a wheel (9) and a pullback tail (11).

The Manufacturer manufactures the peripheral stent + deployment catheter system directly and implements all quality control procedures both during production and on the finished products in accordance with Good Manufacturing Practice guidelines.

2. INTENDED USE OF THE DEVICE

The self-expanding peripheral stent system is intended for the treatment of the Peripheral Artery Disease affecting the superficial femoral artery and the proximal popliteal artery.

3. INDICATION OF THE DEVICE

The device is indicated for the treatment of stenosis of femoropopliteal arteries above-the-knee in adult symptomatic [Rutherford category 2-5] patients. The treated lesion, of maximum length of 14 centimeters, must be either occluded or with stenosis higher than 50%, de-novo or restenotic, not previously treated with a stent.

4. CONTRAINDICATIONS

Use of the stent is contraindicated in the following situations:

- Lesions considered untreatable with PTA or other interventional techniques.
- Women who are pregnant, breastfeeding.
- Lesions localized in the two distal thirds of the popliteal artery or at the knee joint.
- Clinical conditions that impede the use of anti-platelet and/or anticoagulant therapy.

5. WARNINGS

- The use of the device is not recommended in patients with known hypersensitivity or allergies to Sirolimus, fatty acids (such as stearic acid, palmitic acid, behenic acid) or the metal components of the stent (such as Nickel, Titanium and Tantalum).
- The device is intended for single use only. Do not reuse, reprocess or sterilise. This could cause contamination risks of the device and/or infections to the patient, inflammation and patient-to-patient transmission of infective diseases.
- The device is designed to perform as a system. Do not use its components separately.
- Do not use the device if its packaging has been opened or damaged, incorrectly stored, or if it is past the stated expiry date. In such cases product sterility is not guaranteed.
- The device should be used only by physicians trained specifically to perform percutaneous transluminal angioplasty (PTA) and peripheral stent implantation.
- If resistance is encountered at any stage of the procedure, do not force the system: withdraw the stent system and the entire delivery catheter, the guidewire and the introducer as a single unit. Applying excessive force and/or incorrect handling may result in the stent being accidentally deployed or in damage to the placement catheter.
- At any time during operation, incorrect handling could cause dissection, perforation or rupture of the vessel.

- Do not advance or withdraw the stent system during deployment: it may cause serious damage to vessel walls.
- The implantation of a self-expanding peripheral stent can cause dissection of the vessel distally and/or proximally to the stent and could also cause acute blockage of the vessel, making an additional operation necessary (surgical vascular replacement operation, further dilatation, deployment of additional stents or other procedures).
- Once the stent has been partly deployed, it cannot be retrieved using the delivery system.

6. PRECAUTIONS

- Never use the quick-release system at the start of stent expansion. Use it only if necessary, after releasing at least half the length of the stent.
- The device should be carefully handled so as to avoid any contact with metallic or abrasive instruments that could damage it or produce mechanical alterations.
- The device should not come into contact with liquids prior to preparation and positioning.
- The device's placement system is not intended for use with contrast medium injectors.
- Where stents are implanted in tandem, the relative radiopaque markers should overlap. Overlap should not involve more than two stents.
- In case of overlapping stents, less than 20 mm overlapping length is recommended.
- To avoid damaging the stent, use extreme care whenever passing a guidewire or a balloon catheter or another device through the stent that has been deployed.

7. MRI SAFETY INFORMATION

Non-clinical testing has demonstrated that the manufacturer's Nitinol stent product lines are MR Conditional. A patient with this device can be safely scanned in an MR system meeting the following conditions:

- Static magnetic field of 1.5-Tesla (1.5T) or 3-Tesla (3T)
- Maximum spatial field gradient of 6,140 G/cm (61.40 T/m)
- Maximum MR system reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of:
 - 1 W/kg (Normal Operating Mode) at 1.5T
 - 1 W/kg (Normal Operating Mode) at 3T

RF Heating

Under the scan conditions defined above, the manufacturer's Nitinol stent product lines are expected to produce a maximum temperature rise of less than 6.8 °C after 15 minutes of continuous scanning at an MR system reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 1.0 W/kg.

1.5 T	3 T
<i>Single Stent Configuration</i> Highest temperature change	≤ 6.3 °C ≤ 6.2 °C
<i>Overlapping Stent Configuration</i> Highest temperature change	≤ 6.8 °C ≤ 6.3 °C

MR Artifact

In non-clinical testing, the image artifact caused by the device extends approximately 0.7 cm from the manufacturer's Nitinol stents when imaged with gradient-echo and spin echo pulse sequences in a 3T MRI system.

8. HOW SUPPLIED

The NiTiDES device is supplied sterile (using an ethylene oxide and CO₂ mixture), for single use, wrapped in two pouches that must not be brought into a sterile area. **NOTE: the inner pouch is the only sterile barrier.**

Sterility and chemical stability are guaranteed while the package remains intact and until the expiry date printed on the packaging (USE BEFORE DATE).

Contents: one (1) *Carbofilm™-coated self-expanding Amphilius™* (Sirolimus+fatty acid) eluting peripheral stent system

9. STORAGE

The product should be stored as indicated on the packaging, in a cool and dry place, with storage temperature max 25 °C.

10. MODELS

The NiTiDES device is identified by a model code and a lot number; available product codes are listed in Table 1.

11. DRUG REGIME

Studies in clinical literature indicate the need to administer pre-operation anti-platelet therapy, anticoagulant therapy during the procedure and post-operation anti-platelet treatment.

Antiplatelet treatment during the period after the procedure involves the administration of:

- Thienopyridines (Ticlopidine or Clopidogrel or Prasugrel in the doses indicated in the respective instruction booklets or according to medical prescription)
- Aspirin at a minimum amount of 100 mg/day indefinitely

Given the complexity of the procedure and the many factors influencing patient condition, definition of the appropriate therapy is left to the discretion of the physician.

12. INTERACTIONS WITH DRUGS

Although no specific clinical data are available, certain drugs, such as Tacrolimus, which act through the same binding protein (FKBP), may interfere with the efficacy of Sirolimus. Sirolimus is metabolized by CYP3A4. Strong CYP3A4 inhibitors may cause increased exposure to Sirolimus, especially in the case of multiple implant. Systemic exposure to Sirolimus if the patient is taking concomitant systemic immunosuppressive drugs must also be considered.

13.CLINICAL TRIAL WITH NITIDES

Principal safety and effectiveness of NITIDES stent have been established from the pre-market pivotal clinical trial ILLUMINA.

Design of the study: Within a multicenter, single arm study, 100 patients with symptomatic femoropopliteal disease with a maximum lesion length of 14cm were treated with the NITIDES stent. The primary efficacy (primary patency) and primary safety endpoint (a composite of major adverse events: death, target limb amputation, target limb ischemia requiring surgical intervention or surgical repair of target vessel or clinically driven target lesion revascularization, worsening of the Rutherford score by 2 classes, or to class 5 or 6) were compared to an Objective Performance Goal (OPG) at 12 months.

Results: Procedural success was obtained in 100%.

Results for Doppler ultrasound show primary patency of 87% (77/89, 95% confidence interval 80-94), meeting the requirements of the OPG (73%). 24-months primary patency was 81% (63/78).

The 12-month primary safety endpoint was 96.8% (90/93), meeting the requirements of the OPG (19.6%, 2.2% (2/93) of patients had clinically driven target lesion revascularization, 1.1% (1/93) died, 0 had target limb amputation, 0 had target limb ischemia requiring surgical intervention or surgical repair of the target vessel and 0 had worsening of the Rutherford score by two classes, or class 5 and 6.

The 24-month safety endpoint was 87.8% (79/90). 6.7% (6/90) of patients had clinically driven target lesion revascularization, 3.3% (3/90) died, 0 had target limb amputation, 1.1% (1/90) had target limb ischemia requiring surgical intervention or surgical repair of the target vessel and 1.1% (1/90) had worsening of the Rutherford score by two classes, or class 5 and 6.

14.DIRECTIONS FOR USE

Selection of the device

Refer to the length of the target lesion to establish the length of stent required. In order to appropriately cover the lesion, the deployed stent length should be at least 5 mm longer than the lesion itself on either side.

Refer to the diameter of the vessel proximally and distally of the lesion to establish the appropriate stent size. To ensure a secure placement of the stent, use the larger diameter as the basis for choosing the appropriate stent size. When selecting the model, refer to the information listed in table 1.

Preparing the device

Prior to stent delivery, administer heparin and check that the patient's Activated Clotting Time (ACT) is adequate in conformity with the practice of the Centre.

During preparation of the system, take special care not to let any liquid come into contact with the stent.

- a) Open the box and take out the bag containing the sterile pouch.
- b) After examining the package for any damage, open the external non-sterile aluminium foil pouch then remove the content from the internal pouch. (Note: The aluminium foil pouch and the outer surface of the inner plastic pouch **ARE NOT STERILE**. Only the contents of the plastic pouch are STERILE).
- c) Taking care to place the support on a flat surface in a sterile area, unfasten the band around the handle and remove the catheter from the protective coil.
- d) Check that the delivery catheter does not present kinks, bends or other damage. Damage to the device may impair its performance.
- e) Fill a 3 mL syringe with a physiological solution containing heparin, connect to the luer fitting for flushing (figure 1, item 12) and apply positive pressure. Continue flushing until the physiological solution emerges from the distal end of the catheter.
- f) Inspect the distal end of the catheter, making certain that the stent (figure 1, item 4) is covered completely by the outer sheath.

Do not use the device if damaged or if the stent is partially expanded.

Compatibility with accessories

Introducer sheaths of diameter 6F (2.0 mm) or greater can be used with the NiTiDES device.

Guidewires of 0.035 inches (0.89 mm) or less can be used with the NiTiDES devices. The choice of guidewire stiffness and tip configuration will depend on the physician's clinical experience.

Should it be necessary to utilize a guiding catheter, systems are compatible with guiding catheters of diameter 8F (2.7 mm) or greater. In this instance, make certain that the haemostatic valve is fully open before introducing the selected assembly.

Stent insertion

- a) Make sure the safety key (figure 1, item 10) of the handle is in the locked position (detail B).
- b) Wash the exposed portion of the guidewire with a physiological solution containing heparin, to remove traces of blood and contrast medium.
- c) Advance the system over the guidewire until the stent reaches the treatment site. If unusual resistance is encountered at any time, do not force the system: withdraw the introducer, the guidewire and the device together as a single unit. Applying excessive force and/or incorrect handling may result in the stent being accidentally deployed or in damage to the placement catheter.

Advancing the device

- a) Advance the system to the point at which the stent is beyond the lesion.
- b) Draw the system back until the stent is in alignment with the lesion.
- c) Check that the part of the delivery system outside the body of the patient is freely extended and straight.

Caution: if the delivery system is not properly extended, the stent could be deployed beyond the target lesion.

Stent implantation and expansion

- a) Firmly grasping the handle with one hand, check that the radiopaque markers on the stent are positioned proximally and distally in relation to the lesion.
- b) Make certain that the introducer sheath does not move during deployment of the stent.

- c) Turn the safety key on the handle anticlockwise (figure 1, detail B) to unlock it (STEP 1), then pull it out completely (STEP 2).
- d) Holding the handle in a fixed position with respect to the patient, check once again that the radiopaque markers are in the desired position with respect to the lesion; begin deploying the stent by turning the wheel (figure 1, item 9) with your thumb in the direction of the arrow, as shown in figure 1.
- e) Under fluoroscopy, when the distal end of the stent is well-attached to the vessel walls, continue deployment by turning the wheel until the end of the stent is opened and it is completely implanted in the vessel walls.
- f) If rapid deployment is required, proceed as follows: make sure that there are no obstructions (e.g. female luer fitting screwed) in the rear end of the handle, grasp the rear end of the device (pull-back, figure 1, item 11) with your other hand and pull it, holding the front part of the handle with respect to the patient perfectly still, as shown in figure 1.
- g) Check fluoroscopically that the stent has fully expanded.
- h) The stent can be expanded further, if necessary, using a PTA balloon catheter. In selecting the diameter of the balloon catheter and in performing the post-expansion, please refer to the diameter of the vessel that has been evaluated by means of angiography. In any event, take particular care not to expand the stent beyond its nominal diameter, stated on the label.
- i) The final diameter of the stent must be suitable for the reference vessel diameter.

15.POTENTIAL ADVERSE EVENTS

The possible adverse events that may be associated with the implantation of a peripheral stent include risks related to percutaneous transluminal angioplasty and additional risks associated with the use of stents, as indicated below.

- Access-site infection, pain and haematoma
- Allergic or adverse reaction to contrast medium, drugs used during the procedure or materials composing the stent
- Arterial spasm
- Arterial or stent thrombosis
- Femoral arterial aneurysm or pseudoaneurysm
- Atherosclerotic distal embolization
- Bleeding
- Death
- Dissection, perforation or rupture of the stented vessel
- Embolism
- Kidney failure
- Lower limb ischemia (requiring surgical intervention)
- Restenosis of the artery in which the stent was implanted
- Stent embolization
- Vessel occlusion or unresolved stenosis

16.LIABILITY AND WARRANTY

The Manufacturer ensures that the device has been designed, manufactured and packaged with every care using the techniques deemed most suitable among those available at the current state of technology and applying principles of integration of safety in design and construction to ensure safe use when it is used under the conditions and for the intended purposes respecting the precautions indicated in the previous paragraphs, and in any case aimed at reducing as far as possible, but not totally eliminating, the risks related to the use of the device. The device must be exclusively used under the responsibility of specialized medical personnel and taking into account the residual risks and possible side effects and complications of the therapy for which it was intended, including those mentioned in the other sections of this instruction booklet.

The technical complexity and the critical nature of medical choices and methods of application of the device exclude any guarantee of the Manufacturer, explicit or implicit, on the effectiveness of the result following the use of the device, or on its effectiveness in resolving a state of disability, or any other pathology or medical problem. In fact, the results, both from the clinical point of view and in terms of functionality and duration of the device, also depend on numerous factors that are beyond the control of the manufacturer, among which are cited merely as examples and not exhaustive conditions of the patient, the surgical procedure of implantation or use, the methods of manipulation of the device after opening the package.

In light of these factors the manufacturer's liability exists only if it has been ascertained that the device was affected by defects at the time it was put into circulation. For this purpose, the Customer must promptly place the device at the disposal of the Manufacturer, in compliance with the terms of expiry and prescription required by law; the Manufacturer reserves the right to examine the device deemed to be faulty and to establish if it is actually affected by defects that may affect the safety of the product. The manufacturer's liability is excluded if (i) the defect claimed is due to the compliance of the device with a mandatory rule or a binding provision, and / or (ii) the defect that caused the damage did not exist when the Manufacturer released the device and / or (iii) if the state of technical and scientific knowledge at the time the Manufacturer release the device, did not yet allow the device to be considered as defective, and / or (iv) in any other case, also different from those stated above, in which the law expressly excludes, or limits, the responsibility of the Manufacturer for damage from defective products. The guarantee consists exclusively in the replacement of the defective device with another of the same or equivalent type of manufacture of the manufacturer. The warranty applies only if the device is correctly returned to the manufacturer together with a written and detailed report on the claimed defects and, in the case of an implanted device, on the reasons for removal from the patient. The claimed defects must be promptly reported to the Manufacturer in compliance with the terms of forfeiture and statutory prescription.

Once the replacement has been made, the Manufacturer will reimburse the Customer for the expenses incurred by him for the return of the recognized faulty device.

The Manufacturer declines all responsibility in any case of non-observance of the methods of use and of the precautions indicated in this instruction manual and in the case of use after the expiry date indicated on the package.

Furthermore, the Manufacturer declines all responsibility for the consequences of medical choices and the methods of use or application of the device and therefore will not under any circumstances be prosecuted for any material, biological or moral damage of any kind, consequent to the application of the device and to the choice of the implant technique used by the operator.

The agents and representatives of the Manufacturer are not authorized to modify any of the aforementioned conditions nor to make any additional commitment or to make any warranty in relation to this product, other than as indicated above. This warranty is governed by Italian law, unless the mandatory laws of another state are applied, in case the Manufacturer has authorized the circulation of the product in one or more states other than Italy.

FRANÇAIS

NITIDES Stent périphérique auto-expansile à élution Amphilimus™ (Sirolimus+acide gras), recouvert d'Carbofilm™

1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

La gamme de dispositifs NITIDES est composée d'un stent auto-expansile et d'un système de pose destiné à la pose et au déploiement corrects du stent.

Le **stent** est un dispositif implantable auto-expansile et souple. Il est composé d'un alliage de nickel et titane (Nitinol) recouvert d'Carbofilm™, fine couche de carbone dont la structure turbostratique haute densité est en grande partie identique à celle du pyrocarbone.

Le revêtement du substrat lui confère les caractéristiques biocompatibles et hémocompatibles du pyrocarbone, sans affecter les propriétés physiques et structurelles du substrat.

Six repères radio-opaques en tantale sont appliqués sur le stent (trois à chaque extrémité) pour faciliter la pose sur le site de la lésion à traiter.

La surface externe du stent présente des rainures spéciales, entièrement recouvertes d'Carbofilm™, destinées à contenir la formule pharmaceutique Amphilimus™ composée du médicament Sirolimus et d'un mélange d'acides gras à longue chaîne.

Le dosage médicamenteux spécifique de la surface vasculaire traitée est d'environ 0,9 µg/mm², ce qui correspond à une dose minimum de 270 µg sur le stent le plus petit (6,0 x 20 mm) et à une dose maximum de 2 420 µg sur le stent le plus grand (8,0 x 150 mm).

Le **système de pose** utilisé est de type « over-the-wire », ce qui garantit un positionnement et un largage du stent en toute sécurité au niveau de la lésion. Ce système est représenté schématiquement sur la Figure 1 et consiste en :

- un corps de cathéter (7) de diamètre 6F comprenant :
 - une gaine rétractable, dont la partie distale semi-transparente (3) contient le stent (4) ; la gaine est munie d'un collier radio-opaque (13) à proximité de l'embout du cathéter ;
 - une lumière interne formée d'une spirale (6) et un tube interne (2) dans lequel un fil-guide de 0,035 pouces peut passer ; la lumière interne s'étend le long du cathéter en partant d'un raccord Luer (12) fixé proximalement par rapport à la poignée et se termine distalement au niveau de l'embout (1) en matériau radio-opaque, de façon à faciliter la localisation et la pose du stent lorsqu'il est visualisé sur un système d'imagerie. Un arrêt (5), faisant partie intégrante de la lumière interne, prévient tout déplacement axial du stent lors de la rétraction de la gaine ;
- une poignée (8) équipée d'un système de pose intégré, qui permet de positionner le cathéter et de déployer le stent *in situ*.

La conception ergonomique de la poignée permet à l'utilisateur de la prendre et de l'utiliser d'une seule main. Elle est munie d'un raccord Luer (12) à l'extrémité distale, qui permet de rincer la lumière du fil-guide, d'une clavette de sécurité (10), d'une molette (9) et d'un manche rétractable (11).

Le fabricant produit directement le système stent périphérique + cathéter de déploiement et applique toutes les procédures de contrôle de la qualité lors de la production et sur les produits finis, conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

2. UTILISATION PRÉVUE DU DISPOSITIF

Le système de stent périphérique auto-expansile est indiqué pour traiter la maladie artérielle périphérique (MAP) touchant l'artère fémorale superficielle et l'artère poplitée proximale.

3. INDICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif est indiqué pour traiter les sténoses des artères fémoro-poplitées au-dessus du genou chez les patients adultes symptomatiques [catégorie Rutherford 2-5]. La lésion traitée, d'une longueur maximale de 14 centimètres, doit être soit rétrécie, soit sténosée de plus de 50 %, de novo ou de resténose, et ne doit pas avoir été traitée antérieurement avec un stent.

4. CONTRE-INDICATIONS

L'usage du stent est contre-indiqué dans les situations suivantes :

- Lésions ne pouvant pas être traitées par ATP ou par d'autres techniques opératoires.
- Femmes enceintes, qui allaient.
- Lésions localisées sur les deux tiers distaux de l'artère poplitée ou au niveau de l'articulation du genou.
- États cliniques empêchant l'usage de traitements antiplaquettaires et/ou anticoagulants.

5. AVERTISSEMENTS

- L'utilisation du dispositif n'est pas recommandée chez les patients ayant une hypersensibilité ou une allergie connue au Sirolimus, aux acides gras (dont acide stéarique, acide palmitique, acide behénique) ou aux composants métalliques du stent (nickel, titane et tantale).
- Il s'agit d'un dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser, retraiter ou stériliser à nouveau. Ceci pourrait causer des risques de contamination du dispositif et/ou d'infection du patient, d'inflammation et de transmission de maladies infectieuses de patient à patient.
- Le dispositif est conçu pour être utilisé comme un système. Ne pas utiliser ses composants séparément.
- Ne pas utiliser le dispositif si son emballage a été ouvert ou endommagé, mal conservé, ou si sa date de péremption est dépassée. Dans ce cas, la stérilité du produit n'est pas garantie.
- Le dispositif ne doit être utilisé que par des médecins spécialistes de l'angioplastie transluminale percutanée (ATP) et de l'implantation de stents périphériques.

- En cas de résistance à tout stade de la procédure, ne pas forcer sur le système : retirer comme un seul élément le système de stent et la totalité du cathéter de pose, le fil-guide et l'introducteur. Une force excessive et/ou une mauvaise manipulation peuvent provoquer un déploiement accidentel du stent ou endommager le cathéter de pose.
- À tout moment au cours de l'opération, une mauvaise manipulation pourrait provoquer une dissection, une perforation ou une rupture du vaisseau.
- Ne pas faire avancer ni retirer le système de stent pendant le déploiement : cela pourrait provoquer de graves lésions aux parois vasculaires.
- L'implantation d'un stent périphérique auto-expansile peut provoquer la dissection du vaisseau distal et/ou proximal au stent et pourrait également entraîner une occlusion soudaine du vaisseau, qui nécessiterait une intervention supplémentaire (chirurgie de remplacement vasculaire, nouvelle dilatation, déploiement d'autres stents, ou autres procédures).
- Une fois le stent partiellement déployé, il ne peut pas être récupéré au moyen du système de pose.

6. PRÉCAUTIONS

- Ne jamais utiliser le système de pose rapide au début du déploiement du stent.** Ne l'utiliser qu'en cas de nécessité, après avoir libéré au moins la moitié de la longueur du stent.
- Le dispositif doit être manipulé avec précaution pour éviter tout contact avec des instruments métalliques ou abrasifs qui pourraient l'endommager ou causer des altérations mécaniques.
- Avant sa préparation et sa pose, le dispositif ne doit pas entrer en contact avec des liquides.
- Le système de mise en place du dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des injecteurs de produit de contraste.
- Si les stents sont implantés en tandem, les repères radio-opaques correspondants doivent se chevaucher. Il ne faut pas que plus de deux stents se chevauchent.
- Si des stents se chevauchent, une longueur de chevauchement inférieure à 20 mm est recommandée.
- Pour ne pas endommager le stent, faire extrêmement attention lors du passage du fil-guide ou du cathéter à ballonnet ou de tout autre dispositif à travers le stent qui vient juste d'être déployé.

7. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'IRM

Des essais non cliniques ont démontré que les gammes de stents au Nitinol du fabricant sont classées compatibles avec la résonance magnétique sous conditions. Les patients porteurs de ce dispositif peuvent être soumis en toute sécurité à des procédures IRM réalisées sur un système satisfaisant aux conditions suivantes :

- Champ magnétique statique de 1,5 Tesla (1,5 T) ou 3 Tesla (3 T)
- Gradient de champ magnétique spatial maximal de 6 140 G/cm (61,40 T/m)
- Système RM maximal indiqué, SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) moyen du corps tout entier de :

 - 1 W/kg (mode de fonctionnement normal) à 1,5 T
 - 1 W/kg (mode de fonctionnement normal) à 3 T

Échauffement par RF

Dans les conditions d'examen définies ci-dessus, les gammes de stents au Nitinol du fabricant doivent produire une élévation maximale de température inférieure à 6,8 °C après 15 minutes d'imagerie continue dans un système IRM indiqué, SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) moyen du corps tout entier de 1,0 W/kg.

	1,5 T	3 T
<i>Configuration avec un seul stent</i>		
Variation de température maximale	$\leq 6,3^{\circ}\text{C}$	$\leq 6,2^{\circ}\text{C}$
<i>Configuration avec chevauchement de stents</i>		
Variation de température maximale	$\leq 6,8^{\circ}\text{C}$	$\leq 6,3^{\circ}\text{C}$

Artéfact d'IRM

Dans des essais non cliniques, l'artefact d'image causé par le dispositif s'étend sur environ 0,7 cm des stents au Nitinol du fabricant avec des séquences d'impulsions en écho de gradient et de spin dans un système IRM de 3 T.

8. CONDITIONNEMENT

Le dispositif est fourni stérile (stérilisation par mélange d'oxyde d'éthylène et de CO₂) pour un usage unique, et est emballé dans deux sachets qui ne doivent pas être emportés en zone stérile. **REMARQUE : le sachet intérieur constitue la seule barrière stérile.**

La stérilité et la stabilité chimique sont garanties tant que l'emballage reste intact et que la date de péremption imprimée sur l'emballage (UTILISER AVANT) n'est pas dépassée.

Contenu : un (1) stent périphérique auto-expansile à élution Amphiliimus™ (Sirolimus+acide gras), recouvert d'Carbofilm™

9. CONSERVATION

Le produit doit être stocké comme indiqué sur l'emballage, dans un lieu sec et frais, à une température maximale de stockage de 25 °C.

10. MODÈLES

Le dispositif NiTiDES est identifié par un code de modèle et un numéro de lot ; les codes de produit disponibles sont indiqués dans le tableau 1.

11. SCHÉMA THÉRAPEUTIQUE

Dans la littérature clinique, des études indiquent la nécessité d'administrer un traitement antiplaquétaire préopératoire, des anticoagulants pendant la procédure et un traitement antiplaquétaire postopératoire.

Le traitement antiplaquétaire après la procédure implique l'administration des médicaments suivants :

- Thienopyridines (ticlopidine, clopidogrel ou prasugrel aux doses indiquées dans les notices correspondantes ou selon la prescription médicale)

- Aspirine à une dose minimum de 100 mg/jour, pour une durée indéterminée. Du fait de la complexité de la procédure et du grand nombre de facteurs influençant l'état du patient, la mise au point du traitement approprié est laissée à l'appréciation du médecin.

12. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Bien qu'aucune donnée clinique spécifique ne soit disponible, certains médicaments comme le Tacrolimus, qui agissent à travers la même protéine de liaison (FKBP), peuvent affecter l'efficacité du Sirolimus. Le Sirolimus est métabolisé par le CYP3A4. Les inhibiteurs puissants du CYP3A4 peuvent causer une exposition plus importante au Sirolimus, notamment en cas d'implants multiples. Tenir compte également du risque d'exposition systémique au Sirolimus si le patient prend un traitement immunsupresseur systémique concomitant.

13. ESSAI CLINIQUE AVEC LES DISPOSITIFS NITIDES

L'innocuité et l'efficacité primaires du stent NiTiDES ont été établies à partir de l'essai clinique pivot ILLUMINA avant sa mise sur le marché.

Conception de l'étude : dans le cadre d'une étude multicentrique sur groupe unique, 100 patients atteints d'une maladie fémoro-poplité symptomatique avec une longueur maximale de la lésion de 14 cm ont été traités par implantation du stent NiTiDES. Le critère d'efficacité primaire (perméabilité primaire) et le critère d'innocuité primaire (un ensemble d'effets indésirables majeurs : décès, amputation du membre cible, ischémie du membre cible nécessitant une intervention chirurgicale ou réparation chirurgicale du vaisseau cible ou revascularisation de la lésion cible cliniquement documentée, détérioration du score de Rutherford de 2 classes, ou à la classe 5 ou 6) ont été comparés à un critère objectif de performance (OPG, Objective Performance Goal) à 12 mois. Résultats : taux de réussite de la procédure : 100 %.

Les résultats dans le cadre d'une échographie Doppler montrent une perméabilité primaire des 87 % (77/89, 95 % d'intervalle de confiance à 80-94), répondant aux exigences de l'OPC (73 %). La perméabilité primaire à 24 mois était de 81 % (63/78).

Le critère d'innocuité primaire à 12 mois était de 96,8 % (90/93), répondant aux exigences de l'OPC (19,6 %). 2,2 % (2/93) des patients ont subi une revascularisation de la lésion cible cliniquement documentée, 1,1 % (1/93) des patients est décédé, 0 patient n'a subi une amputation du membre cible, 0 patient n'a subi une ischémie du membre cible nécessitant une intervention chirurgicale ou une réparation chirurgicale du vaisseau cible, et 0 patient n'a présenté une détérioration du score de Rutherford de deux classes, ou à la classe 5 et 6.

Le critère d'innocuité primaire à 24 mois était de 87,8 % (79/90), 6,7 % (6/90) des patients ont subi une revascularisation de la lésion cible cliniquement documentée, 3,3 % (3/90) des patients sont décédés, 0 patient n'a subi une amputation du membre cible, 1,1 % (1/90) des patients a subi une ischémie du membre cible nécessitant une intervention chirurgicale ou une réparation chirurgicale du vaisseau cible, et 1,1 % (1/90) des patients a présenté une détérioration du score de Rutherford de deux classes, ou à la classe 5 et 6.

14. MODE D'EMPLOI

Sélection du dispositif

Se reporter à la longueur de la lésion à traiter pour définir la longueur de stent nécessaire. Afin de recouvrir la lésion de manière adéquate, la longueur de stent déployé doit être au moins 5 mm plus longue que la lésion elle-même, de chaque côté.

Se reporter au diamètre du vaisseau proximalement et distalement par rapport à la lésion pour définir la taille de stent à utiliser. Pour garantir une bonne mise en place du stent, la taille de stent choisie doit se baser sur le diamètre le plus grand. Lors du choix du modèle, consulter les informations du tableau 1.

Préparation du dispositif

Avant de mettre le stent en place, administrer de l'héparine et vérifier que le temps de coagulation activée (TCA) est correct, conformément à la pratique de l'établissement.

Pendant la préparation du système, faire particulièrement attention à ne laisser aucun liquide entrer en contact avec le stent.

- Ouvrir la boîte et sortir le sac contenant le sachet stérile.
 - Après avoir vérifié en l'examinant que l'emballage n'est pas endommagé, ouvrir le sachet externe en aluminium non stérile, puis sortir le contenu du sachet interne. (Remarque : le sachet en aluminium et la surface extérieure du sachet en plastique intérieur **NE SONT PAS STÉRILES**. Seul le contenu du sachet plastique est STÉRILE).
 - En veillant à poser le support sur une surface plane dans un endroit stérile, défaire la bande autour de la poignée et retirer le cathéter de la spirale de protection.
 - Vérifier que le cathéter de pose n'est pas entortillé, plié ou autrement endommagé. L'endommagement du dispositif risque de compromettre ses performances.
 - Remplir une seringue de 3 ml de sérum physiologique contenant de l'héparine, raccorder le raccord Luer de rinçage (figure 1, élément 12) et exercer une pression positive. Continuer à rincer jusqu'à ce que le sérum physiologique sorte de l'extrémité distale du cathéter.
 - Inspecter l'extrémité distale du cathéter en s'assurant que la gaine recouvre complètement le stent (figure 1, élément 4).
- Ne pas utiliser le dispositif si l'il est endommagé ou si le stent est partiellement déployé.

Compatibilité avec les accessoires

Il est possible d'utiliser des gaines d'introducteur de diamètre 6F (2,0 mm) ou supérieur avec le dispositif NiTiDES.

Des fils-guides d'un diamètre de 0,89 mm (0,035 pouces) ou moins peuvent être utilisés avec le dispositif NiTiDES. Le choix de la raideur du fil-guide et du type d'embout dépendra de l'expérience clinique du médecin.

S'il s'avère nécessaire d'utiliser un cathéter de guidage, ces systèmes sont compatibles avec des cathétères de guidage de diamètre 8F (2,7 mm) ou plus.

Dans ce cas, bien vérifier que la valve hémostatique est complètement ouverte avant d'introduire l'ensemble sélectionné.

Insertion du stent

- a) Vérifier que la clavette de sécurité (figure 1, élément 10) de la poignée est en position fermée (détail B).
- b) Laver la partie exposée du fil-guide avec du sérum physiologique héparinisé pour éliminer les traces de sang et de produit de contraste.
- c) Faire avancer le système sur le fil-guide jusqu'à ce que le stent atteigne le site à traiter.

En cas de résistance inhabituelle à tout moment, ne pas forcer sur le système : extraire l'introducteur, le fil-guide et le dispositif comme un seul élément. Une force excessive et/ou une mauvaise manipulation peuvent provoquer un déploiement accidentel du stent ou endommager le cathéter de pose.

Progression du dispositif

- a) Faire avancer le système jusqu'à ce que le stent se trouve au-delà de la lésion.
- b) Faire reculer le système jusqu'à ce que le stent soit aligné sur la lésion.
- c) Vérifier que la partie du système de pose qui se trouve hors du corps du patient est étendue correctement et droite.

Attention : si le système de pose n'est pas étendu correctement, le stent risque d'être déployé au-delà de la lésion à traiter.

Implantation et expansion du stent

- a) En tenant fermement la poignée d'une main, vérifier que les repères radio-opaques situés sur le stent sont positionnés proximalement et distalement par rapport à la lésion.
- b) S'assurer que la gaine de l'introducteur ne bouge pas pendant le déploiement du stent.
- c) Tourner la clavette de sécurité sur la poignée dans le sens antihoraire (figure 1, détail B) pour la débloquer (PHASE 1) puis l'extraire entièrement (PHASE 2).
- d) En tenant la poignée dans une position fixe par rapport au patient, vérifier à nouveau que les repères radio-opaques sont correctement positionnés par rapport à la lésion : commencer à déployer le stent en tournant la molette (figure 1, élément 9) avec le pouce dans le sens de la flèche, comme indiqué sur la figure 1.
- e) Sous fluoroscopie, lorsque l'extrémité distale du stent est correctement plaquée sur les parois vasculaires, continuer le déploiement en tournant la molette jusqu'à ouverture du stent et implantation complète dans les parois vasculaires.
- f) Si un déploiement rapide s'avère nécessaire, procéder comme suit : s'assurer qu'il n'y a aucune obstruction (raccord Luer femelle vissé par exemple) sur l'extrémité arrière de la poignée, saisir l'extrémité arrière du dispositif (rétractable, figure 1, élément 11) de l'autre main et tirer dessus, en maintenant la partie avant de la poignée par rapport au patient parfaitement immobile, comme indiqué dans la figure 1.
- g) Sous fluoroscopie, vérifier que le stent est complètement déployé.
- h) Le stent peut être déployé davantage si nécessaire en utilisant un cathéter à ballonnet pour ATP. Pour sélectionner le diamètre du cathéter à ballonnet et réaliser la post-expansion, se reporter au diamètre du vaisseau qui a été estimé au moyen de l'angiographie. Dans tous les cas, faire particulièrement attention à ne pas déployer le stent au-delà de son diamètre nominal indiqué sur l'étiquette.
- i) Le diamètre final du stent doit être adapté au diamètre de vaisseau de référence.

15.EFFETS INDÉSIRABLES POTENTIELS

Les événements indésirables possibles pouvant être associés à l'implantation d'un stent périphérique comprennent les risques liés à l'angioplastie transluminale percutanée, ainsi que les risques supplémentaires associés à l'utilisation de stents, comme indiqué ci-après.

- Infection, douleur et hématome au site d'accès
- Réaction allergique ou réaction indésirable au produit de contraste, aux médicaments utilisés pendant la procédure ou aux matériaux des composants du stent
- Spasme artériel
- Thrombose artérielle ou thrombose de stent
- Anévrisme de l'artère fémorale ou pseudo-anévrisme
- Athéro-embolisation distale
- Hémorragie
- Décès
- Dissection, perforation ou rupture du vaisseau où le stent est implanté
- Embolie
- Insuffisance rénale
- Ischémie des membres inférieurs (nécessitant une intervention chirurgicale)
- Resténose de l'artère sur laquelle le stent a été implanté
- Embolisation du stent
- Occlusion du vaisseau ou sténose non résolue

16.RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Le Fabricant assure que le dispositif a été conçu, fabriqué et emballé avec le plus grand soin et avec les techniques jugées les plus appropriées parmi celles qui sont disponibles en l'état actuel de la technologie. Les principes d'intégration de la sécurité appliqués au niveau de la conception et de la fabrication garantissent un emploi sûr, quand le produit est utilisé aux conditions et pour les buts prévus en respectant les précautions indiquées aux paragraphes précédents, et visent quoi qu'il en soit à réduire dans la mesure du possible, sans toutefois les éliminer totalement, les risques liés à l'emploi du dispositif.

Le dispositif doit être utilisé exclusivement sous la responsabilité d'un personnel médical spécialisé et en tenant compte des risques résiduels et des effets secondaires et complications possibles du traitement pour lequel il a été prévu, notamment les risques mentionnés dans les autres sections de ce mode d'emploi. La complexité technique et la nature critique des choix médicaux et des modalités d'application du dispositif excluent que le Fabricant puisse fournir une garantie

explicite ou implicite de l'efficacité du résultat suite à l'emploi du dispositif ou quant à sa capacité à résoudre un état d'invalidité, ou tout autre problème pathologique ou médical. En effet, les résultats finaux, à la fois d'un point de vue clinique et en termes de fonctionnalité et durabilité du dispositif, dépendent de nombreux facteurs échappant au contrôle du Fabricant : les facteurs souvent cités en exemple sont notamment l'état du patient, la procédure chirurgicale d'implantation et d'application, et la manipulation du dispositif après ouverture de l'emballage. Au vu de ces facteurs, la responsabilité du Fabricant existe uniquement s'il a été établi que le dispositif présentait des défauts au moment où il a été mis en circulation. À cet effet, le Client doit mettre immédiatement le dispositif à la disposition du Fabricant, conformément aux termes relatifs aux délais d'expiration et de prescription exigés par la loi ; le Fabricant se réserve le droit d'expertiser le dispositif jugé défectueux et de déterminer si le dispositif présente effectivement des défauts susceptibles de nuire à la sécurité du produit. La responsabilité du Fabricant est exclue si (i) le défaut allégué est imputable à la conformité du dispositif avec une règle obligatoire ou une disposition contraignante, et/ou (ii) le défaut à l'origine du dommage n'existe pas au moment où le Fabricant a commercialisé le dispositif et/ou (iii) l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le Fabricant a commercialisé le dispositif ne permettait pas encore de considérer le dispositif comme défectueux, et/ou (iv) dans tout autre cas, différent de ceux indiqués ci-dessus, dans lequel la législation exclut expressément, ou limite, la responsabilité du Fabricant pour les dommages dus à des produits défectueux. La garantie prévoit exclusivement le remplacement du dispositif défectueux par un autre dispositif du même type ou équivalent, produit par le Fabricant.

La garantie ne s'applique que si le dispositif est renvoyé au Fabricant correctement emballé et accompagné d'un rapport écrit et détaillé décrivant les défauts constatés et, si le dispositif a été implanté, expliquant les raisons de son implantation. Les défauts constatés doivent être signalés immédiatement au Fabricant, conformément aux termes relatifs aux délais de déchéance et de prescription.

Après le remplacement du dispositif, le Fabricant remboursera au Client les frais encourus pour le retour du dispositif reconnu comme défectueux. Le Fabricant décline toute responsabilité si les conditions d'utilisation et précautions d'usage indiquées dans le présent mode d'emploi ne sont pas respectées et si le dispositif est utilisé après la date limite de péremption indiquée sur l'emballage.

En outre, le Fabricant décline toute responsabilité concernant les conséquences des choix de traitement, des méthodes d'utilisation ou de l'application du dispositif ; le Fabricant ne fera par conséquent pas l'objet de poursuites judiciaires pour les dommages, quels qu'ils soient (matériels, biologiques ou moraux), résultant de l'application du dispositif et du choix de la technique d'implantation par l'utilisateur. Les agents et représentants du Fabricant ne sont pas autorisés à modifier les conditions susmentionnées, ni à prendre un autre engagement, ni à offrir des garanties concernant ce produit, au-delà des termes susmentionnés. La présente garantie est régie par la législation italienne, sauf si les lois obligatoires d'un autre État s'appliquent, dans le cas où le Fabricant a autorisé la circulation du produit dans un ou plusieurs États autres que l'Italie.

DEUTSCH

NiTIDES

„Carbofilm™-beschichtetes selbstopandierendes Amphilimus™ (Sirolimus + Fettsäure) freisetzendes peripheres Stent-System

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Produktfamilie NiTiDES besteht aus einem selbstopandierenden Stent und einem System zu dessen korrekter Positionierung und Entfaltung. Der **Stent** ist ein flexibles, selbstopandierendes, implantierbares Produkt. Er besteht aus einer Nickel-Titan-Legierung (Nitinol), die mit „Carbofilm™“, einem dünnen Carbonfilm mit hochverdichteter turbostratischer Struktur, beschichtet ist, die im Wesentlichen mit der von pyrolytischen Kohlenstoff übereinstimmt. Die Beschichtung verleiht dem Substrat die bio- und hämokompatiblen Eigenschaften des pyrolytischen Carbons, ohne die physikalischen und strukturellen Eigenschaften des Substrats zu beeinflussen. Sechs röntgendiftiche Tantal-Marker sind am Stent angebracht (drei auf jedem Ende), um die korrekte Positionierung an der Stelle der Zieläsion zu ermöglichen. Die Außenfläche des Stents besitzt vollständig mit „Carbofilm™“ ausgekleidete Rillen für die Aufnahme der pharmazeutischen Formulierung Amphilimus™, die aus dem Arzneistoff Sirolimus und einer Mischung von langketigen Fettsäuren besteht.

Die spezifische Arzneimitteldosierung für die behandelte Gefäßoberfläche beträgt ca. 0,9 µg/mm², was einer Mindestdosis von 270 µg bei den kleineren Stents (6,0 x 20 mm) und einer Höchstdosis von 2420 µg bei den größeren Stents (8,0 x 150 mm) entspricht.

Das verwendete **Einführungssystem** ist vom Typ Over-The-Wire und gewährleistet die sichere Positionierung und Entfaltung des Stents in der Läsion. Dieses System ist in Abbildung 1 dargestellt und beinhaltet:

- einen Katheterkörper (7) mit Durchmesser 6F, bestehend aus:
 - einem zurückziehbaren Außenmantel, einem distalen, halbdurchsichtigen Abschnitt (3), in dem der Stent (4) enthalten ist; der Mantel ist in der Nähe der Katheterspitze mit einem röntgendiftichen Ring (13) versehen;
 - einem Innenlumen, das einen Ring (6) und einen Innenschlauch (2) enthält, der für einen 0,035 Zoll Führungsdrat geeignet ist. Das Innenlumen erstreckt sich vom Luer-Anschluss (12), der proximal am Griff befestigt ist, bis zum distalen Ende (1) des Katheters. Letzteres ist aus einem röntgendiftichen Material gefertigt, um die Lokalisierung und Positionierung des Katheters bei Betrachtung über ein Bildgebungssystem zu erleichtern. Ein Rückhaltelement (5) im Innenlumen verhindert eine axiale Dislokation des Stents beim Zurückziehen des Außenmantels.
- einen Griff (8) mit einem Einführungssystem, der die Positionierung des Katheters und die Entfaltung des Stents *in situ* ermöglicht.

Der Griff verfügt über ein ergonomisches Design, dank dem der Anwender ihn auch mit nur einer Hand ergreifen und verwenden kann. Er enthält einen Luer-Anschluss (12) am proximalen Ende, der zum Spülen des Führungsdrat-Lumens verwendet wird, einen Sicherheitsschlüssel (10), ein Rad (9) und einen zurückziehbaren Endstück (11).

Der Hersteller produziert den peripheren Stent + das Einführungskathetersystem selbst und führt sämtliche Qualitätskontrollen sowohl während der Produktion als auch am Endprodukt eigenständig gemäß der entsprechenden Guten Herstellungspraxis durch.

2. ZWECKBESTIMMUNG DES PRODUKTS

Das selbstopandierende periphere Stent-System ist zur Behandlung der peripheren Arterienerkrankung bestimmt, die die oberflächliche Oberschenkelarterie und die proximale Poplitealarterie betrifft.

3. INDIKATIONEN FÜR DIE ANWENDUNG DES PRODUKTS

Das Produkt ist für die Behandlung einer Arterienstenose im femoropoplitealen Bereich oberhalb des Knees bei erwachsenen symptomatischen Patienten [Rutherford Kategorie 2-5] indiziert. Die behandelte Läsion mit einer maximalen Länge von 14 Zentimetern muss entweder verschlossen sein oder eine Stenose von mehr als 50 % aufweisen, de-novo oder restenotisch sein und darf nicht zuvor mit einem Stent behandelt worden sein.

4. GEGENANZEIGEN

Die Verwendung des Stents ist in folgenden Situationen kontraindiziert:

- Läsionen, die mit PTA oder anderen interventionellen Techniken als nicht behandelbar gelten.
- Schwangere und stillende Frauen.
- Läsionen in den zwei distalen Dritteln der Poplitealarterie oder am Kniegelenk.
- Klinische Zustände, die die Anwendung einer Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern und/oder Antikoagulantien erschweren.

5. WARNHINWEISE

- Die Anwendung des Produkts wird nicht empfohlen bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit oder Allergie gegen Sirolimus, Fettsäuren (wie Stearin-, Palmitin- oder Behensäure) oder gegen die metallischen Bestandteile des Stents (wie Nickel, Titan und Tantal).
- Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden, wieder aufbereiten oder resterilisieren. Dies könnte zu Kontaminationsgefahr am Produkt führen und/oder Infektionen beim Patienten, Entzündungen sowie die Übertragung von Infektionskrankheiten von einem Patienten zum anderen verursachen.
- Das Produkt ist zur Verwendung als ganzes System bestimmt. Daher dürfen seine Komponenten nicht einzeln verwendet werden.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Packung geöffnet oder beschädigt ist, falsch gelagert wurde oder das angegebene Verfallsdatum abgelaufen ist. In diesen Fällen ist die Sterilität des Produkts nicht gewährleistet.

- Das Produkt darf nur von speziell zur Durchführung der perkutanen transluminalen Angioplastie (PTA) und peripheren Stent-Implantation geschulten Ärzten verwendet werden.
- Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während des Eingriffs Widerstände bemerkbar sind, darf keine Kraft auf das System ausgeübt werden: Ziehen Sie das Stent-System mit dem Einführungskatheter, den Führungsdrat und die Schleuse als eine Einheit zurück. Ein übermäßiger Kraftaufwand und/oder eine falsche Handhabung können zur versehentlichen Entfaltung des Stents oder zu Schäden am Einführungskatheter führen.
- Zu jedem Zeitpunkt während des Eingriffs kann eine falsche Handhabung zur Gefäßdissektion, -perforation oder -ruptur führen.
- Schieben Sie das Stent-System während der Entfaltung nicht vor oder zurück: Dies kann zu schweren Schäden an den Gefäßwänden führen.
- Die Implantation eines selbstopandierenden peripheren Stents kann eine Gefäßdissektion distal und/oder proximal zum Stent hervorrufen und einen akuten Gefäßverschluss verursachen. In diesem Fall wird ein zusätzlicher Eingriff (Gefäßersatzoperation, weitere Dilatation, Platzierung zusätzlicher Stents oder sonstige Verfahren) notwendig.
- Sobald ein Teil des Stents gesetzt wurde, kann er nicht mehr mit dem Einführungssystem eingezogen werden.

6. VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie das Schnellfreigabesystem **nie** zu Beginn der Stentexpansion. Es darf **nur bei Bedarf** nach Freigabe von mindestens **der halben Länge** des Stents verwendet werden.
- Das Produkt muss vorsichtig gehandhabt werden, um den Kontakt mit metallischen oder scheuernden Instrumenten zu vermeiden, da diese Beschädigungen oder mechanische Veränderungen daran verursachen könnten.
- Das Produkt darf vor Vorbereitung und Positionierung nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen.
- Das Positionierungssystem ist nicht zur Verwendung mit Kontrastmittel injektoren geeignet.
- Wenn Stents hintereinander implantiert werden, müssen sich ihre entsprechenden röntgendiftichen Marker überschneiden. Es dürfen sich nicht mehr als zwei Stents überschneiden.
- Bei sich überschneidenden Stents wird eine Überlappungslänge von weniger als 20 mm empfohlen.
- Zur Vermeidung einer Beschädigung des Stents ist immer dann extreme Vorsicht geboten, wenn der Führungsdrat oder der Ballonkatheter oder eine andere Vorrichtung durch einen entfalteten Stent geführt wird.

7. MRT SICHERHEITSINFORMATION

Nicht-klinische Tests haben gezeigt, dass die Nitinol-Stent-Produktlinien des Herstellers MR-tauglich sind. Ein Patient mit diesem Produkt kann sicher in einem MR-System, das die folgenden Bedingungen erfüllt, gescannt werden:

- Statisches Magnetfeld von 1,5 Tesla (1,5 T) oder 3 Tesla (3 T)
- Maximaler räumliches Gradienten-Magnetfeld von 6,140 G/cm (61,40 T/m)
- Maximale, vom MR-System gemeldete, gemittelte Ganzkörper-SAR-Wert (spezifische Absorptionsrate):
 - 1 W/kg (normaler Betriebsmodus) bei 1,5 T
 - 1 W/kg (normaler Betriebsmodus) bei 3 T

HF-Erwärzung

Unter den oben definierten Scanbedingungen wird erwartet, dass die Nitinol-Stent-Produktlinien des Herstellers nach 15 Minuten kontinuierlichen Scannens bei einer vom MR-System gemeldeten, über den ganzen Körper gemittelten spezifischen Absorptionsrate (SAR) von 1,0 W/kg einen maximalen Temperaturanstieg von weniger als 6,8 °C bewirken.

1,5 T 3 T

Konfiguration mit nur einem Stent	Höchste Temperaturänderung	≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
Konfiguration sich überschneidend Stents	Höchste Temperaturänderung	≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C

MR-Artefakt

In nicht-klinischen Tests erstreckt sich das durch das Produkt verursachte Bildarteft ca. 0,7 cm über die Nitinol-Stents des Herstellers hinaus, wenn diese mit einer Gradienten-Echo Pulssequenz in einem 3-T-MRT-System abgebildet werden.

8. LIEFERUMFANG

Das Produkt NiTiDES wird steril (unter Verwendung eines Gasgemisches aus Ethylenoxid und CO₂ sterilisiert) und, für den einmaligen Gebrauch bestimmt, in zwei Beuteln verpackt geliefert, die nicht in einen sterilen Bereich gelangen dürfen. **HINWEIS: Der Innenbeutel ist die einzige Sterilbarriere.**

Die Sterilität und chemische Stabilität sind bei unverührter und korrekt gelagerter Packung bis zum auf der Packung angegebenen Verfallsdatum (VERWENDBAR BIS) gewährleistet.

Inhalt: ein (1) „Carbofilm™-beschichtetes selbstopandierendes Amphilimus™ (Sirolimus + Fettsäure) freisetzendes peripheres Stent-System

9. LAGERUNG

Wie auf der Verpackung angegeben, muss das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort mit einer Lagertemperatur von maximal 25 °C aufbewahrt werden.

10. MODELLE

Das Produkt NiTiDES ist durch einen Modellcode und eine Chargenbezeichnung gekennzeichnet. Die verfügbaren Produktcodes sind in Tabelle 1 aufgelistet.

11. ARZNEIMITTELREGIME

Studien in der klinischen Literatur weisen auf die Notwendigkeit der Verabreichung einer Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern vor der Operation, mit

- Antikoagulantien während des Eingriffs, und mit Thrombozytenaggregationshemmern nach der Operation hin.
 Die Therapie durch Thrombozytenaggregationshemmung nach dem Eingriff beinhaltet die Gabe von:
- Thienopyridinen (Ticlopidin, Clopidogrel oder Prasugrel entsprechend der in der jeweiligen Gebrauchsinformation angegebenen Dosierung oder gemäß der ärztlichen Verordnung)
 - Aspirin in einer Mindestmenge von 100 mg/Tag auf unbestimmte Zeit
- Angesichts der Komplexität des Verfahrens und der vielen Faktoren, die den Zustand des Patienten beeinflussen, liegt die Ermittlung einer adäquaten Therapie im Ermessen des Arztes.

12. WECHSELWIRKUNGEN MIT ARZNEIMITTELN

Obwohl keine spezifischen klinischen Daten verfügbar sind, könnten einige Arzneimittel wie Tacrolimus, die mit dem selben Bindeprotein (FKBP) agieren, die Wirksamkeit von Sirolimus beeinträchtigen. Sirolimus wird über CYP3A4 abgebaut. Starke CYP3A4-Inhibitoren können die Sirolimus-Exposition erhöhen, besonders im Fall von mehreren Implantaten. Daher muss die systemische Sirolimus-Exposition berücksichtigt werden, wenn der Patient gleichzeitig systemische Immunsuppressiva einnimmt.

13. KLINISCHE STUDIE MIT NITIDES

Die grundsätzliche Sicherheit und Wirksamkeit des NiTiDES-Stents wurde in der klinischen Studie ILLUMINA vor der Markteinführung nachgewiesen.
 Aufbau der Studie: Im Rahmen einer multizentrischen, einarmigen Studie wurden 100 Patienten mit symptomatischer femoropoplitealer Erkrankung mit einer maximalen Läsionslänge von 14 cm mit dem NiTiDES-Stent behandelt. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt (primäre Durchgängigkeit) und der primäre Sicherheitsendpunkt (ein Kompositum aus schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen: Tod, Amputation der Zielgliedmaße, Ischämie der Zielgliedmaße, die einen chirurgischen Eingriff oder eine chirurgische Reparatur des Zielgefäßes erfordert, klinisch bedingte Revaskularisierung der Zielläsion, Verschlechterung des Rutherford-Grads um 2 Kategorien oder auf Kategorie 5 oder 6) wurden nach 12 Monaten mit einem objektiven Leistungsziel (OPG) verglichen.

Ergebnisse: Der verfahrenstechnische Erfolg wurde in 100 % erreicht. Die Ergebnisse des Doppler-Ultraschalls zeigen eine primäre Durchgängigkeit von 87 % (77/89, 95 % Konfidenzintervall 80–94), was den Anforderungen des OPG entspricht (73 %). Die primäre Durchgängigkeit nach 24 Monaten betrug 81 % (63/78).

Der primäre Sicherheitsendpunkt nach 12 Monaten lag bei 96,8 % (90/93) und erfüllte damit die Anforderungen des OPG (19,6 %). 2,2 % (2/93) der Patienten zeigten eine klinisch bedingte Zielläsionsrevaskularisation, 1,1 % (1/93) starben, bei 0 Patienten wurde eine Zielgliedamputation vorgenommen, 0 Patienten zeigten eine Ischämie der Zielgliedmaße, die einen chirurgischen Eingriff oder eine chirurgische Reparatur des Zielgefäßes erforderlich gemacht hätte und 0 Patienten zeigten eine Verschlechterung des Rutherford-Grads um 2 Kategorien oder auf Kategorie 5 oder 6.

Der Sicherheitsendpunkt nach 24 Monaten lag bei 87,8 % (79/90). 6,7 % (6/90) der Patienten zeigten eine klinisch bedingte Zielläsionsrevaskularisation, 3,3 % (3/90) starben, bei 0 Patienten wurde eine Zielgliedamputation vorgenommen, 1,1 % der Patienten (1/90) zeigten eine Ischämie der Zielgliedmaße, die einen chirurgischen Eingriff oder eine chirurgische Reparatur des Zielgefäßes erforderlich machte und 1,1 % (1/90) der Patienten zeigten eine Verschlechterung des Rutherford-Grads um 2 Kategorien oder auf Kategorie 5 oder 6.

14. HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG

Wahl des Produkts

Beziehen Sie sich auf die Länge der Zielläsion, um die Länge des erforderlichen Stents zu bestimmen. Um die Läsion angemessen abzudecken, muss die Länge des entfalteten Stents auf jeder Seite mindestens 5 mm länger sein als die Läsion selbst.

Beziehen Sie sich auf den Durchmesser des Gefäßes proximal und distal zur Läsion, um die geeignete Stentgröße zu bestimmen. Um eine sichere Platzierung des Stents zu gewährleisten, verwenden Sie den größeren Durchmesser als Basis für die Auswahl der geeigneten Stentgröße. Nehmen Sie zur Wahl des Modells auf die Informationen in Tabelle 1 Bezug.

Vorbereitung des Produkts

Verarbeiten Sie vor der Einführung des Stents Heparin und überprüfen Sie, ob die Blutgerinnungszeit (ACT) den in Ihrer Einrichtung geltenden Anforderungen entspricht.

Achten Sie bei der Vorbereitung des Systems besonders darauf, dass keine Flüssigkeiten mit dem Stent in Berührung kommen.

- a) Öffnen Sie die Packung und nehmen Sie den Beutel heraus, der den sterilen Innenbeutel enthält.
- b) Nachdem Sie die Verpackung auf ihre Unverehrtheit überprüft haben, öffnen Sie den nicht sterilen Alu-Außenebeutel und entnehmen dann den Inhalt des Innenbeutels. (Hinweis: Der Beutel aus Alufolie und die Außenoberfläche des Innenbeutels aus Kunststoff SIND NICHT STERIL. Nur der Inhalt des Kunststoffbeutels ist STERIL).
- c) Achten Sie darauf, den Halter in einem sterilen Bereich auf eine flache Oberfläche abzulegen, nehmen Sie das Band um den Griff ab und befreien Sie den Katheter von seinem Schutzzring.
- d) Stellen Sie sicher, dass der Einführungskatheter keine Knicke, Biegungen oder andere Schäden aufweist. Schäden am Produkt können dessen Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.
- e) Füllen Sie eine 3 ml Spritze mit einer heparinisierten Kochsalzlösung, schließen Sie sie an den Luer-Anschluss zum Spülen (Abbildung 1-12) an und über Sie einen positiven Druck aus. Setzen Sie den Spülvorgang fort, bis die Kochsalzlösung aus dem distalen Ende des Katheters fließt.
- f) Kontrollieren Sie das distale Ende des Katheters und vergewissern Sie sich, dass der Stent (Abbildung 1-4) vollständig vom Außenn Mantel bedeckt ist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder teilweise expandiert ist.

Kompatibilität mit Zubehörteilen

Es können Schleusen mit einem Durchmesser von 6F (2,0 mm) oder größer zum Einbringen des NiTiDES eingesetzt werden.

Es können Führungsdrähte mit einem Durchmesser 0,035 Zoll (0,89 mm) oder kleiner zum Einbringen des Produkts NiTiDES eingesetzt werden. Die Auswahl der Steifheit des Führungsdrähts und die Konfiguration der Spitze sind von der klinischen Erfahrung des Arztes abhängig.

Falls die Verwendung eines Einführungskatheters erforderlich ist, sind Systeme mit Einführungskathetern mit einem Durchmesser von 8 F (2,7 mm) oder größer kompatibel. Vergewissern Sie sich in diesem Fall vor dem Einführen des gewählten Systems, dass das Hämostaseventil ganz geöffnet ist.

Einbringen des Stents

- a) Vergewissern Sie sich, dass sich der Sicherheitsschlüssel (Abbildung 1-10) des Griffs in der Sperrposition befindet (Detail B).
- b) Spulen Sie den exponierten Teil des Führungsdrähts mit heparinierter Kochsalzlösung, um Blut- und Kontrastmittelpuren zu beseitigen.
- c) Schieben Sie das System mit Hilfe des Führungsdrähts vor, bis der Stent die zu behandelnde Stelle erreicht.

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt Widerstände bemerkbar sind, darf keine Kraft auf das System ausgeübt werden: Ziehen Sie die Schleuse, den Führungsdrift und das Produkt als eine Einheit zurück. Ein übermäßiger Kraftaufwand und/oder eine falsche Handhabung können zur versehentlichen Entfaltung des Stents oder zu Schäden am Einführungskatheter führen.

Vorschieben des Produkts

- a) Schieben Sie das System bis zu der Stelle vor, an der der Stent hinter der Läsion liegt.
- b) ziehen Sie das System zurück, bis der Stent passend zur Läsion ausgerichtet ist.
- c) Prüfen Sie, dass der Teil des Einführungssystems, der sich außerhalb des Körpers des Patienten befindet, hindernisfrei gestreckt und gerade ist.

Achtung: Wenn das Einführungssystem nicht vollständig gestreckt ist, könnte sich der Stent hinter der Zielläsion entfalten.

Implantation und Expansion des Stents

a) Ergreifen Sie den Griff fest mit einer Hand und prüfen Sie, dass die röntgenfesten Marker am Stent proximal und distal in Übereinstimmung mit der Läsion ausgerichtet sind.

b) Vergewissern Sie sich, dass die Schleuse sich während der Entfaltung des Stents nicht bewegt.

c) Drehen Sie den Sicherheitsschlüssel (Abbildung 1-B) am Griff gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln (SCHRITT 1) und ziehen Sie ihn anschließend ganz heraus (SCHRITT 2).

d) Halten Sie den Griff in Bezug auf den Patienten in einer festen Position und prüfen Sie erneut, ob sich die röntgendifennten Marker in Bezug auf die Läsion in der gewünschten Position befinden; beginnen Sie mit der Entfaltung des Stents, indem Sie das Rad (Abbildung 1-9) mit Ihrem Daumen in Richtung des Pfeils drehen, wie in Abbildung 1 dargestellt.

e) Setzen Sie, wenn das distale Ende des Stents gut an der Gefäßwand befestigt ist, die Entfaltung unter dem Fluoroskop fort, indem Sie das Rad so lange drehen, bis sich das Endstück des Stents geöffnet hat und vollständig in die Gefäßwand implantiert wurde.

f) Sollte eine schnelle Entfaltung erforderlich sein, gehen Sie wie folgt vor: Vergewissern Sie sich, dass am hinteren Griffende keine Behinderungen vorliegen (z. B. zugeschraubter weiblicher Luer-Anschluss), erfassen Sie das hintere Ende der Vorrichtung (zurückziehbar, Abbildung 1-11) mit Ihrer zweiten Hand und ziehen Sie daran, während Sie den vorderen Teil des Griffs in Bezug auf den Patienten ganz ruhig halten, wie in Abbildung 1 dargestellt.

g) Überprüfen Sie über das Fluoroskop, dass der Stent vollständig expandiert wurde.

h) Der Stent kann bei Bedarf mit Hilfe eines PTA Ballonkatheters noch weiter expandiert werden. Nehmen Sie bitte zur Wahl des Durchmessers des Ballonkatheters und zur Durchführung der nachträglichen Expansion Bezug auf den Gefäßdurchmesser, der bei der Angiographie beurteilt wurde. Achten Sie in jedem Fall darauf, den Stent nicht über den auf dem Etikett angegebenen Nenndurchmesser hinaus zu expandieren.

i) Der Enddurchmesser des Stents muss dem Durchmesser des Zielgefäßes angemessen sein.

15. MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE

Mögliche Nebenwirkungen, die mit der Implantation eines peripheren Stents einhergehen können, beinhalten auf die perkutane transluminale Angioplastie beruhende Risiken und zusätzliche, durch die Verwendung von Stents ausgelöste Risiken, wie nachfolgend angeführt.

- Infektion der Zugangsstellen, Schmerzen und Hämatome
- Allergische oder unerwünschte Reaktion auf das Kontrastmittel, die während des Verfahrens eingesetzten Arzneimittel oder das Stentmaterial
- Arteriospasmus
- Arterielle oder Stent-Thrombose
- Aneuryisma oder Pseudoaneuryisma der Oberschenkelarterie
- Atherosklerotische distale Embolisation
- Blutung
- Tod
- Dissektion, Perforation oder Ruptur des stentversorgten Gefäßes
- Embolie
- Nierenversagen
- Ischämie der unteren Gliedmaßen (mit erforderlichem chirurgischen Eingriff)
- Restenose der Arterie, in die der Stent implantiert wurde
- Stent-Embolisation
- Gefäßverschluss oder nicht beseitigte Stenose

16. HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG

Der Hersteller versichert, dass das Produkt mit größter Sorgfalt und unter Anwendung der nach dem Stand der Technik am besten geeigneten Techniken und unter Beachtung der Grundsätze der Integration von Sicherheit in Design und Konstruktion entwickelt, hergestellt und verpackt wurde, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Voraussetzung dafür ist die Verwendung unter den in den vorangegangenen Absätzen genannten Bedingungen und für die vorgesehenen Zwecke unter Beachtung der beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen, die dazu dienen, die mit der Verwendung des Produkts verbundenen Risiken so weit wie möglich zu verringern, aber nicht vollständig auszuschließen.

Das Produkt darf ausschließlich unter der Verantwortung von medizinischem Fachpersonal und unter Berücksichtigung der Restrisiken und möglichen Nebenwirkungen und Komplikationen der Therapie, für die es bestimmt ist, einschließlich der in den anderen Abschnitten dieser Gebrauchsanleitung genannten, verwendet werden.

Die technische Komplexität und die kritische Natur der medizinischen Entscheidungen und Methoden der Anwendung des Produkts schließen jede explizite oder implizite Garantie des Herstellers bezüglich der Wirksamkeit des Ergebnisses nach der Anwendung des Produkts oder auf seine Wirksamkeit bei der Behebung eines Zustands der Behinderung oder einer anderen Pathologie oder eines medizinischen Problems aus. Tatsächlich hängen die Ergebnisse, sowohl aus klinischer Sicht als auch in Bezug auf die Funktionalität und die Lebensdauer des Produkts, auch von zahlreichen Faktoren ab, die außerhalb der Kontrolle des Herstellers liegen, unter denen der Zustand des Patienten, das chirurgische Verfahren der Implantation oder der Verwendung, die Methoden der Handhabung des Produkts nach dem Öffnen der Verpackung lediglich als Beispiele angeführt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren besteht eine Haftung des Herstellers nur dann, wenn feststeht, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens mangelhaft war. Zu diesem Zweck muss der Kunde dem Hersteller das Produkt unter Beachtung des Fristablaufs sowie der gesetzlichen Verjährungsfristen unverzüglich zur Verfügung stellen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das für mangelhaft erachtete Produkt zu untersuchen, um festzustellen, ob es tatsächlich mit Mängeln behaftet ist, die die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Die Haftung des Herstellers ist ausgeschlossen, wenn (i) der geltend gemachte Mangel auf der Übereinstimmung des Produkts mit einer zwingenden Bestimmung oder einer bindenden Vorschrift beruht, und/oder (ii) der Fehler, der den Schaden verursacht hat, bei der Produktfreigabe durch den Hersteller nicht vorhanden war, und/oder, (iii) wenn der Stand der Technik und der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Produktfreigabe durch den Hersteller noch nicht erlaubte, das Gerät als fehlerhaft zu betrachten, und/ oder (iv) in allen anderen, auch von den oben genannten abweichenden Fällen, in denen das Gesetz die Verantwortung des Herstellers für den Mangel ausdrücklich ausschließt oder einschränkt. Die Gewährleistung betrifft ausschließlich im Ersatz des defekten Produkts durch ein anderes des gleichen oder gleichwertigen Typs aus der Fertigung des Herstellers.

Die Gewährleistung ist nur dann anwendbar, wenn das Produkt ordnungsgemäß zusammen mit einem schriftlichen und detaillierten Bericht über die beanstandeten Mängel und, im Falle eines implantierten Produkts, über die Gründe für die Entfernung vom Patienten, an den Hersteller zurückgeschickt wird. Die beanstandeten Mängel müssen dem Hersteller unter Beachtung des Fristablaufs und der Verjährungsfristen unverzüglich mitgeteilt werden.

Nach erfolgtem Ersatz erstattet der Hersteller dem Kunden die ihm entstandenen Kosten für die Rücksendung des vom Hersteller als mangelhaft anerkannten Produkts.

Bei Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Verwendungsmethoden und Vorsichtsmaßnahmen sowie bei Verwendung nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums lehnt der Hersteller jede Verantwortung ab.

Darüber hinaus lehnt der Hersteller jede Verantwortung für die Folgen medizinischer Entscheidungen und Methoden der Verwendung oder Anwendung des Produkts ab und kann daher unter keinen Umständen für materielle, biologische oder moralische Schäden jeglicher Art, die sich aus der Anwendung des Produkts und der Wahl der Implantationstechnik durch den Anwender ergeben, strafrechtlich verfolgt werden.

Die Agenten und Vertreter des Herstellers sind nicht befugt, irgendeine der oben genannten Bedingungen zu ändern oder irgendeine zusätzliche Verpflichtung einzugehen oder irgendeine Garantie in Bezug auf dieses Produkt zu übernehmen, die von den oben genannten abweicht. Die vorliegende Gewährleistung unterliegt dem italienischen Recht, sofern nicht die zwingenden Gesetze eines anderen Staates angewandt werden, falls der Hersteller den Vertrieb des Produkts Produkt in einem oder mehreren anderen Staaten als Italien genehmigt hat.

ITALIANO

NITIDES

Sistema di stent periferico auto-espandibile a rilascio di Amphiliimus™ (Sirolimus+acidi grassi) rivestito .Carbofilm™

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

La famiglia di dispositivi NITIDES è costituita da uno stent autoespandibile e da un sistema adatto al corretto posizionamento e rilascio dello stesso.

Lo **stent** è un dispositivo impiantabile, flessibile e autoespandibile. Esso è realizzato in lega di Nichel e Titano (Nitilon) ed è rivestito con «Carbofilm™», un film sottile di carbonio la cui struttura turbostratifica ad elevata densità è sostanzialmente identica a quella del carbonio pirolitico.

Il rivestimento conferisce al substrato le caratteristiche di bio ed emocompatibilità, proprie del carbonio pirolitico, senza modificare le proprietà fisiche e strutturali del substrato stesso.

Alle estremità dello stent sono posizionati sei marker radiopachi di tantalio (tre per ogni estremità) che consentono il corretto posizionamento in corrispondenza della lesione da trattare.

La superficie esterna dello stent presenta nicchie, integralmente rivestite da «Carbofilm™», dedicate al contenimento della formulazione farmaceutica Amphiliimus™, i cui due componenti sono il farmaco Sirolimus e una miscela di acidi grassi a lunga catena.

La dose specifica di farmaco per unità di superficie di vaso trattato è pari a circa 0,9 µg/mm², che corrisponde ad una dose minima di 270 µg sullo stent più piccolo (6,0 x 20 mm) e a una dose massima di 2420 µg sullo stent più grande (8,0x150 mm).

Il **sistema di rilascio** è del tipo over-the-wire, e permette di posizionare e rilasciare lo stent in sicurezza in corrispondenza della lesione da trattare. Esso è schematizzato in Figura 1 ed è costituito da:

- un corpo catetere (7) di diametro 6F composto da:
 - una guaina retrattile esterna nel cui tratto distale semitrasparente (3) è trattenuo lo stent (4); la guaina è dotata di un colletto radiopaco (13) in prossimità della punta del catetere.
 - un corpo interno costituito da un coil (6) e da un tubo interno (2) dentro il quale può scorrere una filo guida da 0,035 pollici; il corpo interno inizia prossimamente dal connettore luer (12) fissato al manipolatore e termina distalmente con la punta (1), realizzata in materiale radiopaco in modo da favorire l'individuazione e il posizionamento del dispositivo in scopia. Un fermo (5) solidale al corpo interno impedisce i movimenti assiali dello stent durante la retrazione della guaina esterna.
- un manipolatore (8) con sistema di rilascio integrato, che consente il posizionamento del catetere ed il rilascio dello stent in situ. Il manipolatore ha un design ergonomico che consente all'operatore di afferrarlo e utilizzarlo anche con una sola mano. Esso presenta una porta luer (12) all'estremità prossimale, che consente il lavaggio del lume di passaggio del filo guida, una chiave di sicurezza (10), una rotella (9) e una coda di pull back (11).

Il Fabricante produce direttamente il sistema stent periferico + catetere di posizionamento e provvede all'esecuzione dei controlli di qualità sia durante il processo di fabbricazione che sul prodotto finito, in accordo con le appropriate Norme di Buona Fabricazione.

2. USO PREVISTO DEL DISPOSITIVO

Il sistema di stent periferico autoespandibile è indicato nel trattamento di patologie delle arterie periferiche che interessano l'arteria femorale superficiale e l'arteria poplitea prossimale.

3. INDICAZIONI PER L'USO DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo è indicato per il trattamento della stenosi delle arterie femoropoplitee sopra il ginocchio in pazienti adulti sintomatici [categoria Rutherford 2-5]. La lesione trattata, di lunghezza massima pari a 14 centimetri, deve essere occlusa o con stenosi superiore al 50%, de-novo o restenotica, non trattata precedentemente con uno stent.

4. CONTROINDICAZIONI

L'uso dello stent è controindicato nei casi sottoelencati.

- Lesioni ritenute non trattabili mediante PTA o con altre tecniche interventistiche.
- Donne in gravidanza o allattamento.
- Lesioni localizzate nei due terzi distali dell'arteria poplitea o a livello dell'articolazione del ginocchio.
- Condizioni cliniche che impediscono l'impiego del trattamento antiaggregante e/o anticoagulante.

5. AVVERTENZE

- L'uso del dispositivo non è raccomandato nei pazienti con ipersensibilità o allergie note al Sirolimus, agli acidi grassi (come acido stearico, palmitico, behenico) o ai componenti metallici dello stent (come Nichel, Titano e Tantalo).
- Il dispositivo è progettato unicamente per uso singolo. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Tali processi potrebbero creare rischi di contaminazione del dispositivo e/o causare infezioni al paziente, infiammazione e trasmissione di malattie infettive a paziente.
- Il dispositivo è stato progettato come sistema integrale. Non utilizzare separatamente i suoi componenti.
- Non utilizzare un dispositivo la cui confezione sia stata aperta, danneggiata, non correttamente conservata oppure oltre la data di scadenza indicata: in tal caso la sterilità non è garantita.
- Il dispositivo deve essere impiantato da medici specificamente addestrati a effettuare l'angioplastica transluminale percutanea (PTA) e ad impiantare stent periferici.
- Se in qualsiasi fase della procedura si dovesse avvertire un'insolita resistenza, non forzare il sistema: estrarre insieme, come fosse un tutt'uno, il sistema

- stent + catetere di posizionamento completo, il filo guida e l'introduttore. L'applicazione di una forza eccessiva e/o un'errata manipolazione potrebbero portare al rilascio accidentale dello stent o causare danni al catetere di posizionamento.
- In qualsiasi momento durante l'utilizzo, un'errata manipolazione potrebbe causare dissezioni, perforazioni, o rotture del vaso.
 - Non fare avanzare o arretrare il sistema durante il rilascio dello stent: questo potrebbe causare gravi danni alle pareti del vaso.
 - L'impianto di uno stent periferico autoespandibile può provocare dissezione del vaso distale e/o prossimale rispetto allo stent e potrebbe provocare un'occlusione acuta del vaso, richiedendo un ulteriore intervento (intervento chirurgico per sostituzione vascolare, ulteriore dilatazione, posizionamento di stent aggiuntivi, o altro).
 - Quando lo stent è parzialmente rilasciato non può essere recuperato con il sistema di posizionamento.

6. PRECAUZIONI

- **Non utilizzare mai il sistema di rilascio rapido all'inizio della espansione dello stent. Utilizzarlo solamente, se necessario, dopo aver liberato almeno metà della lunghezza dello stent.**
- Il dispositivo deve essere maneggiato attentamente in maniera da evitare il contatto con strumenti metallici od abrasivi, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo o produrre alterazioni meccaniche.
- Il dispositivo non deve entrare in contatto con i liquidi prima della preparazione e del posizionamento.
- Il sistema di posizionamento del dispositivo non è progettato per l'uso con iniettori di mezzo di contrasto.
- Se gli stent devono essere impiantati in sequenza, sovrapporre i relativi marker radiopachi. In nessun caso devono sovrapporsi più di due stent.
- In caso di stent sovrapposti, si raccomanda una lunghezza di sovrapposizione inferiore a 20 mm.
- Per evitare di danneggiare lo stent, porre estrema cura qualora si renda necessario attraversare uno stent appena espanso con un filo guida o con un catetere a palloncino o un altro dispositivo.

7. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DI RM

Test non clinici hanno dimostrato che i prodotti della linea stent in Nitinol del Fabricante sono a compatibilità RM Condizionata.

Un paziente con questi dispositivi può essere esaminato in modo sicuro con un sistema RM che risponda alle seguenti condizioni:

- Campo magnetico statico di 1,5 Tesla (1,5 T) o 3 Tesla (3 T)
- Massimo gradiente spaziale di campo di 6,140 G/cm (61,40 T/m)
- Massimo tasso di assorbimento specifico (SAR) riportato dal sistema RM mediato sul corpo intero di:
 - 1,0 W/kg (modalità operativa normale) a 1,5 T.
 - 1,0 W/kg (modalità operativa normale) a 3 T

Riscaldamento da RF

Nelle condizioni di scansione definite sopra, si prevede che i prodotti della linea stent in Nitinol del Fabricante producano un aumento di temperatura massimo inferiore a 6,8 °C dopo 15 minuti di scansione continua con tasso di assorbimento specifico (SAR) riportato dal sistema RM mediato sul corpo intero di 1,0 W/kg

1,5 T 3 T

Configurazione con stent singolo	
Massima variazione di temperatura	≤ 6,3 °C
Configurazione con stent sovrapposti	
Massima variazione di temperatura	≤ 6,8 °C

Artefatto RM

In test non clinici, l'immagine artefatta causata dal dispositivo si estende di circa 0,7 cm rispetto agli stent in Nitinol del Fabricante sottoposti a una sequenza di impulsi a gradiente di eco e Spin Echo in un sistema IRM da 3T.

8. CONFEZIONE

Il dispositivo NITIDES™ è fornito sterile (sterilizzazione tramite miscela di ossido di etilene e CO₂), monouso, confezionato in doppia busta, che non deve essere posta in campo sterile. **NOTA: la busta interna è la sola barriera sterile.**

La sterilità e la stabilità chimica sono garantite, a confezione intatta e correttamente conservata, entro la data di scadenza specificata sulla confezione (SCADENZA). Contenuto: Un (1) sistema di stent periferico auto-espandibile a rilascio di Amphipilus™ (Sirolimus+acidi grassi) rivestito con eCarbofilm™

9. CONSERVAZIONE

Il prodotto dovrebbe essere conservato come indicato sulla confezione, in un luogo fresco e asciutto, con temperatura di conservazione max di 25°C.

10. MODELLI

Ciascun dispositivo NiTiDES è identificato da un codice di modello e da un numero di lotto; i codici di prodotto disponibili sono elencati nella Tabella 1.

11. REGIME FARMACOLOGICO

La letteratura clinica indica la necessità di eseguire un trattamento antiaggregante pre-procedurale, un trattamento anticoagulante durante la procedura e un trattamento antiaggregante nel periodo successivo alla procedura stessa.

Il trattamento antiaggregante nel periodo successivo alla procedura prevede la somministrazione di:

- Tienopiridina (Ticlopidina o Clopidogrel o Prasugrel nelle dosi indicate nei rispettivi libretti di istruzioni o secondo prescrizione medica)
- Aspirina in quantità minima di 100 mg/die indefinitamente.

In considerazione della complessità della procedura e dell'influenza di numerosi fattori sulla condizione del paziente, si demanda al medico la definizione della terapia più idonea.

12. INTERAZIONI CON FARMACI

Pur non essendo disponibili specifici dati clinici, taluni farmaci, come il Tacrolimus, che agiscono attraverso la stessa proteina di legame (FKBP), possono interferire con l'efficacia del Sirolimus. Il Sirolimus è metabolizzato dal CYP3A4. Forti inhibitori del CYP3A4 possono provocare maggior esposizione al Sirolimus fino a livelli associati a effetti sistemicci, specialmente in caso di impianto multiplo. E' inoltre necessario considerare l'esposizione sistematica al Sirolimus se il paziente assume contemporaneamente farmaci immunosoppressori per via sistematica.

13. STUDIO CLINICO CON NITIDES

La sicurezza e l'efficacia principali dello stent NiTiDES sono state stabilite in base allo studio clinico principale pre-commercializzazione ILLUMINA.

Disegno dello studio: nell'ambito di uno studio multicentrico a braccio singolo, 100 pazienti con malattia sintomatica dell'arteria femoro-poplitea con una lunghezza massima della lesione di 14 cm sono stati trattati con lo stent NiTiDES. L'endpoint primario di efficacia (pervietà primaria) e l'endpoint primario di sicurezza (un composto di eventi avversi maggiori: morte, amputazione dell'arto target, ischemia dell'arto target che richieda un intervento chirurgico o riparazione chirurgica del vaso target o rivascolarizzazione della lesione target indicata clinicamente, peggioramento del punteggio di Rutherford di 2 classi, o alla classe 5 o 6) sono stati confrontati con un obiettivo di performance oggettivo (Objective Performance Goal - OPG) a 12 mesi.

Risultati: il successo procedurale è stato ottenuto nel 100% dei casi.

I risultati dell'ecografia Doppler mostrano una pervietà primaria dell'87% (77/89, intervallo di confidenza al 95% 80-94), soddisfacendo i requisiti dell'OPG (73%). La pervietà primaria a 24 mesi è stata dell'81% (63/78).

L'endpoint primario di sicurezza a 12 mesi è risultato del 96,8% (90/93), soddisfacendo i requisiti dell'OPG (19,6%). Il 2,2% (2/93) dei pazienti ha avuto una rivascolarizzazione della lesione target indicata clinicamente, l'1,1% (1/93) è deceduto, nessuno ha avuto l'amputazione dell'arto target, nessuno ha avuto un'ischemia dell'arto target che richiedesse un intervento chirurgico o riparazione chirurgica del vaso target e nessuno ha avuto un peggioramento del punteggio Rutherford di due classi, o alla classe 5 e 6.

L'endpoint di sicurezza a 24 mesi è risultato dell'87,8% (79/90). Il 6,7% (6/90) dei pazienti ha avuto una rivascolarizzazione della lesione target indicata clinicamente, il 3,3% (3/90) è deceduto, nessuno ha avuto l'amputazione dell'arto target, l'1,1% (1/90) ha avuto un'ischemia dell'arto target che ha richiesto un intervento chirurgico o la riparazione chirurgica del vaso target e l'1,1% (1/90) ha avuto un peggioramento del punteggio di Rutherford di due classi, o alla classe 5 e 6.

14. MODALITÀ D'USO

Scelta del dispositivo

Fare riferimento alla lunghezza della lesione target per definire la lunghezza di stent da utilizzare. Per coprire adeguatamente la lesione, la lunghezza dello stent rilasciato dovrebbe essere almeno 5 mm superiore alla lunghezza della lesione stessa da ogni estremità.

Misurare il diametro di riferimento del vaso prossimale e distale alla lesione per definire il modello di stent da utilizzare. Per ottenere un posizionamento sicuro dello stent, scegliere il diametro dello stent sulla base del maggiore dei due diametri di riferimento. Nella scelta del modello fare riferimento alle informazioni riportate in tabella 1.

Preparazione del dispositivo

Prima di avviare la procedura di angioplastica, somministrare eparina per verificare che il tempo di coagulazione del paziente (ACT) sia adeguato in conformità alla pratica del Centro.

Durante la preparazione del sistema prestare particolare attenzione a non mettere in alcun modo lo stent a contatto con liquidi.

- Aprire la scatola ed estrarre la busta contenente la busta sterile.
- Dopo avere controllato che la confezione non sia stata danneggiata, aprire la busta esterna non sterile in alluminio ed estrarre il contenuto dalla busta interna (attenzione: la busta in alluminio e la superficie esterna della busta interna in plastica **NON SONO STERILI**). Solo il contenuto della busta in plastica è STERILE.
- Avendo cura di appoggiare il supporto su una superficie piana in campo sterile, sganciare la fascetta attorno al manipolatore e sfilare il catetere dal coll di protezione.
- Verificare che il catetere di posizionamento non presenti piegature, strozzature o altri danni. Eventuali danni al dispositivo possono compromettere le prestazioni.
- Riempire una siringa da 3 ml con una soluzione fisiologica eparinata, collegarla per il lavaggio al connettore luer (figura 1, elemento 12) ed applicare una pressione positiva. Continuare il lavaggio fino a quando la soluzione fisiologica non fuoriesca dall'estremità distale del catetere.
- Controllare l'estremità distale del catetere per accertarsi che lo stent (figura 1, elemento 4) sia contenuto all'interno della guaina esterna.
- Non usare il dispositivo se danneggiato o se lo stent risulta parzialmente espanso.

Compatibilità con gli accessori

Gli introduttori di diametro 6F (2,0 mm) o superiore possono essere usati con i dispositivi NiTiDES.

I fili guida di diametro 0,035 pollici (0,89 mm) o inferiore possono essere usati con i dispositivi NiTiDES. Il medico potrà scegliere in base alla propria esperienza clinica la rigidezza del filo guida e il tipo di punta.

Qualora si rendesse necessario utilizzare per la procedura un catetere guida, si tenga presente che i dispositivi sono compatibili con cateteri guida di diametro 8 F (2,7 mm) o superiore. In tal caso accertarsi che la valvola emostatica sia completamente aperta prima dell'introduzione dell'insieme selezionato.

Inserimento dello stent

- Accertarsi che la chiave di sicurezza (figura 1, elemento 10) del manipolatore sia in posizione di blocco (dettaglio B).

- b) Pulire la porzione esposta del filo guida con soluzione fisiologica eparinata al fine di rimuovere tracce di sangue e di liquido di contrasto.
 - c) Fare avanzare il sistema lungo il filo guida fino a che lo stent non raggiunge il sito da trattare.
- Se in qualunque momento si dovesse avvertire un'insolita resistenza, non forzare il sistema: estrarre insieme, come fossero un tutt'uno, l'introduttore, il filo guida ed il dispositivo. L'applicazione di una forza eccessiva e/o un'errata manipolazione potrebbero portare al rilascio accidentale dello stent o causare danni al catetere di posizionamento.

Avanzamento del dispositivo

- a) Far avanzare il sistema in modo che lo stent si trovi oltre la lesione da trattare.
- b) Arretrare il sistema fino a che lo stent si trovi posizionato a livello della lesione.
- c) Assicurarsi che la parte del sistema rimasta fuori dal paziente sia ben distesa e dritta

Attenzione: se il dispositivo non è ben disteso si può verificare il rilascio dello stent al di là della lesione target.

Impianto ed espansione dello stent

- a) Afferrando saldamente il manipolatore con una mano, verificare che i marker radiopachi dello stent siano in posizione prossimale e distale rispetto alla lesione.
- b) Accertarsi che l'introduttore non si sposti durante il rilascio dello stent.
- c) Ruotare la chiave di sicurezza del manipolatore in senso antiorario (figura 1, dettaglio B), portandola nella posizione di sblocco (STEP 1), quindi estrarla completamente (STEP 2).
- d) Mantenendo il manipolatore in posizione fissa rispetto al paziente, controllare ancora una volta che i marker radiopachi siano nella posizione prescelta rispetto alla lesione; iniziare il rilascio dello stent ruotando con il pollice la rotella (figura 1, elemento 9), secondo la direzione indicata dalla freccia, come illustrato nella figura 1.
- e) Sotto controllo fluoroscopico, quando la parte distale dello stent è ben adessa alla parete del vaso, continuare il rilascio mediante la rotazione della rotella fino ad osservare l'apertura dello stent e la sua completa apposizione alle pareti del vaso.
- f) Se si vuole eseguire il rilascio rapido, procedere come segue: accertarsi che in coda al manipolatore non esistano impedimenti (esempio: luer femmina avvitato), afferrare con l'altra mano la coda (pull-back, figura 1, elemento 11) del dispositivo e tirarla, mantenendo ben ferma la parte anteriore del manipolatore rispetto al paziente, come illustrato nella figura 1.
- g) Sotto controllo fluoroscopico verificare che lo stent sia completamente espanso.
- h) Qualora si renda necessario, lo stent può essere sottoposto ad una dilatazione successiva utilizzando un palloncino per PTA. Nella scelta del diametro del palloncino e nella realizzazione della post-dilatazione fare riferimento al diametro del vaso valutato angiograficamente. In ogni caso porre la massima attenzione a non espandere lo stent oltre il proprio diametro nominale, riportato in etichetta.
- i) Il diametro finale dello stent deve essere adeguato a quello del vaso di riferimento.

15.EFFETTI INDESIDERATI POTENZIALI

I possibili effetti indesiderati che possono essere associati all'impianto di uno stent periferico includono i rischi legati all'angioplastica percutanea transluminale e i rischi aggiuntivi correlati all'uso degli stent, come indicato di seguito.

- Infiezione, dolore e ematoma nel punto di accesso
- Reazione allergica o avversa al mezzo di contrasto, ai farmaci impiegati durante la procedura o ai materiali di composizione dello stent
- Spasmo arterioso
- Trombosi arteriosa o dello stent
- Aneurisma o pseudoaneurisma femorale
- Atero-embolizzazione distale
- Sanguinamento
- Morte
- Dissezione, perforazione o rottura del vaso trattato
- Embolo
- Insufficienza renale
- Ischemia degli arti inferiori (con necessità d'intervento chirurgico)
- Restenosì dell'arteria in cui è stato impiantato lo stent
- Embolizzazione dello stent
- Occlusione vasale o stenosi non risolta

16.RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Il Fabbriante assicura che il dispositivo è stato progettato, realizzato e confezionato con ogni cura utilizzando le tecniche ritenute più adatte fra quelle disponibili allo stato attuale della tecnologia e applicando principi di integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione atti a garantire un impiego sicuro, quando esso sia utilizzato alle condizioni e per i fini previsti rispettando le precauzioni indicate nei paragrafi precedenti, e comunque atti a ridurre nella misura del possibile, ma non eliminare totalmente, i rischi correlati con l'impiego del dispositivo.

Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente sotto la responsabilità di personale medico specializzato e tenendo conto dei rischi residui e dei possibili effetti collaterali e complicanze della terapia per cui esso è stato previsto, tra i quali quelli ricordati nelle altre sezioni del presente libretto di istruzioni.

La complessità tecnica e la criticità delle scelte mediche e delle modalità di applicazione del dispositivo escludono la fornitura da parte del Fabbriante di qualsiasi garanzia esplicita o implicita sulla bontà del risultato a seguito dell'impiego del dispositivo o sulla sua efficacia nel risolvere uno stato di infermità, o qualsiasi altra patologia o problema medico. Infatti i risultati, sia sotto il profilo clinico sia sotto il profilo della funzionalità e della durata del dispositivo, dipendono anche da numerosi fattori che sono al di fuori del controllo del Fabbriante, tra i quali spiccano, citati meramente come esempi e non esaustivi, le condizioni del paziente, la procedura chirurgica d'impianto o di impiego, le modalità di

manipolazione del dispositivo successivamente all'apertura della confezione. Alla luce di questi fattori la responsabilità del Fabbriante è pertanto limitata esclusivamente alla sostituzione del dispositivo qualora esso risulti affetto da vizi di produzione al momento della consegna. A tale scopo il Cliente deve mettere il dispositivo a disposizione del Fabbriante nel rispetto dei termini di scadenza e prescrizione previsti dalla legge; questo si riserva di esaminare il dispositivo ritenuto difettoso e di stabilire se effettivamente esso risulta affetto da vizi di fabbricazione che possono influire sulla sicurezza del prodotto.

La responsabilità del Fabbriante è esclusa se (i) il difetto lamentato è dovuto alla conformità del dispositivo a una regola imperativa o a una disposizione vincolante, e / o (ii) il difetto che ha causato il danno non esiste quando il Fabbriante ha rilasciato il dispositivo e / o (iii) se lo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche al momento in cui il Fabbriante ha rilasciato il dispositivo, non consentiva di considerare il dispositivo come difettoso, e / o (iv) in ogni altro caso, anche diverso da quelli sopra indicati, in cui la legge espressamente esclude, o limita, la responsabilità del Fabbriante per danni da prodotti difettosi.

La garanzia consiste esclusivamente nella sostituzione del dispositivo riscontrato difettoso con un altro di fabbricazione del Fabbriante dello stesso tipo o di tipo equivalente.

La garanzia si applica esclusivamente se il dispositivo viene restituito correttamente imbalsato al Fabbriante unitamente ad una relazione scritta e circostanziata sui difetti lamentati e, nel caso di dispositivo impiantato, sui motivi della rimozione dal paziente.

I difetti lamentati dovranno essere tempestivamente denunciati al Fabbriante nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione di legge.

Avvenuta la sostituzione il Fabbriante rimborserà al Cliente le spese da lui sostenute per la restituzione del dispositivo riconosciuto viziato.

Il Fabbriante declina ogni responsabilità in qualsiasi caso di mancata osservanza delle modalità di uso e delle cautele indicate nel presente libretto di istruzioni e in caso di impiego dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Il Fabbriante declina, inoltre, qualsiasi responsabilità relativamente alle conseguenze delle scelte mediche e alle modalità di utilizzo o applicazione del dispositivo e pertanto non sarà in nessun caso perseguitibile per qualsiasi danno di alcun genere, materiale, biologico o morale conseguente all'applicazione del dispositivo e alla scelta della tecnica di impianto utilizzata dall'operatore.

Gli agenti e rappresentanti del Fabbriante non sono autorizzati a modificare alcuna delle suddette condizioni né ad assumere alcun impegno aggiuntivo né a prestare alcuna garanzia in relazione al presente prodotto, al di là di quanto sopra indicato. Questa garanzia è regolata dalla legge italiana, salvo che non si applichino leggi imperative di un altro Stato, nel caso in cui il Fabbriante abbia autorizzato la circolazione del prodotto in uno o più stati diversi dall'Italia.

ESPAÑOL

NiTIDES

sistema de stent periférico autoexpandible liberador de Amphilius™ (sirolimus + ácido graso) recubierto de „Carbofilm™“

1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

La familia de dispositivos NiTiDES está formada por un stent autoexpandible y un sistema portador para su colocación y despliegue correctos.

El **stent** es un dispositivo implantable, flexible y autoexpandible. Está fabricado con una aleación de níquel y titanio (Nitinol) y está recubierto con „Carbofilm™“, una fina capa de carbono con una estructura turbostrática de alta densidad fundamentalmente idéntica a la del carbón pirólico.

El revestimiento proporciona al sustrato las características biocompatibles y hemocompatibles del carbón pirólico sin afectar a las propiedades físicas y estructurales de dicho sustrato.

Seis marcadores radiopacos de tantalio se aplican al stent (tres en cada extremo) para facilitar su colocación correcta en la lesión diana.

La superficie exterior del stent tiene unas ranuras especiales, totalmente recubiertas de „Carbofilm™“, que contienen la formulación farmacéutica Amphilius™, compuesta por el fármaco sirolimus y una mezcla de ácidos grasos de cadena larga.

La dosis específica de fármaco para la superficie del vaso tratado es de aproximadamente 0,9 µg/mm², que equivale a una dosis mínima de 270 µg en el stent de menor tamaño (6,0x20 mm) y una dosis máxima de 2420 µg en el stent de mayor tamaño (8,0x150 mm).

El **sistema portador** utilizado es de tipo 'sobre la guía' (OTW) y permite transportar el stent con seguridad hasta la lesión diana. Se muestra esquemáticamente en la figura 1 y está formado por:

- un cuerpo de catéter (7) de diámetro 6F compuesto por:
 - una vaina retráctil exterior, cuya sección distal semitransparente (3) contiene el stent (4); la vaina tiene un collar radiopaco (13) cerca de la punta del catéter;
 - una vía interna formada por un coil (6) y un tubo interno (2) compatible con un hilo guía de 0,035 pulgadas; la vía interna inicia proximalmente en el conector Luer (12) fijado en el mango del catéter y termina distalmente en la punta (1) de material radiopaco, para facilitar la ubicación y la colocación del stent cuando se utiliza un sistema de imágenes. Un tope (5) integrado en la vía interna impide el movimiento axial del stent durante la retracción de la vaina exterior;
 - un mango (8) con un sistema portador que permite colocar el catéter y soltar el stent *in situ*.

El diseño ergonómico del mango permite al operador sujetarlo y utilizarlo incluso con una sola mano. Tiene un conector Luer (12) en el extremo proximal que se usa para enjuagar la vía del hilo guía, una llave de seguridad (10), una ruedecilla (9) y una cuerda de retirada o «pull back» (11).

El Fabricante se encarga directamente de realizar el sistema de stent periférico + catéter portador y de llevar a cabo todos los procedimientos de control de calidad, tanto durante la fabricación como en los productos finales, de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación.

2. USO PREVISTO DEL DISPOSITIVO

El sistema de stent periférico autoexpandible está diseñado para el tratamiento de enfermedades arteriales periféricas en la arteria femoral superficial y la arteria poplítea proximal.

3. INDICACIÓN DEL DISPOSITIVO

El dispositivo está indicado para el tratamiento de estenosis en las arterias femoropopliteas sobre la rodilla en pacientes sintomáticos adultos [categoría 2-5 de Rutherford]. La lesión, cuya longitud máxima puede ser de 14 centímetros, debe estar ocluida o estenosada superior al 50%, ya sea de novo o reestenótica, y no haber sido previamente tratada con un stent.

4. CONTRAINDICACIONES

El uso del stent está contraindicado en las siguientes situaciones:

- Lesiones consideradas no tratables con ATP u otras técnicas intervencionistas.
- Mujeres embarazadas o lactantes.
- Lesiones localizadas en los dos tercios distales de la arteria poplítea o en la articulación de la rodilla.
- Condiciones clínicas que impiden el uso de las terapias antiplaquetarias y/o anticoagulantes.

5. ADVERTENCIAS

- No se recomienda el uso del dispositivo en pacientes con hipersensibilidad o alergias conocidas a Sirolimus, ácidos grasos (como ácido estearíco, ácido palmitíco, ácido behénico) o a los componentes metálicos del stent (como níquel, titanio y tántalo).
- El dispositivo está diseñado para un solo uso. No reutilizar, reprocessar ni reesterilizar, ya que esto podría causar riesgos de contaminación del dispositivo y/o infecciones en el paciente, inflamaciones y la transmisión de enfermedades infecciosas entre pacientes.
- El dispositivo se ha proyectado como un sistema integral. No utilizar sus componentes por separado.
- No utilizar el dispositivo si el envase está abierto o dañado, si no se ha almacenado correctamente o si ha vencido la fecha de caducidad. En dichos casos no está garantizada la esterilidad del producto.
- El dispositivo debe ser utilizado exclusivamente por médicos con formación específica para llevar a cabo intervenciones de angioplastia transluminal percutánea (ATP) e implantes de stents periféricos.
- Si en cualquier fase del procedimiento se advierte resistencia, no se debe forzar el sistema, sino que se retirará el sistema de stent y el conjunto formado

por el catéter portador, el hilo guía y el introductor como si fueran una sola unidad. Si se ejerce demasiada fuerza y/o se manipula incorrectamente, puede desplegarse accidentalmente el stent o dañarse el catéter de colocación.

- La manipulación incorrecta en cualquier momento de la operación puede provocar diseción, perforación o ruptura vascular.
- No avanzar ni retirar el stent durante el despliegue: esto podría causar daños graves a las paredes vasculares.
- La implantación de un stent periférico autoexpandible puede causar una diseción del vaso distal y/o proximal con respecto al stent, así como una oclusión aguda del vaso, lo que requerirá una intervención adicional (operación quirúrgica de sustitución vascular, mayor dilatación, implante de stents adicionales u otros procedimientos).
- Una vez que el stent se ha expandido parcialmente, no puede recuperarse mediante el sistema portador.

6. PRECAUCIONES

- **No usar nunca** el sistema de liberación rápida al principio de la expansión del stent. Usarlo **solo si es necesario**, tras soltar al menos **la mitad de la longitud** del stent.

- El dispositivo debe manipularse cuidadosamente a fin de evitar todo contacto con instrumentos metálicos o abrasivos que puedan dañarlo o producir alteraciones mecánicas.
- El dispositivo no debe entrar en contacto con líquidos antes de su preparación y colocación.
- El sistema de colocación del dispositivo no ha sido diseñado para usarlo con inyectores de medios de contraste.
- Cuando los stents se implantan en tandem, sus respectivos marcadores radiopacos deben superponerse. La superposición no debe implicar más de dos stents.
- En caso de stents superpuestos, se recomienda una longitud de superposición menor que 20 mm.
- Para evitar que se dañe el stent, hay que tener mucho cuidado al pasar un hilo guía, un catéter de balón u otros dispositivo a través del mismo cuando esté expandido.

7. NOTA INFORMATIVA SOBRE SEGURIDAD MRI

Las pruebas no clínicas han demostrado que las líneas de productos stent Nitinol del fabricante tienen compatibilidad condicional con la RM. Es posible escanear de forma segura a un paciente con este dispositivo en un sistema RM en las siguientes condiciones:

- Campo magnético estático de 1,5 teslas (1,5T) o 3 teslas (3T)
- Campo con gradiente espacial máximo de 6.140 G/cm (61,40 T/m)
- Sistema de RM máximo notificado, tasa de absorción específica (SAR) promedio para cuerpo completo:
 - 1 W/kg (modo de funcionamiento normal a 1,5T)
 - 1 W/kg (modo de funcionamiento normal a 3T)

Calentamiento por RF

En las condiciones de escaneo definidas a continuación, las líneas de stents Nitinol del fabricante suelen producir un aumento máximo de temperatura de menos de 6,8 °C después de 15 minutos de escaneo continuo en un sistema de RM notificado, con tasa de absorción específica (SAR) promedio para cuerpo completo de 1,0 W/kg.

Configuración con un solo stent

Cambio máximo de temperatura

Configuración con stents superpuestos

Cambio máximo de temperatura

1,5 T 3 T

≤ 6,3 °C ≤ 6,2 °C

≤ 6,8 °C ≤ 6,3 °C

Artefactos de RM

En pruebas no clínicas, el artefacto causado en las imágenes por el dispositivo se extiende aproximadamente 0,7 cm desde los stents Nitinol del fabricante con secuencias de eco del gradiente y eco del espín en un sistema de IRM de 3T.

8. EMBALAJE

El dispositivo NITIDES se suministra en estado estéril (mediante óxido de etileno y dióxido de carbono), para un solo uso, envasado en dos bolsas que no deben colocarse en un campo estéril. **NOTA: La bolsa interna es la única barrera estéril.** La esterilidad y la estabilidad química se garantizan con el envase intacto hasta la fecha de caducidad impresa en dicho envase (USAR ANTES DE).

Contenido: un (1) sistema de stent periférico autoexpandible liberador de Amphilius™ (sirolimus + ácido graso) recubierto de „Carbofilm™“

9. ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse tal como se indica en el envase, en un lugar fresco y seco a una temperatura máxima de 25 °C.

10. MODELOS

Cada dispositivo NITIDES se identifica mediante un código de modelo y un número de lote; los códigos de producto disponibles aparecen en la Tabla 1.

11. RÉGIMEN FARMACOLÓGICO

Los estudios clínicos publicados indican la necesidad de realizar una terapia antiplaquetaria preoperatoria, una terapia anticoagulante durante el procedimiento y un tratamiento antiplaquetario postoperatorio.

El tratamiento antiplaquetario en el periodo posterior al procedimiento implica la administración de:

- Tienopiridinas (ticlopidina, clopidogrel o prasugrel en las dosis indicadas en sus correspondientes prospectos o según la receta médica)
- Aspirina en una cantidad mínima de 100 mg/día durante un período indefinido

Dada la complejidad del procedimiento y los numerosos factores que influyen en el estado del paciente, la definición de la terapia apropiada se deja a discreción del médico.

12. INTERACCIÓN CON FÁRMACOS

Aunque no se dispone de datos clínicos específicos, ciertos fármacos, como el Tacrolimus, que actúan mediante la misma proteína de unión (FKBP), pueden interferir con la eficacia del Sirolimus. El Sirolimus es metabolizado por CYP3A4. Los inhibidores potentes de CYP3A4 pueden incrementar la exposición al Sirolimus, especialmente en caso de implante múltiple. También deberá tenerse en cuenta la exposición sistémica al Sirolimus si al mismo tiempo se está administrando fármacos immunosupresores por vía sistémica al paciente.

13. ENSAYO CLÍNICO CON NITIDES

La seguridad y efectividad primarias del stent NiTiDES se ha establecido a raíz del ensayo clínico fundamental previo a la comercialización ILLUMINA.

Diseño del estudio: En un estudio multicéntrico de un solo grupo, 100 pacientes con enfermedad femoropoplitea sintomática y longitud máxima de la lesión de 14 cm fueron tratados con el stent NiTiDES. Los criterios de valoración de la eficacia primaria (permeabilidad primaria) y la seguridad primaria (una combinación de eventos adversos mayores: muerte, amputación de la extremidad tratada, isquemia de la extremidad que requiera intervención o reparación quirúrgica del vaso tratado o revascularización de lesión objetiva determinada clínicamente, empeoramiento de la clasificación de Rutherford por 2 clases o hasta la clase 5 o 6) fueron comparados con una meta de rendimiento objetiva (OPG, por sus siglas en inglés) a los 12 meses.

Resultados: El éxito del procedimiento se logró en el 100% de los casos. Los resultados de la ecografía Doppler muestran una permeabilidad primaria del 87% (77/89, intervalo de confianza al 95% 80-94), cumpliendo los requisitos de la OPG (73%). La permeabilidad primaria en 24 meses fue del 81% (63/78). El criterio de valoración de la seguridad primaria a los 12 meses fue del 96,8% (90/93), cumpliendo los requisitos de la OPG (19,6%). Pacientes con revascularización de lesión objetivo determinada clínicamente: 2,2% (2/93). Pacientes fallecidos: 1,1% (1/93). Pacientes con amputación de la extremidad: 0. Pacientes con isquemia de la extremidad que requiera intervención o reparación quirúrgica del vaso tratado: 0. Pacientes con empeoramiento de la clasificación de Rutherford por 2 clases o hasta la clase 5 o 6: 0.

El criterio de valoración de la seguridad a los 24 meses fue del 87,8% (79/90). Pacientes con revascularización de lesión objetivo determinada clínicamente: 6,7% (6/90). Pacientes fallecidos: 3,3% (3/90). Pacientes con amputación de la extremidad: 0. Pacientes con isquemia de la extremidad que requiera intervención o reparación quirúrgica del vaso tratado: 1,1% (1/90). Pacientes con empeoramiento de la clasificación de Rutherford por 2 clases o hasta la clase 5 o 6: 1,1% (1/90).

14. MODO DE EMPLEO

Selección del dispositivo

Medir la longitud de la lesión diana para determinar la longitud requerida del stent. Para cubrir adecuadamente la lesión, la longitud del stent desplegado debe ser por lo menos 5 mm mayor que la lesión a cada lado.

Medir el diámetro de referencia del vaso proximal y distal con respecto a la lesión para determinar el tamaño correcto del stent. Para garantizar la colocación segura del stent, usar el diámetro mayor como base para elegir el stent de tamaño adecuado. Al elegir el modelo, consultar la información proporcionada en la tabla 1.

Preparación del dispositivo

Antes de implantar el stent, administrar heparina al paciente y comprobar que el tiempo de coagulación activado (TCA) cumple con lo establecido por las directrices del Centro.

Durante la preparación del sistema, tener mucho cuidado para que el stent no entre en contacto con ningún líquido.

- a) Abrir la caja y sacar la bolsa que contiene la bolsa interna estéril.
- b) Tras comprobar que el envase no presenta daños, abrir la bolsa externa de aluminio no estéril y sacar el contenido de la bolsa interna. (Nota: La bolsa de aluminio y la superficie exterior de la bolsa interna de plástico **NO SON ESTÉRILES**. Solo el contenido de la bolsa de plástico es ESTÉRIL).
- c) Con cuidado para poner el soporte en una superficie plana en un campo estéril, desabrochar la cinta alrededor del mango y sacar el catéter del collar de protección.
- d) Comprobar que el catéter portador no está estrangulado, plegado ni presenta otros daños. Cualquier daño al dispositivo puede perjudicar su rendimiento.
- e) Llenar una jeringa de 3 ml de solución fisiológica que contenga heparina, conectarla al conector Luer de enjuague (figura 1, ítem 12) y aplicar una presión positiva. Seguir enjuagando hasta que la solución fisiológica salga por el extremo distal del catéter.
- f) Inspeccionar el extremo distal del catéter, asegurándose de que el stent (figura 1, ítem 4) está completamente cubierto por la vaina exterior.

No usar el dispositivo si está dañado o si el stent está parcialmente expandido.

Compatibilidad con accesorios

Con el dispositivo NiTiDES pueden utilizarse introductores de diámetro 6F (2,0 mm) o superior.

Con los dispositivos NiTiDES pueden utilizarse hilos guía de 0,035 pulgadas (0,89 mm) o menos. El grado de rigidez del hilo guía y la configuración de su punta quedan a criterio de la experiencia clínica del médico.

Si fuera necesario utilizar un catéter guía, los sistemas son compatibles con catéteres guía de diámetro 8F (2,7 mm) o mayor. En ese caso, asegurarse de que la válvula hemostática está totalmente abierta antes de introducir el grupo seleccionado.

Introducción del stent

a) Asegurarse de que la llave de seguridad (figura 1, ítem 10) del mango está en la posición bloqueada (detalle B).

b) Lavar la parte expuesta del alambre de guía con una solución fisiológica que contenga heparina para retirar las trazas de sangre y medio de contraste.

- c) Avanzar el sistema sobre la guía de alambre hasta que el stent llegue a la zona de tratamiento.

Si en cualquier momento se advierte una resistencia inusual, no se debe forzar el sistema, sino retirar el introductor, el hilo guía y el dispositivo como si fueran una sola unidad. Si se ejerce demasiada fuerza y/o se manipula incorrectamente, puede desplegarse accidentalmente el stent o dañarse el catéter de colocación.

Avance del dispositivo

- a) Avanzar el sistema hasta que el stent se encuentre más allá de la lesión.
- b) Retroceder el sistema hasta que el stent esté alineado con la lesión.
- c) Comprobar que la parte del sistema portador que se encuentra fuera del cuerpo del paciente está bien extendida y recta.

Precaución: Si el sistema portador no está bien extendido, el stent podría desplegarse más allá de la lesión diana.

Implantación y expansión del stent

a) Sujetando firmemente el mango con una mano, comprobar que los marcadores radiopacos del stent están en posición proximal y distal con respecto a la lesión.

b) Asegurarse de que el introductor no se mueve durante el despliegue del stent.

c) Girar la llave de seguridad (10) en el mango en el sentido contrario a las agujas del reloj (figura 1, detalle B) para desbloquearla (PASO 1) y, a continuación, extraerla completamente (PASO 2).

d) Sujetando el mango en una posición fija con respecto al paciente, volver a comprobar que los marcadores radiopacos están en la posición deseada con respecto a la lesión; empezar a desplegar el stent girando la ruedecilla (figura 1, ítem 9) con el pulgar en la dirección de la flecha, como se indica en la figura 1.

e) Mediante fluoroscopia, cuando el extremo distal del stent esté bien adherido a las paredes del vaso, seguir desplegando el stent con la ruedecilla hasta que el extremo se abra y esté completamente implantado en dichas paredes.

f) Si se requiere un despliegue rápido, es necesario proceder de la siguiente manera: asegurarse de que no haya obstrucciones (p. ej. conector Luer hembra atornillado) en el extremo trasero del mango; sujetar la parte trasera del dispositivo («pull-back», figura 1, ítem 11) con la otra mano y tirar de ella, sujetando la parte delantera del mango de forma que esté totalmente inmóvil con respecto al paciente, como se muestra en la figura 1.

g) Mediante fluoroscopia, asegurarse de que el stent está expandido totalmente.

h) El stent se puede expandir aún más, si es necesario, usando un catéter balón para ATP. Al elegir el diámetro del catéter balón, y al realizar la postexpansión, consultar el diámetro del vaso que se había evaluado por angiografía. En cualquier caso, tener mucho cuidado para no expandir el stent más allá del diámetro nominal indicado en la etiqueta.

i) El diámetro final del stent debe ser idóneo para el diámetro del vaso de referencia.

15. REACCIONES ADVERSAS POTENCIALES

Los posibles efectos adversos que pueden asociarse con la implantación de un stent periférico incluyen riesgos relacionados con la angioplastia transluminal percutánea y riesgos adicionales asociados con el uso de stents, tal como se indica a continuación.

- Infección, dolor y hematoma en el punto de acceso
- Reacción alérgica o adversa al medio de contraste, los fármacos usados durante el procedimiento o los materiales que forman el stent
- Espasmo arterial
- Trombosis arterial o con stent
- Aneurisma o pseudoaneurisma de la arteria femoral
- Embolización distal aterosclerótica
- Sangrado
- Muerte
- Disección, perforación o rotura del vaso con soporte
- Embolia
- Fallo renal
- Isquemia de miembros inferiores (requiere intervención quirúrgica)
- Reestenosis de la arteria en la que se ha implantado el stent
- Embolización del stent
- Occlusión vascular o estenosis no resuelta

16. RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA

El fabricante garantiza que este dispositivo ha sido diseñado, fabricado y embalado con el máximo cuidado, usando los procedimientos más adecuados que permite el estado actual de la tecnología y aplicando principios de seguridad integrados en el diseño y la fabricación que garantizan el uso seguro del producto en las condiciones y para los propósitos previstos, de conformidad con las precauciones descritas en los párrafos anteriores, y que, en todo caso, reducen lo más posible, pero no eliminan completamente, los riesgos asociados al uso del dispositivo.

El dispositivo se debe utilizar exclusivamente bajo la responsabilidad de personal médico especializado y tomando en cuenta los riesgos residuales, efectos colaterales y posibles complicaciones de la terapia prevista, incluidos los que figuran en otros apartados de este manual de instrucciones.

Dada la complejidad técnica, la naturaleza crítica de las opciones de tratamiento y los métodos utilizados para implantar el dispositivo, el fabricante no puede garantizar, explícita o implícitamente, la calidad de los resultados después del uso del dispositivo ni su eficacia para resolver una discapacidad, una patología o cualquier otro problema médico. De hecho, los resultados, tanto en términos clínicos como de funcionalidad y duración del dispositivo, también dependen de numerosos factores que están fuera del control del fabricante, entre los que se citan como ejemplos no exhaustivos el procedimiento quirúrgico de implante o aplicación y la manipulación del dispositivo después de abrir su envase.

A la luz de estos factores, el fabricante solo se considera responsable si se comprueba que el dispositivo presentaba defectos en el momento de su comercialización. A tal efecto, el cliente debe poner el dispositivo a disposición

del fabricante lo antes posible, conforme a los plazos de caducidad y prescripción previstos por ley. El fabricante se reserva el derecho de examinar el dispositivo supuestamente defectuoso y de establecer si efectivamente presenta defectos capaces de afectar la seguridad del producto. El fabricante no se considerará responsable en cualquiera de los siguientes casos: (i) si el defecto reclamado está asociado al cumplimiento del dispositivo con una norma obligatoria o disposición vinculante; (ii) si el defecto que causó el daño no existía cuando el fabricante comercializó el dispositivo; (iii) si el estado del conocimiento técnico y científico al comercializar el dispositivo no permitía considerarlo defectuoso; (iv) en cualquier otro caso, incluso distinto a los anteriormente mencionados, en el que la ley excluya o limite expresamente la responsabilidad del fabricante por daños causados por productos defectuosos. La garantía consiste exclusivamente en la sustitución del dispositivo defectuoso por otro dispositivo del fabricante que sea igual o equivalente.

La garantía aplica únicamente en caso de devolución correcta del dispositivo al fabricante junto con un informe escrito que detalle los defectos reclamados y, en el caso de un dispositivo implantado, las zonas por las que se extrajo del paciente. Los defectos reclamados deberán notificarse de inmediato al fabricante conforme a los plazos de caducidad y prescripción previstos por la ley.

Una vez reemplazado el dispositivo, el fabricante reembolsa al cliente los gastos en los que haya incurrido para la devolución del producto defectuoso.

El fabricante rechaza cualquier responsabilidad en caso de incumplimiento de los métodos de uso y de las precauciones que figuran en este manual de instrucciones, así como en caso de que el dispositivo se utilice después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Asimismo, el fabricante rechaza cualquier responsabilidad relacionada con las consecuencias que surjan de las decisiones médicas y los métodos de uso o aplicación del dispositivo, por lo cual no se le podrá enjuiciar, bajo ninguna circunstancia, por daños materiales, biológicos o morales que resulten de la aplicación del dispositivo o de la técnica de implantación utilizada por el médico. Los agentes y representantes del fabricante no están autorizados a modificar ninguna de las condiciones previamente mencionadas, asumir compromisos adicionales ni ofrecer garantías distintas de las establecidas anteriormente en relación con este producto. Esta garantía se rige por la ley italiana, salvo en caso de aplicación de leyes obligatorias de otro país si el fabricante ha sido autorizado a comercializar el producto en uno o más países fuera de Italia.

DANSK

NITIDES

Carbofilm™-belagt, selvudvidende Amphilimus™ (Sirolimus + fedtsyre) eluerende perifert stentsystem

1. BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN

Familien af NiTiDES-anordninger består af en selvudvidede stent og et indføringssystem for korrekt positionering og placering af stenten.

Stenten er en fleksibel, selvudvidende implantbar anordning. Den består af en nikkel-titan-legering (Nitinol), der er belagt med Carbofilm™, et tyndt lag af kulstof med en turbostratisk struktur af høj tæthed, der i det væsentlige er identisk med strukturen af pyrolytisk carbon.

Belægningen af substratet forsyner det med de bio- og hæmokompatible egenskaber af pyrolytisk carbon uden at påvirke selve substratets fysiske og strukturelle egenskaber.

På stenten befinner der sig seks røntgenfaste talntmarkører (tre i hver ende) for at muliggøre korrekt positionering på stedet med målæsionen.

Stentens udvendige overflade har særlige riller, der er fuldt belagt med Carbofilm™ og indeholder den farmaceutiske formulering Amphilimus™, som består af lægemidlet Sirolimus og en blanding af langkædede fedtsyrer.

Den specifikke dosering af lægemidlet for den karoverflade, der behandles, er ca. 0,9 µg/mm², som svarer til en minimal dosis på 270 µg på den mindre stent (6,0 x 20 mm) og en maksimal dosis på 2.420 µg på den større stent (8,0 x 150 mm). Det anvendte indføringssystem er af OTW-typen (over the wire) og sikrer, at stenten kan positioneres og frigives sikker ved læsionen. Det vises skematisk i figur 1 og består af:

- et kætterhus (7) med diameter 6F bestående af:
 - et tilbagetrækkeligt udvendigt hylster, hvis distale, halvtransparente sektion (3) indeholder stenten (4); hylstret har en røntgenfast krave (13) i nærheden af kætterrets spids;
 - en indvendig lumen, bestående af en spole (6) og en indvendig slange (2), der er kompatibel med en guidewire på 0,035 tommer; den indvendige lumen forløber langs med kætret fra en luerriftning (12), der er fastgjort proksimalt til grebet, og slutter distalt ved spidsen (1) i røntgenfast materiale for at gøre det muligt at finde og placere stenten, når den ses på et billeddannelsessystem. En stopper (5), der er integreret i den indvendige lumen, forhindrer aksial forskydning af stenten under tilbagetrækningen af det udvendige hylster;
 - et greb (8) med et indføringssystem, som gør det muligt at positionere kætret og placere stenten på stedet.

Grebet har et ergonomisk design, der gør det muligt for brugeren af gribe og bruge det selv med en hånd. Det har en luerport (12) ved den proksimale ende, som bruges til at skylle guidewire-lumenen, en sikkerhedsnøgle (10), et hjul (9) og en tilbagetrækningssende (11).

Producenten fremstiller den perifere stent og placeringskætret selv og implementerer alle kvalitetsstyringsprocedurer både under produktionen og på de færdige produkter i overensstemmelse med retningslinjerne for god fremstillingspraksis.

2. TILTÆNKT ANVENDELSE AF ANORDNINGEN

Det selvudvidende perifere stentsystem er beregnet til behandling af perifer arteriesygdom, der påvirker den overfladiske lärbensarterie og den proksimale popliteale arterie.

3. INDIKATION

Anordningen er indikeret til behandling af stenoze af femoropopliteale arterier over knæet hos voksne symptomatiske [Rutherford-kategori 2-5] patienter. Den behandelte læsion, med en maksimal længde på 14 centimeter, skal enten være okkluderet eller med stenoze højere end 50%, de novo eller restenotisk, ikke tidligere behandlet med en stent.

4. KONTRAINDIKATIONER

Anvendelse af stenten er kontraindikert i følgende situationer:

- Læsioner, der betragtes som umulige at behandle med PTA eller andre interventionelle teknikker.
- Gravide og ammende kvinder.
- Læsioner placeret i de to distale tredjedele af den popliteale arterie eller ved knæleddet.
- Kliniske betingelser, der begrænser brugen af antitrombocyt- og/eller antikoagulanterapi.

5. ADVARSLER

- Brug af anordningen anbefales ikke til patienter med kendt overfølsomhed eller allergier over for Sirolimus, fedtsyrer (som f.eks. stearintsyre, palmitinsyre, behensyre) eller stentens metalkomponenter (nikkel, titan og tantal).
- Anordningen er udelukkende beregnet til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Det kan medføre fare for forurening af anordningen og/eller infektioner hos patienten, betændelse og overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient.
- Anordningen er beregnet til at fungere som et system. Dens komponenter må ikke anvendes separat.
- Anordningen må ikke bruges, hvis dens emballage er blevet åbnet eller beskadiget eller opbevaret forkert eller hvis det oplyste udlebsdato er overskredet. I sådanne tilfælde kan produktets sterilitet ikke garanteres.
- Anordningen bør kun bruges af læger, der er specielt uddannet i at udføre perkutan transluminai angioplasti (PTA) og implantation af perifere stenter.
- Hvis man på noget tid af proceduren støder på modstand, må man ikke forcere systemet. Træk stentsystemet og hele indføringskætret, guidewiren og indføringsanordningen tilbage som en samlet enhed. Brug af overdrevne kraft og/eller forkert håndtering kan medføre utilsigtet placering af stenten eller beskadigelse af placeringskætret.

- Forkert håndtering kan når som helst under operationen forårsage dissektion, perforation eller ruptur af karret.
- Stentsystemet må ikke føres frem eller trækkes tilbage under placeringen: Det kan forårsage alvorlig beskadigelse af karvæggene.
- Implantationen af en selvudvidende perifert stent kan forårsage dissektion af det kar, der befinder sig i distal og/eller proksimal position til stenten, og kan også forårsage en akut blokering af karret, hvilket nødvendiggør endnu en operation (kirurgisk vaskulær udskiftningsoperation, yderligere dilatation, placering af yderligere stenter eller andre procedurer).
- Når stenten er blevet delvist placeret, kan den ikke trækkes tilbage ved hjælp af indføringssystemet.

6. FORHOLDSREGLER

- Brug aldrig kvikfrigivelsessystemet i starten af stentudvidelsen.** Brug det **kun om nødvendigt**, efter frigivelse af mindst **halvdelen af stentens længde**.
- Anordningen bør håndteres forsigtigt for at forhindre enhver kontakt med metaliske eller slibende instrumenter, der kan beskadige anordningen eller forårsage mekaniske forandringer.
- Anordningen bør ikke komme i kontakt med væsker inden forberedelse og positionering.
- Anordningens placeringssystem er ikke beregnet til brug med kontrastmidelinjektorer.
- Hvis stenter implanteres som tandem, bør de relative røntgenfaste markører overlæbbe. Overlæppning bør ikke involvere mere end to stenter.
- I tilfælde af overlappende stenter anbefales en overlapningslængde på mindre end 20 mm.
- For at undgå beskadigelse af stenten skal man være yderst forsigtig, når man fører en guidewire, et ballonkatereter eller en anden anordning gennem en stent, der er blevet placeret.

7. MRI-SIKKERHEDSINFORMATION

Ikke-kliniske undersøgelser har vist, at producentens Nitinol-stentprodukter er MR-sikre under visse betingelser (MR Conditional). En patient med denne anordning kan trygt scannes i et MR-system, der opfylder følgende betingelser:

- Statisk magnetisk felt på 1,5-Tesla (1,5T) eller 3-Tesla (3T)
- Maksimal rumlig feltgradient på 6,140 G/cm (61,40 T/m)
- Maksimal MR-systemrapporteret gennemsnitlig specifik absorptionshastighed for hele kroppen (SAR) på:
 - 1 W/kg (normal driftstilstand) ved 1,5T
 - 1 W/kg (normal driftstilstand) ved 3T

RF-opvarmning

Under de scanningsbetegnelser, der er defineret ovenfor, forventes producentens Nitinol-stentprodukter at generere en maksimal temperaturstigning på mindre end 6,8°C efter 15 minutters kontinuerlig scanning med en maksimal MR-systemrapporteret gennemsnitlig specifik absorptionshastighed for hele kroppen (SAR) på 1,0 W/kg.

	1,5 T	3 T
Højeste temperaturændring	$\leq 6,3^{\circ}\text{C}$	$\leq 6,2^{\circ}\text{C}$
Konfiguration med overlappende stenter	$\leq 6,8^{\circ}\text{C}$	$\leq 6,3^{\circ}\text{C}$

MR-arteftakt

Ved ikke-kliniske undersøgelser har det billedeartefakt, der er forårsaget af anordningen, en udstrækning på ca. 0,7 cm fra producentens Nitinol-stenter, når de billeddannes med gradientekko- og spinekkoimpulspulssekvenser i et 3T MR-system.

8. LEVERINGSFORM

NiTides-anordningen leveres steril (ved hjælp af en blanding af ethylenoxid og CO₂), til engangsbrug og emballeret i to poser, der ikke må tages med ind i et steril område. **BEMÆRK: Den indvendige pose er den eneste sterile barriere.** Sterilitet og kemiisk stabilitet er garanteret, mens pakken forbliver intakt og indtil den udløbsdato, der er trykt på pakken (HOLDBARHEDSDATO).

Indhold: Et (1) xCarbofilm™-belagd, selvudvidende Amphilius™ (Sirolimus + fedtsyre) eluerende perifert stentsystem

9. OPBEVARING

Produktet bør opbevares som angivet på emballagen, køligt og tørt, med en opbevaringstemperatur på højst 25°C.

10. MODELLER

NiTides-anordningen identificeres med en modelkode og et batchnummer; disponible produktkoder er opført i tabel 1.

11. LÆGEMIDDELREGIMEN

Studier i den kliniske litteratur indikerer behovet for at administrere antitrombocytterapi for indgribet, antikoagulanterapi under indgribet og antitrombocytbehandling efter indgribet.

Antitrombocytbehandling i perioden efter indgribet involverer administration af:

- Thienopyridin (ticlopidin eller clopidogrel) eller prasugrel i de doser, der angives i de respektive instruktionsbøger eller iht. lægeordnering
- Aspirin i en mængde på mindst 100 mg/dag, ubegrænset

Da proceduren er kompleks og der er mange faktorer, der påvirker patientens tilstand, skal beslutningen om definitionen af den passende terapi overlades til lægen.

12. INTERAKTION MED LÆGEMIDLER

Selv om specifikke kliniske data ikke er til rådighed, kan visse lægemidler, f.eks. Tacrolimus, som virker gennem det samme bindingsprotein (FKBP), påvirke effektiviteten af Sirolimus. Sirolimus metaboliseres af CYP3A4. Stærke CYP3A4-inhibitorer kan forårsage øget eksponering for Sirolimus, især i tilfælde af flere

implantater. Systemisk eksponering for Sirolimus skal også tages i betragtning, hvis patienten samtidigt tager systemiske immunosuppressive lægemidler.

13. KLINISK FORSØG MED NITIDES

Principiel sikkerhed og effektivitet af NiTiDES-stenten er blevet fastslået i det afgørende kliniske forsøg inden markedsføring ILLUMINA.

Studiens design: I en multicenter-enkeltdarmsstudie blev 100 patienter med symptomatisk femoropopliteal sygdom med en maksimal lesionslængde på 14 cm behandlet med NiTiDES-stenten. Den primære effektivitet (primær åbenhed) og det primære sikkerhedsstoltpunkt (en sammensætning af væsentlige uønskede hændelser: død, amputation af målekstremitet, iskæmi af målekstremitet, der kræver kirurgisk indgreb eller kirurgisk reparation af målkår eller klinisk drevet revaskularisering af mållæsion, forværring af Rutherford-score med 2 klasser, eller til klasse 5 eller 6) blev sammenlignet med et OPG (objektivt præstationsmål) efter 12 måneder.

Resultater: Procedureresultat blev opnået i 100%.

Resultater for Doppler-ultralyd viser primær åbenhed på 87% (77/89, 95% konfidensinterval 80-94), hvilket opfylder kravene af OPG (73%). Primær åbenhed efter 24 måneder var 81% (63/78).

Det primære sikkerhedsstoltpunkt efter 12 måneder var 96,8% (90/93), hvilket opfylder kravene af OPG (19,6%), 2,2% (2/93) af patienterne havde klinisk drevet revaskularisering af mållæsion, 1,1% (1/93) døde, 0 havde amputation af målekstremitet, 0 havde iskæmi af målekstremitet, der kræver kirurgisk indgreb eller kirurgisk reparation af målkår, og 0 havde forværring af Rutherford-score med 2 klasser, eller til klasse 5 eller 6.

Sikkerhedsstoltpunkt efter 24 måneder var 87,8% (79/90), 6,7% (6/90) af patienterne havde klinisk drevet revaskularisering af mållæsion, 3,3% (3/90) døde, 0 havde amputation af målekstremitet, 1,1% (1/90) havde iskæmi af målekstremitet, der kræver kirurgisk indgreb eller kirurgisk reparation af målkår, og 1,1% (1/90) havde forværring af Rutherford-score med 2 klasser, eller til klasse 5 eller 6.

14. BRUGSANVISNING

Vigtig at anordne

Brug længden af mållæsionen til at bestemme længden af den nødvendige stent. For at dække læsionen forsvarligt bør den placerede stentlængde være mindst 5 mm længere end selve læsionen på begge sider.

Brug diameteren af karret proksimalt og distalt i forhold til læsionen for at bestemme den passende stentstørrelse. For at sikre sikker placering af stenten brug den største diameter som grundlag for valget af den passende stentstørrelse. Ved valg af model se oplysningerne i tabel 1.

Forberedelse af anordningen

Administrér heparin inden stentindføringen og kontrollér, at patientens aktiverede koagulationsstid (ACT) er adækvat i overensstemmelse med centrets praksis.

Under forberedelsen af systemet skal man være særlig opmærksom på, at væsker ikke kommer i kontakt med stenten.

- Abn kassen og tag posen, der indeholder den sterile pose, ud.
- Undersøg pakken for beskadigelse, abn derefter den ikke-sterile aluminiumsfoliepose og fjern indholdet fra den indvendige pose. (Bemærk: Aluminiumsfolieposen og den udvendige overflade af den indvendige plastpose **ER IKKE STERILE**. Kun plastposens indhold er STERILT).
- Sørg for at placere statten på en flad overflade i et steril område, løsn båndet omkring grebet og fjern katetret fra beskyttelsesspolen.
- Kontrollér, at indføringskatetret ikke har knæk, bøjninger eller andre beskadigelser. Beskadigelse af anordningen kan forringe dens ydeevne.
- Fyld en 3 ml-sprøjte med en fysiologisk oplosning indeholdende heparin, tilslut den til luerfettingen for skyllning (figur 1, punkt 12) og anvend positivt tryk. Fortsæt skyllningen, indtil den fysiologiske oplosning kommer ud af katetrets distale ende.
- Inspicér katetrets distale ende og kontrollér, at stenten (figur 1, punkt 4) dækkes helt af det udvendige hylster.

Anvend ikke anordningen, hvis den er beskadiget eller hvis stenten er delvist udvasket.

Kompatibilitet med tilbehør

Indføringsanordningshylstre med en diameter på 6F (2,00 mm) eller mere kan anvendes sammen med NiTiDES-anordninger.

Guidewirer på 0,035 tommer (0,89 mm) eller mindre kan anvendes sammen med NiTiDES-anordnerne. Valg af guidewirens stivhed og spidsens udformning vil afhænge af lægens kliniske erfaring.

Skulle det være nødvendigt at anvende et styrekateter, er systemerne kompatible med styrekatetre med en diameter på 8F (2,7 mm) eller mere. I dette tilfælde skal man sikre sig, at hæmostaseventilen er helt åben, før den valgte anordning indføres.

Indføring af stent

- Kontrollér, at grebets sikkerhedsnøgle (figur 1, punkt 10) er i låst position (detalje B).
- Vask den eksponerede del af guidewiren med en heparinholidig fysiologisk oplosning for atjerne spor af blod og kontrastmidler.
- Før systemet frem med guidewiren, indtil stenten nær behandlingsstedet. Hvis man på noget tidspunkt støder på modstand, må man ikke forcere systemet: Træk indføringsanordningen, guidewiren og anordningen tilbage som en samlet enhed. Brug af overdriven kraft og/eller forkert håndtering kan medføre utilsigtet placering af stenten eller beskadigelse af placeringskatetret.

Fremføring af anordningen

- Før systemet frem, indtil stenten befinder sig på den anden side af læsionen.
- Træk systemet tilbage, indtil stenten er på højde med læsionen.
- Kontrollér, at den del af indføringssystemet, der befinder sig uden for patientens krop, er kørt ud fri og lige.

Forsigtig: Hvis indføringssystemet ikke er kørt ud korrekt, kan stenten måske placeres på den anden side af mållæsionen.

Implantation og udvidelse af stent

- a) Hold grebet godt fast med den ene hånd, kontrollér, at de røntgenfaste markerer på stenten er placeret proksimalt og distalt i forhold til læsionen.
- b) Sørg for, at indføringsanordningens hylster ikke bevæger sig, mens stenten placeres.
- c) Drej sikkerhedsnæglen på grebet mod uret (figur 1, detalje B) for at løse den op (SKRIDT 1) og træk den helt ud (SKRIDT 2).
- d) Hold grebet i en fast stilling i forhold til patienten, kontrollér igen, at de røntgenfaste markerer er i den ønskede stilling i forhold til læsionen; start placeringen af stenten ved at dreje hjulet (figur 1, punkt 9) med tommelfingeren i pilens retning som vist i figur 1.
- e) Når stentens distale ende sidder godt fast i karvæggen, fortsæt under fluoroskop med placeringen ved at dreje hjulet, indtil stentens ende er åben og den er helt implanteret i karrets vægge.
- f) Fremgangsmåde, hvis hurtig placering er nødvendig: Sørg for, at der ikke er forhindringer (f.eks. skruet hunluerfittin) i grebets bagende, tag fat i anordningens bagende (tilbagetrækning, figur 1, punkt 11) med den anden hånd og træk i den, mens frontdelen af grebet i forhold til patienten holdes helt stille, som vist i figur 1.
- g) Kontrollér fluoroskopisk, at stenten er udvidet helt.
- h) Stenten kan udvides yderligere, om nødvendigt, ved hjælp af et PTA-ballonkatereter. Ved valg af ballonkatereters diameter og udførelsen af en senere udvidelse brug diameteren af det kar, der er blevet vurderet ved hjælp af angiografi. Under alle omstændigheder skal man være meget opmærksom på ikke at udvide stenten med mere end dens nominelle diameter, der er oplyst på etiketten.
- i) Stentens endelige diameter skal være egnet til referencekarrets diameter.

15. MULIGE BIVIRKNINGER

Til de mulige bivirknninger, der kan være forbundet med implantationen af en perifer stent, hører risici i forhold til perkutan transluminal angioplasti og yderligere risici, der er forbundet med brugen af stenter, som nævnt nedenfor.

- Infektion ved adgangsstedet, smerte og hämatom
- Allergisk eller negativ reaktion mod kontrastmiddel, lægemidler anvendt under indgrebet eller de materialer, stenten består af
- Arteriespasme
- Arteriel trombose eller stenttrombose
- Aneurisme eller pseudoaneurisme af femoralarterie
- Atherosklerotisk distal embolisering
- Blødning
- Død
- Dissektion, perforation eller ruptur af karret med stent
- Emboli
- Nyresvigt
- Iskæmi i underkrestremitterne (kraver kirurgisk indgreb)
- Restenose af den arterie, stenten blev implanteret i
- Stent-embolisering
- Karokklusion eller uløst steno

16. HÆFTELSE OG GARANTI

Producents garanterer, at anordningen er designet, fremstillet og pakket med den største omhu ved hjælp af de teknikker, der betragtes som mest egnet blandt dem, der er til rådighed med teknikkens nyeste stand, og under anvendelse af principper for integration af sikkerhed i design og konstruktion for at garantere sikker anvendelse, når anordningen bruges under de betingelser og til de tiltænkte formål samt under hensyntagen til de forholdsregler, der er angivet i afsnitene ovenfor og som under alle omstændigheder har til formål at reducere farene, der er forbundet med brugen af anordningen, så meget som muligt, uden at de dog kan fjernes helt.

Anordningen må udelukkende anvendes under ansvaret af medicinsk specialpersonale og under hensyntagen til restriktioner og eventuelle bivirkninger og komplikationer af den behandling, den er beregnet til, inklusive dem, som er nævnt i de andre afsnit af denne instruktionsbog.

Den tekniske kompleksitet og den kritiske karakter af medicinske valg og anordningens anvendelsesmetoder udelukker enhver garanti ved producenten, udtrykkelig eller underforstået, for effektiviteten af resultatet efter brug af anordningen eller dens effektivitet til løsning af en tilstand af invaliditet eller nogen anden patologi eller medicinske problem. Faktisk afhænger resultaterne, både fra klinisk synspunkt og med henblik på anordningens funktionalitet og varighed, også af flere faktorer, der er udenfor producentens kontrol; kun som eksempler nævnes, uden at være udformende, patientens tilstand, den kirurgiske procedure for implantation og brug, metoderne for håndtering af anordningen efter åbning af pakken.

Under hensyntagen til disse faktorer eksisterer producentens hæftelse kun, hvis det er blevet vist, at anordningen var påvirket af mangler på det tidspunkt, hvor den blev bragt i omløb. Til dette formål skal kunden straks stille anordningen til rådighed for producenten, i overensstemmelse med de lovbestemte vilkår for udløb og præskription; producenten forholder sig retten til at undersøge anordningen, der betragtes som defekt, og til at bestemme, om den faktisk er påvirket af mangler, der kan påvirke produktets sikkerhed. Producentens hæftelse er udelukket, hvis (i) den påståede defekt skyldes overensstemmelse af anordningen med en obligatorisk regel eller en bindende bestemmelse, og / eller (ii) hvis manglen, der forårsagede beskadigelsen, ikke eksisterede, da producenten frigav anordningen, og / eller (iii) hvis den tekniske og videnskabelige vidensstatus på tidspunktet for frigivelsen af anordningen ved producenten endnu ikke tillod at betragte anordningen som defekt, og / eller (iv) i alle andre tilfælde, også andre end de ovennævnte, hvor lovgivningen udtrykkeligt udelukker eller begrænser producentens ansvar for skader, der skyldes defekte produkter. Garantien omfatter udelukkende erstathningen af den defekte anordning med en anden af samme eller tilsvarende type fra producenten.

Garantien gælder kun, hvis anordningen returneres korrekt til producenten sammen med en skriftlig og detaljeret rapport om de påståede mangler og, i tilfælde af en implanteret anordning, om årsagerne til fjernelsen fra patienten.

De påståede mangler skal straks indberettes til producenten i overensstemmelse med vilkårene for fortabelse og lovbestemt præskription. Når erstathningen er foretaget, vil producenten refundere kunden de udgifter, der skyldes returneringen af den anerkendte defekte anordning.

Producenten afviser ethvert ansvar i tilfælde, hvor anvendelsesmetoderne og forholdsreglerne angivet i denne instruktionsbog ikke er blevet overholdt, og desuden afviser producenten ethvert ansvar for følgerne af medicinske valg og anordningens anvendelsesmetoder og kan derfor under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for materielle, biologiske eller moralske skader af nogen art, der følger anvendelsen af anordningen og valget af den implantationsteknik, der blev anvendt af brugeren.

Producents agenter og repræsentanter er ikke autoriseret til at ændre de ovennævnte betingelser eller påtage sig yderligere forpligtelser eller give andre garantier i forhold til dette produkt end de ovennævnte. Denne garanti er underlagt italiensk lov, medmindre et andet lands præceptive lovgivning anvendes, hvis producenten har autoriseret omløb af produktet i et eller flere andre lande end Italien.

PORUGUÊS

NiTIDES

Um sistema de stent periférico com eluição de Amphilius™ (Sirolimus+ácidos gordos) auto-expansível com revestimento em «Carbofilm™»

1. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

A família de dispositivos NiTiDES é constituída por um stent autoexpansível e por um sistema adaptado ao correto posicionamento e aplicação do mesmo. O stent é um dispositivo implantável, flexível e auto-expansível. É fabricado em liga de níquel e titânio (Nitinol) revestida com «Carbofilm™», uma fina camada de carbono com uma estrutura turbostrática de alta densidade substancialmente idêntica à do carbono pirolítico.

O revestimento do substrato confere-lhe as características biocompatíveis e hemocompatíveis do carbono pirolítico, sem afetar as propriedades estruturais e físicas do substrato.

O stent inclui seis marcadores radiopacos de tântalo (três em cada extremidade) para permitir o correcto posicionamento no local da lesão alvo.

A superfície externa do stent inclui entalhes dedicados, totalmente revestidos com «Carbofilm™», os quais contêm a fórmula farmacêutica Amphilius, composta pelo fármaco Sirolimus e por uma mistura de ácidos gordos de cadeia longa.

A dose específica de fármaco para a superfície do vaso tratado é de aproximadamente 0,9 µg/mm², que corresponde a uma dose mínima de 270 µg no stent mais pequeno (6,0x20 mm) e a uma dose máxima de 2420 µg no stent maior (8,0x150 mm).

O sistema de aplicação utilizado é do tipo "over-the-wire" e permite posicionar e aplicar o stent em segurança no local da lesão a tratar. Está esquematizado na Figura 1 e é constituído por:

- um corpo do cateter (7) com 6F de diâmetro composto por:
 - uma bainha externa retrátil cuja secção distal, semi-transparente (3) inclui o stent (4); a bainha possui um colar radiopaco (13) situado junto à ponta do cateter;
 - um lumen interno constituído por uma espiral (6) e por um tubo interno (2) compatível com um fio-guia com 0,035 polegadas; o lumen interno inicia-se proximalmente no conector iuer (12) preso ao manipulo e termina distalmente na ponta (1) em material radiopaco, para facilitar a localização e o posicionamento do stent quando visualizado num sistema de angiologia.
- Um batente (5) incorporado no lumen interno impede o movimento axial do stent durante a retração da bainha externa;
- um manipulo (8) com sistema de aplicação o qual permite posicionar o cateter e implantar o stent in situ.

O manipulo possui um design ergonómico que permite ao operador segurar e utilizar o mesmo com uma única mão. Inclui uma porta iuer (12) na extremidade proximal, a qual é utilizada para lavar o lumen do fio-guia, uma chave de segurança (10), uma roda (9) e um cabo de retração (11).

O Fabricante produz diretamente o sistema de stent periférico + cateter de aplicação e realiza todos os procedimentos de controlo de qualidade, tanto durante o fabrico como nos produtos finais, em conformidade com as normas das Boas Práticas de Fabrico.

2. UTILIZAÇÃO PREVISTA DO DISPOSITIVO

O sistema de stent periférico autoexpansível destina-se ao tratamento de patologias da Artéria Periférica que afeta a artéria femoral superficial e a artéria poplítea proximal.

3. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO

O dispositivo é indicado para o tratamento da estenose das artérias femoropopliteas acima do joelho em pacientes adultos sintomáticos [categoria Rutherford 2-5]. A lesão tratada, de comprimento máximo de 14 centímetros, deve ser ocluída ou com estenose superior a 50%, de novo ou reestenótica, não tratada previamente com stent.

4. CONTRAINDICAÇÕES

A utilização do stent é contraindicada nas seguintes situações:

- Lesões consideradas como não tratáveis com ATP ou com outras técnicas operatórias.
- Mulheres grávidas, a amamentar.
- Lesões localizadas nos dois terços distais da artéria poplítea (ou ao nível da articulação do joelho).
- Condições clínicas que impedem a utilização de tratamento antiplaquetário e/ou anticoagulante.

5. ADVERTÊNCIAS

- A utilização do dispositivo não é recomendada em pacientes com hipersensibilidade conhecida ou alergias ao Sirolimus, aos ácidos gordos (tais como o ácido esteárico, o ácido palmítico ou o ácido behénico) ou aos componentes metálicos do stent (tais como Níquel, Titânio e Tântalo).
- O dispositivo destina-se apenas a uma única utilização. Não voltar a utilizar, a processar ou a esterilizar. Tal pode originar riscos de contaminação do dispositivo e/ou infecções para o paciente, inflamação e transmissão de doenças infecciosas de paciente para paciente.
- O dispositivo foi concebido para funcionar como sistema. Não utilize os componentes separadamente.
- Não utilize o dispositivo se a respetiva embalagem estiver aberta ou danificada, se tiver sido incorretamente armazenado ou se o prazo de validade tiver expirado. Nesses casos, a esterilidade do produto não está garantida.
- O dispositivo só deve ser utilizado por médicos com formação específica para realizar angioplastia transluminal percutânea (ATP) e implantação de stent periférico.
- Caso encontre resistência em qualquer altura durante o procedimento, não

force o sistema: retire o sistema do stent e todo o cateter de fornecimento, o fio-guia e o introdutor como uma única unidade. A aplicação de força excessiva e/ou o manuseamento incorrecto poderá resultar na aplicação accidental do stent ou em danos no cateter de fornecimento.

- A qualquer momento durante a operação, o manuseamento incorrecto pode provocar dissecção, perfuração ou rutura do recipiente.
- Não avançar ou retirar o sistema do stent durante a implantação: pode causar danos graves nas paredes dos vasos.
- A implantação de um stent periférico auto-expansível pode causar a dissecção do vaso distal e/ou proximal ao stent e pode igualmente causar a oclusão aguda do vaso, tornando necessária uma cirurgia adicional (operação de substituição vascular, cirurgia, dilatação adicional, aplicação de stents adicionais ou outros procedimentos).
- Assim que tiver parcialmente implantado o stent, não será possível recuperá-lo com o sistema de aplicação.

6. PRECAUÇÕES

- Nunca utilize o sistema de libertação rápida no início da expansão do stent. Utilize-o apenas se necessário depois de libertar, pelo menos, metade do comprimento do stent.
- O dispositivo deve ser manuseado cuidadosamente para evitar o contacto com instrumentos metálicos ou abrasivos que possam danificá-los ou produzir alterações mecânicas.
- O dispositivo não deve entrar em contacto com líquidos antes da respetiva preparação e posicionamento.
- O sistema de posicionamento do dispositivo não se destina a ser utilizado com injetores de meio de contraste.
- Se necessitar de implantar os stents em sequência, sobreponha os respetivos marcadores radiopacos. A sobreposição não deve envolver mais do que dois stents.
- No caso de stents sobrepostos, recomenda-se uma sobreposição inferior a 20 mm.
- Para evitar danificar o stent, tenha muito cuidado sempre que fizer passar o fio-guia ou o cateter balão ou outro dispositivo através do stent que tenha sido implantado.

7. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA SOBRE RM

Testes não clínicos demonstraram que as linhas de produtos com stent de Nitinol do fabricante são dispositivos de RM condicionada. Um paciente com estes dispositivos pode ser examinado em segurança num sistema de RM nas seguintes condições:

- Campo magnético estático de 1,5-Tesla (1,5T) ou 3-Tesla (3T)
- Gradiente espacial máximo de 6140 G/cm (61,40 T/m)
- Sistema de RM máxima reportada, taxa de absorção específica (SAR) média do corpo inteiro de:
 - 1 W/kg (Modo de operação normal) a 1,5 T
 - 1 W/kg (Modo de operação normal) a 3 T

Aquecimento por RF

Sob as condições de exame definidas acima, as linhas de produtos do stent Nitinol do fabricante devem produzir um aumento máximo de temperatura inferior a 6,8 °C após 15 minutos de exame contínuo num sistema de RM reportado, a taxa de absorção específica (SAR) média do corpo inteiro foi de 1,0 W/kg.

1,5 T	3 T
-------	-----

Configuração de Stent Único	Máxima alteração de temperatura	≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
-----------------------------	---------------------------------	----------	----------

Configuração de Stent em Sobreposição	Máxima alteração de temperatura	≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C
---------------------------------------	---------------------------------	----------	----------

Artefactos em RM

Em testes não clínicos, a artefacto de imagem provocado pelo dispositivo prolonga-se aproximadamente a 0,7 cm com stents de Nitinol do fabricante, quando visualizado com sequências gradiente-eco e uma sequência spin eco num sistema de RM de 3 T.

8. EMBALAGEM

O dispositivo NiTiDES é fornecido estéril (utilizando uma mistura de óxido de etileno e CO₂), para uma única utilização e acondicionado individualmente em duas bolsa que não devem ser transportadas para o campo estéril. **NOTA: a bolsa interna é a única barreira estéril.**

A esterilidade e a estabilidade química estão garantidas, enquanto a embalagem permanecer intacta e até ao prazo de validade impresso na embalagem (VALIDADE).

Conteúdo: um (1) sistema de stent periférico com eluição de Amphilius™ (Sirolimus+ácidos gordos) auto-expansível com revestimento em «Carbofilm™»

9. CONSERVAÇÃO

O produto deve ser armazenado como indicado na embalagem, em local fresco e seco, com temperatura máxima de armazenamento 25 °C.

10. MODELOS

Cada dispositivo NiTiDES está identificado por um código de modelo e por um número de lote; os códigos de produto disponíveis estão indicados na Tabela 1.

11. REGIME FARMACOLÓGICO

Estudos presentes na literatura clínica indicam a necessidade de administrar tratamento antiplaquetário pré-operatório, tratamento anticoagulante durante o procedimento e tratamento antiplaquetário pós-operatório.

O tratamento antiplaquetário, durante o período posterior ao procedimento, envolve a administração de:

- Ticlopíridinas (Ticlopidina, Clopidogrel ou Prasugrel nas doses indicadas nas respetivas bulas ou de acordo com a prescrição médica)
- Aspirina numa quantidade mínima de 100 mg/dia indefinidamente

Dada a complexidade do procedimento e os muitos fatores que influenciam a condição do paciente, a definição do tratamento apropriado é deixada ao critério do médico.

12. INTERAÇÕES COM FÁRMACOS

Apesar de não estarem disponíveis dados clínicos específicos, determinados fármacos, tais como o Tacrolimus, que atuam por intermédio da mesma proteína de ligação (FKBP), podem interferir com a eficácia do Sirolimus. O Sirolimus é metabolizado pelo CYP3A4. Os inibidores fortes do CYP3A4 podem provocar uma maior exposição ao Sirolimus, especialmente no caso de múltiplo implante. Deve-se ter igualmente em consideração a exposição sistémica ao Sirolimus, caso o paciente esteja a tomar de forma concomitante fármacos imunossupressores por via sistêmica.

13. ESTUDO CLÍNICO COM NITIDES

A principal segurança e eficácia do stent NiTiDES foi estabelecida a partir do estudo clínico pré-mercado da ILLUMINA.

Desenho do estudo: Num estudo multicéntrico de braço único, 100 pacientes com doença femoropoplitea sintomática com um comprimento máximo de lesão de 14 cm foram tratados com o stent NiTiDES. A eficácia primária (patência primária) e o parâmetro de segurança primária (um composto de eventos adversos principais: morte, amputação do membro alvo, isquemia do membro alvo que requer intervenção cirúrgica ou reparo cirúrgico do vaso alvo ou revascularização da lesão do alvo clinicamente dirigida, piora da pontuação de Rutherford em 2 classes, ou para as classes 5 ou 6) foram comparados a um Objetivo de Desempenho (OPG) aos 12 meses.

Resultados: O sucesso do procedimento foi de 100%.

Os resultados da ultrassonografia Doppler mostram patência primária de 87% (77/89, intervalo de confiança de 95% 80-94), atendendo aos requisitos da PGR (73%). A patência primária de 24 meses foi de 81% (63/78).

O parâmetro de segurança primária de 12 meses foi de 96,8% (90/93), atendendo aos requisitos do OPG (19,6%). 2,2% (2/93) dos pacientes tiveram a revascularização da lesão do alvo clinicamente dirigida, 1,1% (1/93) morreu, 0 teve amputação do membro alvo, 0 teve isquemia do membro alvo que exigiu intervenção cirúrgica ou reparo cirúrgico do vaso alvo e 0 teve piora da pontuação de Rutherford por duas classes, ou classes 5 e 6.

O parâmetro de segurança aos 24 meses foi de 87,8% (79/90). 6,7% (6/90) dos pacientes tiveram a revascularização da lesão do alvo clinicamente dirigida, 3,3% (3/90) morreu, 0 teve amputação do membro alvo, 1,1 teve isquemia do membro alvo que exigiu intervenção cirúrgica ou reparo cirúrgico do vaso alvo e 1,1% (1/90) teve piora da pontuação de Rutherford por duas classes, ou classes 5 e 6.

14. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Seleção do dispositivo

Consulte o comprimento da lesão alvo para estabelecer o comprimento do stent a selecionar. A fim de cobrir adequadamente a lesão, o comprimento do stent implantado deve ser pelo menos 5 mm maior do que a própria lesão, de cada lado. Consulte o diâmetro do vaso, proximal e distal à lesão, para definir o tamanho adequado de stent. Para garantir uma colocação segura do stent, utilize o diâmetro maior como base para escolher o tamanho apropriado do stent. Ao selecionar o modelo, consulte as informações fornecidas na Tabela 1.

Preparação do dispositivo

Antes de aplicar o stent, administre heparina e verifique se o Tempo de Coagulação Ativa (TCA) do paciente é adequado, em conformidade com as práticas da instituição.

Durante a preparação do sistema, tome especial atenção para evitar que o stent entre em contacto com líquidos.

- Abra a caixa e retire a bolsa que contém o stent.
- Depois de examinar a embalagem para detetar quaisquer danos, abra a bolsa externa de alumínio não estéril e retire o conteúdo da bolsa interna. (Note: A bolsa de alumínio e a superfície exterior da bolsa de plástico interior **NÃO SÃO ESTÉRIL**. Apenas o conteúdo da bolsa plástica é ESTÉRIL).
- Depois de colocar o suporte cuidadosamente sobre uma superfície plana num campo estéril, desaperte a banda situada em redor do manipulo e retire o cateter da espiral de proteção.
- Verifique se o cateter de aplicação não apresenta irregularidades, dobras ou outros danos. A presença de danos no dispositivo pode prejudicar o respetivo desempenho.
- Encha uma seringa de 3 mL com soro fisiológico heparinizado, ligue a seringa ao conector luer para efectuar uma lavagem (figura 1, item 12) e aplique pressão positiva. Prossiga com a lavagem até o soro fisiológico emergir na extremidade distal do cateter.
- Inspeccione a extremidade distal do cateter e certifique-se de que o stent (figura 1, ponto 4) está totalmente coberto pela bainha externa.

Se o dispositivo estiver parcialmente expandido ou danificado de qualquer forma, não o utilize.

Compatibilidade com acessórios

Bainhas de introdutor de diâmetro 6F (2,0 mm) ou maior podem ser utilizadas com os dispositivos NiTiDES.

Fios guia de 0,89 mm (0,035 polegadas) ou inferiores podem ser utilizados com os dispositivos NiTiDES. A escolha de rigidez de fios-guia e de configuração da ponta irá depender da experiência clínica do médico.

Se for necessário utilizar um cateter-guia, os sistemas são compatíveis com cateteres-guia com um diâmetro de 8 F (2,7 mm) ou superior. Nesse caso, certifique-se de que a válvula hemostática está totalmente aberta antes de inserir o conjunto selecionado.

Inserção do stent

- Certifique-se de que a chave de segurança (figura 1, item 10) do manipulo está na posição de bloqueio (pormenor B).
- Lave a parte exposta do fio-guia com uma solução fisiológica contendo

heparina para remover vestígios de sangue e de meio de contraste.

c) Avance o sistema sobre o fio-guia até o stent alcançar o local a tratar. Se, em qualquer fase do procedimento, notar uma resistência pouco comum, não force o sistema, retire o introdutor, o fio-guia e o dispositivo juntos como uma unidade única. A aplicação de força excessiva e/ou o manuseamento incorreto poderá resultar na aplicação accidental do stent ou em danos no cateter de posicionamento.

Avanço do dispositivo

- Avance o sistema até o stent ficar posicionado além da lesão a tratar.
- Recue o sistema até o stent ficar alinhado com a lesão.

c) Verifique se a porção do sistema de aplicação situada fora do corpo do paciente está totalmente estendida e reta.

Cuidado: se o sistema de aplicação não estiver totalmente estendido, o stent poderá ser aplicado para além da lesão alvo.

Implantação e expansão do stent

- Segure no manipulo firmemente com uma mão e verifique se os marcadores radiopacos do stent estão numa posição proximal e distal em relação à lesão.
- Certifique-se de que a bainha do introdutor não se movimenta durante a aplicação do stent.
- Rode a chave de segurança do manipulo no sentido anti-horário (figura 1, detalhe B) para o desbloquear (PASSO 1), depois puxe-o completamente para fora (PASSO 2).
- Mantendo o manipulo numa posição fixa relativamente ao paciente, verifique novamente se os marcadores radiopacos estão na posição pretendida relativamente à lesão; inicie a aplicação do stent rodando a roda (figura 1, ponto 9) com o polegar na direção da seta, tal como mostrado na figura 1.
- Sob monitorização fluoroscópica, quando a extremidade distal do stent estiver bem presa às paredes do vaso, prossiga com a aplicação rodando a roda até a extremidade do stent abrir e ficar totalmente implantada nas paredes do vaso.
- Se for necessário efetuar uma implantação rápida, proceda da seguinte forma: certifique-se de que na extremidade traseira do manipulo não há obstáculos (por exemplo, o conector luer fêmea aparafusado), segure na extremidade traseira do dispositivo (puxar para trás, figura 1, item 11) com a outra mão e puxe-o, mantendo totalmente imóvel a secção frontal do manipulo relativamente ao paciente, tal como mostrado na figura 1.
- Sob monitorização fluoroscópica, verifique se o stent está completamente expandido.
- Se necessário, poderá expandir ainda mais o stent por intermédio de um cateter de balão para ATP. Para selecionar o diâmetro do cateter de balão, e para efetuar a pós-expansão, tenha como referência o diâmetro do vaso, calculado por meio de angiografia. Em qualquer caso, seja particularmente cauteloso para não expandir o stent além do seu diâmetro nominal, indicado na etiqueta.
- O diâmetro final do stent deve ser adequado ao diâmetro do vaso de referência.

15. POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS

Os efeitos adversos possíveis que podem estar associados à implantação de um stent periférico incluem riscos relacionados com a angioplastia transluminal percutânea e riscos adicionais associados ao uso de stents, tal como indicado abaixo.

- Infecção, dor e hematoma do local de acesso
- Reação alérgica ou adversa ao meio de contraste, aos fármacos utilizados durante o procedimento ou aos materiais do stent
- Espasmo arterial
- Trombose arterial ou do stent
- Aneurisma ou pseudoaneurisma da arterial femoral
- Embolia aterosclerótica distal
- Sangramento
- Morte
- Dissecção, perfuração ou rutura da artéria tratada
- Embolia
- Insuficiência Rim
- Isquemia dos membros inferiores (com necessidade de intervenção cirúrgica)
- Restenoze da artéria na qual foi implantado o stent
- Embolia do stent
- Oclusão ou estenose não resolvida do vaso

16. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

O Fabricante garante que o dispositivo foi concebido, fabricado e embalado com todos os cuidados, utilizando as técnicas consideradas mais adequadas entre as disponíveis no estado atual da tecnologia e aplicando princípios de integração da segurança na conceção e construção para garantir uma utilização segura quando é utilizado nas condições e para os fins previstos, respeitando as precauções indicadas nos parágrafos anteriores e, em qualquer caso, visando reduzir ao máximo, mas não eliminando totalmente, os riscos relacionados com a utilização do dispositivo.

O dispositivo deve ser utilizado exclusivamente sob a responsabilidade de pessoal médico especializado e tendo em conta os riscos residuais e possíveis efeitos secundários e complicações da terapia a que se destina, incluindo os mencionados nas outras secções deste folheto de instruções.

A complexidade técnica e a natureza crítica das escolhas médicas e dos métodos de aplicação do dispositivo excluem qualquer garantia do Fabricante, explícita ou implícita, sobre a eficácia do resultado após à utilização do dispositivo, ou relativamente à sua eficácia na resolução de um estado de incapacidade, ou de qualquer outra patologia ou problema médico. De facto, os resultados, tanto do ponto de vista clínico como em termos de funcionalidade e duração do dispositivo, também dependem de inúmeros fatores que estão além do controlo do fabricante, entre os quais se citam apenas como exemplos e não como condições exaustivas do paciente, o procedimento cirúrgico de implantação ou utilização, os métodos de manuseamento do dispositivo após a abertura da embalagem.

Tendo em conta estes fatores, a responsabilidade do fabricante só existe se tiver sido verificado que o dispositivo foi afetado por defeitos no momento em que foi colocado em circulação. Para este efeito, o Cliente deve colocar imediatamente o aparelho à disposição do Fabricante, em conformidade com os termos de validade e prescrição exigidos por lei; o Fabricante reserva-se o direito de examinar o aparelho considerado defeituoso e de determinar se foi realmente afetado por defeitos que possam afetar a segurança do produto. A responsabilidade do fabricante é excluída se (i) o defeito reclamado for devido à conformidade do dispositivo com uma regra obrigatória ou uma disposição vinculativa, e/ou (ii) o defeito que causou o dano não existia quando o Fabricante lançou o dispositivo e/ou (iii) se o estado do conhecimento técnico e científico no momento em que o Fabricante lançou o dispositivo, ainda não permitia que o dispositivo fosse considerado defeituoso, e/ou (iv) em qualquer outro caso, também diferente dos indicados acima, em que a lei expressamente exclui, ou limita, a responsabilidade do Fabricante por danos de produtos defeituosos. A garantia consiste exclusivamente na substituição do dispositivo defeituoso por outro do mesmo tipo ou equivalente produzido pelo fabricante. A garantia aplica-se apenas se o dispositivo for corretamente devolvido ao fabricante juntamente com um relatório escrito e detalhado sobre os defeitos reclamados e, no caso de um dispositivo implantado, sobre os motivos da remoção do paciente. Os defeitos reclamados devem ser prontamente comunicados ao Fabricante em conformidade com os termos de caducidade e prescrição legal. Uma vez realizada a substituição, o Fabricante reembolsará o Cliente pelas despesas nas quais incorreu com a devolução do aparelho que foi reconhecido como defeituoso.

O Fabricante declina qualquer responsabilidade em caso de não observância dos métodos de utilização e das precauções indicadas neste manual de instruções e no caso de utilização após a data de validade indicada na embalagem. Além disso, o Fabricante declina qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes das escolhas médicas e dos métodos de utilização ou de aplicação do dispositivo e não poderá, portanto, ser responsabilizado por danos de qualquer tipo, material, biológico ou moral, subsequente à aplicação do dispositivo, ou pela escolha da técnica de implantação utilizada pelo operador. Os agentes e representantes do Fabricante não estão autorizados a modificar nenhuma das condições acima mencionadas, nem a assumir qualquer obrigação adicional ou a oferecer qualquer garantia relativa a este produto, além das acima indicadas. A presente garantia é regida pela lei italiana, a menos que a legislação obrigatória de outro estado seja aplicada, caso o Fabricante tenha autorizado a circulação do produto num ou mais estados que não o italiano.

SUOMI

NITIDES

„Carbofilm™-päälystetty itsestään laajeneva Amphilius™ (Sirolimus+rasvahappo) eluoituva perifeerinen stenttiijärjestelmä

1. LAITTEEN KUVAUS

NiTIDES-laitteperhe koostuu itsestään laajenevasta stentistä ja stentin oikeasta asettamista ja täyttämisestä vastaanvasta asennuslaitteesta.

Stentti on joustava, itsestään laajeneva implantoitava laite. Stentti on valmistettu nikkel-titaaniseoksesta (nitinol) ja päälystetty ohuella „Carbofilm™-hiilikerroksella, jonka erittäin theää turbostaattinen rakennus vastaa pyrolyyttista hiiltä.

Substraatin päälystämisen tekee siitä bioyhteensopivan ja hemologiselta yhteensovittaudella pyrolyyttistä hiiltä vastaavaa, mutta se ei vaikuta substraatin fyysisiin ominaisuuksiin tai rakenteeseen.

Stentissä on kuusi röntgenpositiivista merkkiä (kolme kummassakin päässä), joilla varmistetaan oikea asettaminen vauriokohtaan.

Stentti ulkopinnassa on tähysin „Carbofilm™-hiilikerroksella pinnoitetut uureet, jotka sisältävät sirolimusoista ja pitkin rasvahappoketjujen yhdistelmästä valmistettua Amphiliust™-lääkeainetta.

Hoidettavan verisuonien pinnan määritetty lääkeannos on noin 0,9 µg/mm², joka vastaa pienemmän stentin (6,0x20 mm) minimiannosta 270 µg ja suuremman stentin (8,0x150 mm) maksimiannosta 2420 µg.

Käytettävä **asennuslaitte** on nopeakäyttöinen, ja sillä varmistetaan, että stentti voidaan asettaa ja irrottaa turvallisesti vauriokohdassa. Stentti on esitetty kaaviona kuvassa 1 ja siihen kuuluu:

- katetrin runko (7) halkaisija 6F, jonka osia ovat:
 - sisäänvedettävä ulkokohkki, distaalinen, osittain läpikuultava osa (3), johon kuulut stenti (4). Holkissa on röntgenpositiivinen kaulus (13) lähellä katetrin kärkeä
 - sisempi luumen, johon sisältyy lankia (6) ja sisempi letku (2), joka sopii 0,035 tuuman (0,089 cm) ohjauslangalle. Sisempi luumen alkaa katetrissa luer-liitännästä (12), joka on kiinnitetty hyvin proksimaalisesti kauhaan, ja päättyy distaaliseksi kärkeen (1) röntgenpositiiviseen materiaaliin, joka auttaa stentin sijoittamisessa ja asettamisessa läpivalaisulaitteella suoritettavassa. Sisemmän luumisen kiinteä pysisytin (5) estää stentin aksiaalisen siirtymisen ulomman holkin ulosvetämisen aikana.
- kahva (8) ja asennuslaitte, jonka avulla katetrin asettaminen ja stentin täyttäminen painotillaan on mahdollista.

Kahva on ergonomisesti muotoiltu, joten käyttäjä voi tarttua siihen ja käyttää sitä jopa yhdellä kädellä. Sen proksimaalisessa päässä on luer-portti (12), jota käytetään ohjauslangan luumisen huuheluun, turva-avain (10), pyörä (9) ja takaisinvetoisima (11).

Valmistaa valmistaa perifeerisen stentin ja täytökatetrin ja tekee laadunvalvontatoimia sekä valmistusprosessin aikana että valmiille tuotteelle hyväksytyjen valmistuskäytäntöjen mukaisesti.

2. LAITTEEN KÄYTTÖTARKOITUS

Itsestään laajeneva perifeerinen stenttiijärjestelmä on tarkoitettu perifeerisen valtimoidun hoitoon, joka vaikuttaa pinnalliseen reisvaltimoon ja proksimaliseen popitealaiseen vältimoon.

3. LAITTEEN INDIKOITU KÄYTÖ

Laite on indikoitu polven yläpuolisten reisiluun valtimoiden ahtauman hoitoon aikuisilla oireenmukaissilla [Rutherford-loukka 2–5] potilailla. Hoidetun vaurion, jonka pituus on enintään 14 senttimetriä, on oltaa joko okkluutioinut tai siinä on yli 50 %:n stenoosi, joko uusi tai restenoottinen, eikä sitä ole aiemmin hoidettu stentillä.

4. KÄYTÖN VASTA-AIHEET

Stentin käyttö on vasta-aiheista seuraavissa tapauksissa:

- Vauriokohdat, joita ei voida hoitaa pallolaajennuksen tai muiden toimenpiteiden avulla.
- Raskaana olevat ja imettävät naiset.
- Popliteaalisen vältimon kahteen distaaliseen kolmannekkseen tai polviniveleen lokaloituneet vauriokohdat.
- Kliiniset tilanteet, jotka estävät verihuutaleisiin vaikuttavan hoidon ja antikoagulantihoidon käytämisen.

5. VAROITUKSET

- Laitteen käytämistä ei suositella potilaille, joiden tiedetään olevan yliherkiä sirolimuusille, rasvahappolle (esimerkiksi steariinihappolle, palmitiinihappolle, behenihappolle) tai stentin metalliosille (kuten nikkelille, titaniumille ja tantalumille).
- Laite on kertakäytöinen. Älä käytä, käsitlete tai steriloit laitteita uudelleen. Se saattaa aiheuttaa laitteen kontaminaatioiskin ja/tai potilaan infektoriiskin tai inflammaation sekä potilaiden väisen tartunnan.
- Laite on suunniteltu kiinteäksi järjestelmäksi. Älä käytä sen osia erillisinä.
- Älä käytä laitetta, jos pakkaus on avattu tai vahingoittunut tai sitä on säilytetty väärin. Laitetta ei saa käyttää viimeisen käytöpäivän jälkeen. Náissä tapauksissa tuotteen steriliilitä ei voida taata.
- Laitteen saatava implantoitaa ainoastaan lääkäri, joilla on koulutus verisuunipalloalaajennusten (PTA) tekemiseen ja perifeerisen stentin asentamiseen.
- Jos toimenpiteen jossakin vaiheessa tuntuu vastusta, älä aseta järjestelmää väkisin. Veda stenttiijärjestelmä ja koko asennuskatetri, ohjauslanka ja sisäänvientiholkki ulos yhtenä yksikkönä. Liiallinen voimankäytö ja/tai virheellinen käsittely voivat aiheuttaa stentin täytymisen vahingossa tai asennuskatetrin vaurioitumisen.
- Virheellinen käsittely toimenpiteen missä vaiheessa tahansa voi aiheuttaa verisuonien dissekaation, perforaation tai ruptuuran.

- Älä vie stenttijärjestelmää eteenpäin tai veda sitä ulos täytymisen aikana: verisuonen seinämät voivat vahingoittua vakavasti.
- Itsestään laajenevan perifeerien stentin implantoiminen saattaa aiheuttaa verisuonen dissekaation implanttaatiokohdalla distaaliseesti ja/tai proksimaalisesti stenttiin nähten. Implantointiin saattaa aiheuttaa myös verisuonen äkillisen okkluusioon, jolloin tarvitaan lisätöimenpiteitä (kuten verisuonten kirurgista korjausta, lisälääjennusta, lisästenttiin käyttöä tai muita toimenpiteitä).
- Kun stentti on osittain täytetty, sitä ei voida palauttaa asennusjärjestelmän avulla.

6. VAROTOIMET

- Älä koskaan käytä pikavapautusjärjestelmää stentin laajennuksen alussa. Käytä sitä vain tarvittaessa vapautettuasi vähintään puolet stentin koko pituudesta.
- Laitetta tulee käsittää varoen ja välttää laitteen joutumista kosketukseen metallisten tai naarmuttavien instrumenttien kanssa, jotka voivat vahingoittaa sitä tai muuttaa laitetta mekaanisesti.
- Laite ei saa joutua kosketukseen nesteiden kanssa ennen valmistelua ja asettamista.
- Laitteen asetusjärjestelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi varjoaineinjektorin kanssa.
- Sillöin kun stentit asennetaan pareittain, vastaanvien röntgenpositiivisten merkkien tuele mennen päälekkiäin. Päälekkiäisyysteen ei saa osallistua kuin enintään kaksi stenttiä.
- Jos stentit menevät päälekkiäin, päälekkiäin menevän pituuden tulee olla alle 20 mm.
- Jotta stentti ei voiottuisi, vie ohjainlanka tai pallokateetri tai muu laite täytetyn stentin läpi erittäin varovasti.

7. MAGNEETIKUVAUSJÄRJESTELMÄ KOSKEVIA TIETOJA

Ei-kliinissä testeissä on osoitettu, että valmיסטajan nitinolstenttiin tuotelinja on MR-ehdolinen. Tätä laitetta käytettävä potilaasta voidaan turvallisesti kuvataan magneettikuvausjärjestelmässä, joka täytyy seuraavat ehdot:

- Staattinen magneettikenttä 1,5 Teslaa (1,5T) tai 3 Teslaa (3T).
- Kentän gradientin enimmäisarvo on 6,140 G/cm (61,40 T/m).
- Magneettikuvausjärjestelmän ilmoittama koko kehon keskimääräinen ominaisabsorptionopeus (SAR) enintään:

 - 1 W/kg (normaali käytötila) 1,5T:ssa
 - 1 W/kg (normaali käytötila) 3T:ssa

Magneettikuvausjärjestelmän lämpeneminen

Edellä määritellyissä kuvannusolosuhteissa valmistrojan Nitinol-stenttiuteliinojen odotetaan aiheuttavan enintään 6,8 °C lämpötilan nousun 15 minuutin jatkuvan kuvannuksen jälkeen raportoidulla magneettikuvausjärjestelmällä, koko kehon keskimääräinen ominaisabsorptionopeus (SAR) 1,0 W/kg.

	1,5 T	3 T
Yhden stentin kokoonpano		
Suurin lämpötilamuutos	≤6,3 °C	≤6,2 °C
Päälekkiäisten stenttien kokoonpano		
Suurin lämpötilamuutos	≤6,8 °C	≤6,3 °C

Magneettikuvausarte fakti

Ei-kliinissä testeissä laitteen aiheuttama kuva-artefakti ulottuu noin 0,7 cm:n etäisyydelle valmistrojan Nitinol-stenteistä gradienttikaiku- ja spin-kauppusisiveissä 3T:n magneettikuvausjärjestelmää käytettäessä.

8. TOIMITUS

NITIDES-laitte toimitetaan steriliinä (eteenoksidi- ja CO₂-seos steriloointiaineena), kertakäytöisenä, ja pakattuna kahteen pussiin, joita ei saa asettaa steriiliille alueelle. **HUOMAUTUS: Sisäpussi on ainoaa steriliilodyn takaava este.**

Steriiliys ja kemiallinen stabilitaatiota taataan, kun pakaus on vahingoittumaton ja viimeiseen käytöspäivään (KÄYTETTÄVÄ ENNEN) saakka.

Sisätiltö: yksi (1) „Carbofilm™-päälystetty itsestään laajeneva Amphilimus™ (Sirolimus+rasvahappo) eluoituvia perifeerien stenttijärjestelmä

9. SÄILYTYS

Tuote voidaan säilyttää pakauksessa osoitetun mukaisesti viileässä ja kuivassa paikassa enintään 25 °C lämpötilassa.

10. MALLIT

NITIDES-laitteessa on tunnistee mallikoodi ja eränumero; saatavana ovat tuttekoodit on lueteltu taulukossa 1.

11. LÄÄKITYS

Kliininen kirjallisuuden mukaan antikoagulantihoidto on tarpeen toimenpiteen aikana ja verihiatalteisiin vaikuttava hoito ennen toimenpidettä ja sen jälkeen.

Verihiatalteisiin vaikuttavassa hoidossa annetaan toimenpiteen jälkeen:

- Tienopyridiini (tiklopidiini, kllopigreeliä tai prasugreeliä vastaavissa opasvihioissa osoitettuina annoksina tai lääkärin määräykseen mukaan).
- Aspiriini vähintään 100 mg/vuorokausi jatkuvasti.

Koska toimenpide on monimutkainen ja koska potilaan tilaan vaikuttavat monet tekijät, lääkärin tulee päättää soveltuvalta hoidosta tapauskohtaisesti.

12. YHTEISVAIKUTUKSET LÄÄKKEIDEN KANSSA

Vaikka keskipisäili kliinisiä tietoja ei ole saatavilla, tietty lääkeaineet, kuten saman sisodoproteiinin (FKBP) kautta vaikuttava takrolimus, voivat haitata sirolimuusin tehoa. Sirolimus metaboliusoitu CYP3A4-entsyymin vaikutuksesta. Voimakkaita CYP3A4-estäjät voivat aiheuttaa suuremman sirolimuusialistukseen erityisesti usean implantin yhteydessä. Jos potilas ottaa samanaikaisesti systeemisistä immunosuppressiivisia lääkkeitä, tulee altitusti sirolimuusille ottaa myös huomioon.

13. NITIDES-LAITTEELLA SUORITETUT KLIININSET KOKEET

NITIDES-stentin pääasiallinen turvallisus ja tehokkuus on todennettu ennen

markkinoilta tuontia suoritetulla ratkaisevalla kliinisellä ILLUMINA-kokeella.

Tutkimuksen suoritus: NitiDES-stentillä hoidettiin yhden kohaarann monikeskustutkimuksessa 100 potilaasta, joilla oli oireenmukainen femoropopliteal-tauti ja vaurion enimmäispituus 14 cm. Ensisijainen teho (ensisijainen avoimuus) ja ensisijainen turvallisudinen päätepiste (yhdistelmä merkittävä haittataapumia: kuolema, kohderajan amputointi, kohderajan iskemia, joka vaati kirurgisen toimenpiteen tai kohdesuonen kirurgisen korjauksen, tai klinisesti ohjattavan kohdevaruun revaskularisaation, Rutherford-pistemääran paheneminen 2 luokalla tai luokkaan 5 tai 6) verrattiin objektiiviseen suorituskykytavoiteeseen (OPG) 12 kuukauden kohdalla.

Tulokset: Proseduraalinen onnistuminen saavutettiin 100 %:lla.

Doppler-ultraäänimittauksen ensisijainen avoimuus on 87 % (77/89, 95 % luottamusväli 80–94), mikä vastaa OPG:n vaatimuksia (73 %). 24 kuukauden ensisijainen avoimuus on 81 % (63/78).

12 kuukauden ensisijainen turvallisudinen päätepiste oli 96,8 % (90/93), mikä täytyy olla OPG:n vaatimuksien (19,6 %). Potilaista 2,2 %:lla (2/93) oli klinisesti ohjattu kohdevaruun revaskularisaatio, 1,1 % (1/93) kuoli. 0:lla oli kohderajan amputatio. 0:lla oli kohderajan iskemia, joka vaati kirurgista toimenpidettä tai kohdesuonen kirurgista korjausta, ja 0:lla Rutherford-pisteiden lasku kahdella luokalla tai luokkiin 5 ja 6.

24 kuukauden turvallisudisen päätepiste oli 87,8 % (79/90). Potilaista 6,7 %:lla (6/90) oli klinisesti ohjattu kohdevaruun revaskularisaatio, 3,3 % (3/90) kuoli, 0:lla oli kohderajan amputatio, 1,1 %:lla (1/90) oli kohderajan iskemia, joka vaati kirurgista toimenpidettä tai kohdesuonen kirurgista korjausta, ja 1,1 %:lla (1/90) Rutherford-pisteiden lasku kahdella luokalla tai luokkiin 5 ja 6.

14. KÄYTÖÖHOJEET

Laitteen valitseminen

Määritä tarvittava stentin pituus määrittämällä vauriokohdan pituus. Vauriokohdan kattamiseksi asiaankuiseesta täytyn stentin tulisi olla vähintään 5 mm vauriota pidempi kuinmallakin puolella.

Määritä verisuonen halkaisija proksimaalisesta ja distaalisesta vauriokohdassa oikean stenttikon määrittämiseksi. Stentin pitävän asettamisen takaamiseksi valitse stentin koko käytävällä lähtökohtana suurempaa halkaisijaa. Katso mallia valittaessa taulukon 1 tiedot.

Laitteen valmisteleminen

Anna valitsemaan hepariinia ennen stentin asentamista ja tarkista, että potilaan aktivoitu hyttymisalka (ACT-alka) vastaa hoitoaikaa käytäntöä.

Varmista järjestelmän valmistelun aikana, ettei stentti joudu kosketuksiin nesteestä kassaan.

- Aava kotelot ja toa esin steriliin pussin sisältävä pussi.
- Tutki pussi vaurioiden varalta. Aava sitten ulkoinen ei-sterili aliumiinipussi ja poista sisältö sisäpussista. (Huomautus: Alumiinipussi ja muovisen sisäpussin ulkopinta EIVÄT OLE STERIILIT. Ainoastaan muovipussin sisältö on STERILI).
- Varmista, että asetat tuen tasaiselle steriliilille alueelle, ja irrota sitten kahvan ympärillä oleva hihna ja irrota katetri suojuksesta.
- Tarkista, ettei asensuukatetri ole kiertynyt, taittunut tai muutoin viottunut. Laitteen viottuminen saattaa heikentää sen toimintaa.
- Täytä 3 ml ruisku hepariinia sisältävällä fysiologisella nesteellä, liitä luer-iliittäntäänhuhutela varten (kuva 1, kohta 12) ja käytä positiivista painetta. Jatka huuhittelua, kunnes fysiologista nestettä tulee ulos katetrin distaalisesta päästä.
- Tarkista katetrin distaalinen pää, ja varmista, että ulkokohkki peittää stentin (kuva 1, kohta 4) kokonaan.

Jos laite on jotenkin vahingoittunut tai jos stentti on osittain laajentunut, älä käytä.

Yhteensopivuus lisävarusteiden kanssa

NITIDES-laitteen kanssa voidaan käyttää sisäänvientiholkkeja, joiden halkaisija on vähintään 6F (2,0 mm).

NITIDES-laitteen kanssa voidaan käyttää 0,035 tuuman (0,89 mm) tai sitä ohuempiä ohjainlankoja. Ohjainlangan jäykkyys ja kärjen malli valitaan lääkärin kliinisen kokemuksen perusteella.

Jos ohjaukskatetrit käytetään tarpeellista, järjestelmät ovat yhteensovivia halkaisijaltaan vähintään 8F (2,7 mm) ohjaukskatetrien kanssa. Varmista tällaisessa tapauksessa, että hemostaattinen venttiili on täysin auki ennen valitun kohden sisäänvientiä.

Stentin asentaminen

- Varmista, että kahvan turva-avain (kuva 1, kohta 10) on lukittuna (yksityiskohta B).
- Huuhtele ohjainlangan näkyvissä oleva osa hepariinia sisältävällä fysiologisella liuoksella, jotta veri- ja varjoainejäämät poistuvat.

- Likkitä järjestelmällä hiiltaisti eteenpäin ohjainlangan päällä, kunnes stentti on hoidattavalla alueella.

Jos jossakin vaiheessa asennusta tuntuu epätavallista vastusta, älä pakota järjestelmää: vedä asennuslaite, ohjainlanka ja laite ulos yhtenä yksikkönä. Liiallinen voimankäytö ja/tai virheellinen käsittely voivat aiheuttaa stentin täytymisen vahingossa tai asennuskatetrin vaurioitumisen.

Laitteen eteenpäinventti

- Vie järjestelmällä eteenpäin kohtaan, jossa stentti on vauriokohdan takana.
- Vedä järjestelmää takaisinpäin, kunnes stentti on kohdistettu vauriokohaan.

- Tarkista, ettei kehoni ulkopuolinen osa sisäänvientijärjestelmää on vapaasti auki ja suora.

Huomio: jos asennuslaite ei ole kunnolla laajennettu, stentti saattaa laajentua vauriokohdan taakse.

Stentin asentaminen ja laajentaminen

- Tartu kahvan kunnolla yhdellä kädelällä, tarkista, että stentin röntgenpositiiviset merkit on sijoitettu proksimaalisesti ja distaalisesti suhteessa vauriokohaan.
- Varmista, ettei sisäänvientiholki siirry stentin täyttämisen aikana.

- c) Käännä kahvan turva-avainta (kuva 1, kohta B) vastapäivään ja avaa se (VAIHE 1), ja vedä se ulos kokonaan (VAIHE 2).
- d) Pidä kahvan kiinteässä asennossa suhteessa potilaaseen, ja tarkista vielä kerran, että röntgenpositiiviset merkit ovat halutussa asennossa suhteessa vaurioikohaan. Aloita stentin täyttämisen kääntämällä pyörää (kuva 1, kohta 9) peukalolla nuolen suuntaan kuten kuvassa 1.
- e) Kun stentin distaalilinen pää on kiinnitynyt hyvin suonen seinämiin, jatka täyttämistä pyörää kääntämällä fluoroskopian aikana, kunnes stentti pää on avoinna, ja se on kokonaan implantoitu verisuonen seinämiin.
- f) Jos täyttämisen on suoritettava nopeasti, toimi seuraavalla tavalla: varmista, ettei (esim. naaraspuolinen luer-liitin kiinni) kahvan takaosassa ole esteitä. Tärtä laiteen (kuva 1, kohta 11) takaosaan toisella kädellä ja vedä sitä pitäen kiinni kahvan etuosa täysin paikallaan suhteessa potilaaseen kuten kuvassa 1.
- g) Tarkista läpivalaisulla, että stentti on täysin laajennettu.
- h) Mahdollisessa jälkilajennuksessa voi tarvitaessa käyttää PTA-pallokatetria. Valittaessa pallokateerin halkaisijaa ja jälkilajennusta suoritetaessa ota huomioon angiografialla arvioitu verisuonen halkaisija. Varo kaikissa tapauksissa laajentamasta stenttiä etiketissä määritetyn laajennushalkaisijan yli.
- i) Stentin lopullisen halkaisijan tulee soveltaa verisuonen halkaisijalle.

15. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Mahdollisia haittavaikutuksia (akkosjärjestysessä), joita voi liittää perifeeristen stenttien implantointiseen, sisältävät verisuonipallolaajennuksiin liittyvät riskit ja muut stentien käytämiseen liittyvät riskit, kuten alla on kuvattu.

- Sisäänvientikohdan infektiot, kipu ja hematooma
- Allerginen reaktio varjoaineelle, toimenpiteessä käytetylle lääkkeille tai stentin valmistusmateriaaleille
- Arteriaspasmia
- Arteriaalinen tai stentin tromboosi
- Reisiluun valitimoaneurysma tai pseudoaneurysma
- Aterosklerottinen distaalinen embolisaatio
- Verenvuoto
- Kuolema
- Stentatin verisuonen dissekaatio, perforatio tai ruptuura
- Embolia
- Munuaisen toimintahäiriö
- Alaraajan iskemia (kirurgista toimenpidettä tarvitseva)
- Restenoosi valtimossa, johon stentti on implantoitu
- Stentin embolisaatio
- Verisuonien okklusio tai ratkaisematon stenoosi

16. VASTUU JA TAKUU

Valmistaja takailee, että laite on suunniteltu, valmistettu ja pakattu erittäin huolellisesti ja nykyisen käytettäväissä olevan teknologian salmin, tarkoitukseen sopivimpina pidetyin teknisin menetelmin. Suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu turvallisuuden integrointiperiaatetta, jolla pystytään takaamaan laitteen turvallinen käyttö, mikäli sitä käytetään ohjeita noudattaa ja käyttötarkoituksen mukaisesti noudattamalla edellä esitettyjä varotoimia. Tällä tavoin laitteen käytöön liittyviä riskejä voidaan vähentää mahdollisimman paljon, mutta niitä ei kuitenkaan voida poistaa kokonaan.

Laitetta on käytettävä yksinomaan erikoistuneen lääkintähenkilöstön vastuulla ja ottaa huomioon käytötarkoituksen mukaisen hoidon jäännösriskit ja mahdolliset haittavaikutukset ja komplikaatiot, mukaan lukien ne, jotka mainitaan tämän ohjeikirjan muissa osissa.

Lääketieteellisten valintojen teknisen monimutkaisuuden ja kriftisen luonteen sekä laitteen käytömenetelmien vuoksi valmistaja ei ole suoraan tai epäsuorasti vastuussa laitteen käytön lopputuloksesta tai laitteen tehokkuudesta sairauden hoidossa, tai muissa patologisissa tai lääkinnällisissä ongelmissa. Itse asiassa tulokset, sekä klinisestä näkökulmasta että laitteen toimivuudesta ja kestosta katsoen, riippuvat myös useista tekijöistä, jotka eivät ole valmistajan valvonnanala. Tällaisista mainitaan yksinomaan esimerkkeinä eivätkä kaikkia potilailstantilanteita kattavina, implantointiin tai käytön kirurginen toimenpide, laitteen käsittelymenetelmät pakkauksen vaaramisen jälkeen.

Näiden tekijöiden valossa valmistajan vastuu on voimassa vain, jos on varmistettu, että laitteen on varmistettu olevan viallinen silloin kun se on laitettu kiertoon. Tätä tarkoitusta varten asiakkaan on annettava laite viipyväältä valmistajan saataville ennen viimeistä käytönpäivää ja lain edellytämien määräysten mukaisesti. Valmistaja pidättää oikeuden tutkia viallisena pidetyn laitteen ja selvittää, vaikuttavatko siihin todella viat, jotka voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen. Valmistajan vastuu raukeaa, jos (i) väitetty vika johtuu siitä, että laite on pakollisen määräykseen tai sitovan ehdon mukainen, ja/tai (ii) vahingon aiheuttanutta viikaa ei ollut olemassa, kun valmistaja toi laitteen markkinoilta ja/tai (iii) jos tekninen ja tieteellinen tietytänsä valmistajan tuodessa laitteen markkinoilta ei katsolut laitetta viallisiksi ja/tai (iv) joka tapauksissa, myös muiden kuin edellä mainittujen kohdalla, joissa laki nimemonaisesti sulkee pois tai rajoittaa valmistajan vastuun viallisten tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Takuu kattaa ainoastaan viallisen laitteen vahitamisen sarmantyyppiseen tai vastaavaan kyseisen valmistajan valmistamaan laitteeseen.

Takuu on voimassa vain, jos laite palautetaan valmistajalle oikein väitettyjen vikojen kirjallisen ja tarkan kuvauksen kanssa, ja implantoidun laitteen tapauksessa systä potilaasta poistamiseen. Väitetty viat on ilmoitettava valmistajalle viipyväältä menetys- ja lakisäteisten ehtojen mukaisesti.

Kun laite on vaihdettu, valmistaja korvaa asiaankaalle tunnistetun viallisen laitteen palauttamisesta aiheutuneet kulut.

Valmistaja ei ole mitään vastuuta, jos tässä käytööhjeeessä mainittuja käytömenetelmiä ja varotoimia ei noudateta, ja jos tuotetta käytetään pakkauskossa mainittu viimeisen käytöpäivän jälkeen.

Valmistaja ei myöskään ole missään vastuussa lääketieteellisten päättösten ja laitteen käyttö- tai asennusmenetelmien seurauskista. Valmistaja ei ole vastuussa minkäänlaisesta materiaalisesta, biologisesta tai moraalisesta vahingosta, joka on seurausta laitteen käytöstä tai toimenpiteen suorittajan valitsemasta

implantointiteknikasta.

Valmistajan jälleenmyyjillä tai edustajilla ei ole valtuuksia muuttaa edellä mainittuja ehtoja eikä tehdä muita sitoumuksia tai myöntää tuoteelle muita takuita edellä mainittujen lisäksi. Tätä takuuta säätelee Italian laki, ellei toisen valtion pakollisia lakeja sovelleta, jos valmistaja on antanut luvan tuotteen myyntiin yhdessä tai useammassa muussa maassa kuin Italiassa.

SVENSKA

NiTIDES

„Carbofilm™-överdraget självexpanderande perifert stentsystem som eluerar Amphilius™ (sirolimus+fettsyra)

1. BESKRIVNING AV ENHETEN

Produktsystemen NiTiDES består av en självexpanderande stent och ett inläggningssystem för att placera och veckla ut den korrekt.

Stenten är en böjlig, självexpanderande, implantabel enhet. Den är tillverkad av en legering av nickel och titanum (Nitinol) och överdragen med „Carbofilm™“, ett tunt kolager som har turbostrukturisk struktur med hög täthet som i stora delar är identisk med strukturen i pyrolytiskt kol.

Genom att det underliggande materialet täcks över får det samma biokompatibla och hemokompatibla egenskaper som pyrolytiskt kol utan att detta inverkar på själva materialets fysiska och strukturella egenskaper.

Sex röntgentäta tantalmarkörer är applicerade på stenten (tre i varje ände) för att möjliggöra korrekt placering på området för mäлlesionen.

Utsidan av stenten har särskilda färger som är helt överdragna med „Carbofilm™“, och är avsedda att innehålla den farmaceutiska formuleringen Amphilius™, som består av läkemedlet Sirolimus och en blandning av långkedjiga fettsyror. Den specifika läkemedelsdoseringen för den blodkärlsyta som behandlas är ungefär 0,9 µg/mm², vilket motsvarar en minimodos på 270 µg på den mindre stenten (6,0 x 20 mm) och en maximodos på 2 420 µg på den större stenten (8,0 x 150 mm).

Det inläggningssystemet som används är av "over-the-wire"-typ, och garanterar att stenten kan placeras och frigöras på säkerhet sätt vid lesionen. Det visas schematiskt i figur 1 och består av:

- en kateterkropp (7) 6 F i diameter som i sin tur består av:
 - en ytter införingskida som kan dras tillbaka, den distala, halvgenomskinliga sektionen (3) som innehåller stenten (4); införingskidan har en röntgentät halskrage (13) nära kataterns ände.
 - ett inre lumen som trycker ihop en spiral (6) och ett inre rör (2) som är kompatibel med en 0,035 turns mandräng; det inre lumentet sträcker sig längs katetern från en lueradapter (12) som är säkrad proximalt till handtaget och som distalt slutar vid änden (1) i röntgentäta material för att underlättar lokalisering och placering av stenten när den visas på ett avbildningsstöd.
 - En stoppare (5) som är fast ansluten till det inre lumentet hindrar att stenten förskjuts axialt under utdragningen av den ytter införingskidan.
- ett handtag (8) med ett inläggningssystem, med vilken katatern kan placeras och stenten vecklas ut i situ.

Handtaget är ergonomiskt utformat så att operatören kan hålla och använda den med bara en hand. Det har en luerport (12) i den proximala änden, som används för att spola mandrängens lumen, en säkerhetsnyckel (10), ett hjul (9) och en ände för utdragnings (11).

Tillverkaren producerar direkt den perifera stenten + katetersystemet för utveckling och implementering alla procedurer för kvalitetskontroll både under tillverkningen och på den färdiga produkten, enligt riktlinjerna för god tillverkningssed.

2. AVSEDD ANVÄNDNING AV ENHETEN

Det självexpanderande perifera stentsystemet är avsett för behandling av perifer artärsjukdom som berör den yttiga lärbensartären och den proximala knävecksartären.

3. INDIKATION FÖR ENHETEN

Enheten indickeras för behandling av stenos i lärbens-knävecksartärerna ovanför knäet i vuxna symptomatiska patienter [Rutherford-kategori 2-5]. Den behandlade lesionen, maximalt 14 centimeter lång, måste antingen vara okluderad eller, med stenos högre än 50 %, de-novo eller restenotisk, och inte ha behandlats tidigare med en stent.

4. KONTRAINDIKATIONER

Användning av stenten är kontraindikerad i följande situationer:

- Lesioner som anses omöjliga att behandla med PTA eller andra behandlings tekniker.
- Graviditet, ammande kvinnor.
- Lesioner lokaliserade till de två distala tredjedelarna av knävecksartären eller till knäleden.
- Kliniska tillstånd som hindrar användningen av behandling med trombocytaggregationshämmande medel och/eller antikoagulanter.

5. VARNINGAR

- Användning av enheten rekommenderas inte för patienter med känd överkänslighet eller allergier mot Sirolimus, fettsyror (som stearinsyra, palmitinsyra, behensyra) eller stentens metallkomponenter (som nickel, titan och tantal).
- Enheten är endast avsedd för engångsbruk. Använd, behandla eller sterilisera den inte igen. Detta kan medföra risk för kontaminerings av enheten och/eller infektioner för patienten, inflammation och överföring av infektionssjukdomar från en patient till en annan.
- Enheten har tillverkats för användning i ett fullständigt system. Använd inte de olika komponenterna separat.
- Använd inte produkten om förpackningen har öppnats eller skadats, om stenten inte förvarats korrekt eller efter angivet utgångsdatum. Produktens sterilitet kan i så fall inte garanteras.
- Enheten ska endast användas av läkare med särskild utbildning för att utföra perkutan transluminall angioplastik (PTA) och perifer stentimplantation.
- Om det uppstår motstånd under någon fas av proceduren ska systemet inte forceras: dra ut stentsystemet och hela inläggningsskatatern, mandrängen och införaren som en enda enhet. Om för starkt kraft används, och/eller vid felaktig hantering, kan följdene bli att stenten oavsiktligt vecklas ut eller att

placeringskatatern skadas.

- Under operationen kan felaktig hantering orsaka dissektion, perforering eller bristningar i kälet.
- Mata inte fram eller dra tillbaka stentsystemet under utvecklingen: Det kan orsaka allvarliga skador på kälets väggar.
- Implantation av självexpanderande perifer stent kan orsaka dissektion av det kärl som är distalt och/eller proximalt till stenten och kan även orsaka akut blockering av blodkärlat så att ytterligare en operation blir nödvändig (kirurgiskt ingrepp för kärlersättning, ytterligare dilatation, utveckling av flera stentar eller andra procedurer).
- När stenten delvis har vecklats ut kan den inte tas ut igen med hjälp av inläggningssystemet.

6. FÖRSIKTIGHETSATGÄRDER

- **Använd aldrig snabblösningssystemet vid början av stentexpansionen.** Använd det **endast om det är nödvändigt** och efter att ha frigjort minst **halva längden** av stenten.
- Enheten ska hanteras försiktigt för att undvika all kontakt med instrument som är av metall eller slipande och som kan skada den eller ge upphov till mekaniska förändringar.
- Enheten får inte komma i kontakt med vätskor innan den prepareras och placeras.
- Enhetenets placeringssystem är inte avsett för användning med kontrastmedelsinjektorer.
- Om stenter implanteras i rad efter varandra ska de röntgentäta markörerna överlappa varandra. Överlappning bör inte omfatta mer än två stentar.
- Vid överlappande stenter rekommenderas mindre än 20 mm överlappande längd.
- För att undvika skada på stenten ska särskilt stor försiktighet iakttas när en mandräng eller en ballongkateter eller en annan enhet förs genom en stent som har vecklats ut.

7. MRT-SÄKERHETSINFORMATION

Icke-klinisk testning har visat att tillverkarens produktfamiljer med Nitinol-stentar är MR-vilkorliga. En patient med den här enheten kan skannas säker i ett MR-system som uppfyller följande villkor:

- Statistisk magnetfelt med 1,5-Tesla (1,5 T) eller 3-Tesla (3 T)
- Maximal spatial fjärdgradient på 6 140 G/cm (61,40 T/m)
- Maximal MR-systemrapporterad, genomsnittlig specifik absorptionsnivå (SAR) för hela kroppen:
 - 1 W/kg (normalt driftläge) vid 1,5 T
 - 1 W/kg (normalt driftläge) vid 3 T

Radiofrekvent uppvärming

Under de skanningsförhållanden som anges ovan förväntas tillverkarens produktfamiljer med Nitinol-stentar att ge upphov till en maximal temperaturökning som understiger 6,8 °C efter 15 minuters kontinuerlig skanning vid en MR-systemrapporterad, genomsnittlig specifik absorptionsnivå (SAR) för hela kroppen på 1,0 W/kg.

1,5 T	3 T
≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C

Konfiguration med en stent

Största temperaturförändring

Överlappande stentkonfiguration

Största temperaturförändring

Vid icke-klinisk testning är bildartefakterna som kan orsakas av enheten cirka 0,7 cm större än tillverkarens Nitinol-stentar när den avbildas med gradient-eko- och spinn-eko-pulsekvenser i ett 3 T-MRT-system.

MR-artefakt

Vid icke-klinisk testning är bildartefakterna som kan orsakas av enheten cirka 0,7 cm större än tillverkarens Nitinol-stentar när den avbildas med gradient-eko- och spinn-eko-pulsekvenser i ett 3 T-MRT-system.

8. LEVERANSSÄTT

NiTIDES-enheten levereras steril (med hjälp av en blandning av etylenoxid och CO₂), för engångsbruk och förpackad i två påsar som inte får föras in i ett steril område. **OBS! Den inre påsen är den enda sterila barrären.**

Sterilitet och kemisk stabilitet garanteras vid obruten förpackning, och fram till det utgångsdatum som anges på förpackningen (BÄST FÖRE).

Innehåll: ett (1) „Carbofilm™-överdraget självexpanderande perifert stentsystem som eluerar Amphilius™ (sirolimus+fettsyra)

9. FÖRVARING

Produkten ska förvaras såsom indikerats på förpackningen, på en sval och torr plats, med en förvaringstemperatur på max 25 °C.

10. MODELLER

Varije NiTiDES-enhet identifieras genom en modellkod och ett partinummer; tillgängliga produktkoder är listade i tabell 1.

11. LÄKEMEDELSREGIM

Studier i den medicinska litteraturen visar att behandling med trombocytaggregationshämmande medel måste ges före operationen, antikoagulantterapi under proceduren och trombocytaggregationshämmande medel efter operationen.

Trombocytaggregationshämmande behandling under perioden efter proceduren innehåller administrering av:

- Tienvirpidin (tiklopidin eller clopidogrel eller prasugrel i de doser som anges i de bifogade instruktionsbroschyrenna eller enligt läkarordination)
- Aspirin med minimidosen 100 mg/dag på obestämd tid

Beroende på proceduren komplextet och de många faktorer som påverkar patientens tillstånd fastställer läkaren passande terapi efter eget gottfinnande.

12. INTERAKTION MED LÄKEMEDEL

Även om det inte finns några specifika kliniska data tillgängliga kan vissa läkemedel, såsom Tacrolimus som verkar genom samma bindande protein

(FKBP), hindra Sirolimus verkan. Sirolimus metaboliseras av CYP3A4. Starka CYP3A4-inhibitörer kan orsaka ökad exponering för Sirolimus, särskilt vid multipel implantation. Systemisk exponering för Sirolimus om patienten samtidigt tar systemiska immunsuppressiva läkemedel måste också tas i betraktande.

13. KLINISK PRÖVNING MED NITIDES

NiTIDES-stentens huvudsakliga säkerhet och verkningsgrad har fastställts genom den avgörande kliniska prövningen ILLUMINA före marknadslanseringen.

Studiens utformning: I en single arm-studie över flera kliniker behandlades 100 patienter med symptomatisk sjukdom i lärbens-knäveksartärer med en maximum lesionslängd på 14 cm med NiTIDES-stenten. Den primära verkan (primär öppenhet) och primära säkerhetsändpunkten (en sammansättning av de viktigaste biverkningarna: död, amputation av mällemmen, ischemi i mällemmen som kräver kirurgiskt ingrepp eller kirurgisk reparation av mälkärllet eller kliniskt driven revaskularisering av mällesionen, Rutherford-poäng som sänkts med 2 klasser, eller till klass 5 eller 6) jämfördes med ett objektivt resultatmål (OPG) efter 12 månader.

Resultat: 100 % framgångsrika procedurer.

Resultat för doppler-ultraljud visar primär öppenhet på 87 % (77/89, 95 % konfidensintervall 80-94), uppfyller kraven i OPG (73 %), efter 24-månader var primär öppenhet 81 % (63/78).

12-månders primär säkerhetsändpunkt var 96,8 % (90/93), uppfyller kraven i OPG (19,6 %), 2,2 % (2/93) av patienterna genomgick kliniskt driven revaskularisering av mällesionen, 1,1 % (1/93) avled, 0 genomgick amputation av mällemmen, 0 genomgick ischemi i mällemmen som krävde kirurgiskt ingrepp eller kirurgisk reparation av mälkärllet och för 0 sänktes Rutherford-poängen med två klasser, eller till klass 5 eller 6.

24-månders säkerhetsändpunkt var 87,8 % (79/90), 6,7 % (6/90) av patienterna genomgick kliniskt driven revaskularisering av mällesionen, 3,3 % (3/90) avled, 0 genomgick amputation av mällemmen, 1,1 % (1/90) genomgick ischemi i mällemmen som krävde kirurgiskt ingrepp eller kirurgisk reparation av mälkärllet och för 1,1 % (1/90) sänktes Rutherford-poängen med två klasser, eller till klass 5 eller 6.

14. BRUKSANVISNING

Val av enhet

Hänvisa till längden på mällesionen för att fastställa den längd som behövs för stenten. För att på lämpligt sätt täcka lesionen ska den utvecklade stentens längd vara minst 5 mm längre än själva lesionen på vardera sidan.

Hänvisa till kärllets diameter proximalt och distalt till lesionen för att fastställa rätt stentstorlek. För att säkerställa säker placering av stenten ska den större diamentern användas som grund för valet av lämplig stentstorlek. Se informationen i tabell 1 vid val av modell.

Förberedelse av enheten

Innan stenten läggs i ska heparin administreras. Kontrollera också att patientens helblodkoagulationstid (ACT) är tillfredsställande och överensstämmer med klinikens rutiner.

Under förberedelsen av systemet ska du vara särskilt försiktig så att inte någon vätska kommer i kontakt med stenten.

- Öppna kartongen och ta ut påsen som innehåller den sterila påsen.
- Efter att undersökt förpackningen med avseende på eventuellt skada öppnar du den externa icke-sterila aluminiumfoliepåsen, och tar sedan ut innehållet från den inre påsen. (Anmärkning: Aluminiumfoliepåsen och den inre plastpåsen utsida AR INTE STERILA. Bar plastpåsen innehålls är STERILT).
- Se till att hållarna placeras på en plan yta inom ett steril område. Lossa på bandet runt handtaget och ta bort katetern från skyddsspiralen.
- Kontrollera att inläggningsskataterna inte har veck, böjar eller andra skador. Skador på enheten kan försvåra dess prestanda.
- Fyll en 3 ml spruta med fysiologisk lösning som innehåller heparin, anslut till lueradapters för spoling (figur 1, objekt 12) och använd positivt tryck. Fortsätt spola tills den fysiologiska lösningen kommer ut ur kateterns distala ände.
- Inspektera kateterns distala ände och försäkra dig om att stenten (figur 1, objekt 4) är helt täckt av den ytter inläggningsskidan.

Använd enheten om den är skadad eller om stenten är delvis expanderad.

Kompatibilitet med tillbehör

Inläggningssidor med diameter 6 F (2,0 mm) eller större kan användas med NiTIDES-enheten.

Mandränger som är 0,035 tum (0,89 mm) eller mindre kan användas med NiTIDES-enheten. Valet om mandrängens styrhet och spetsutvändande beror på läkarens kliniska erfarenhet.

Om det skulle bli nödvändigt att använda en ledarkateter så är systemen kompatibla med ledarkatetrar med en diameter på 8 F (2,7 mm) eller större. Se i så fall till att den hemostatiska ventilen är helt öppen innan den valda enheten förs in.

Stentensättning

- Se till att säkerhetsnyckeln (figur 1, objekt 10) till handtaget är i låst läge (detalj B).
- Tvätta den frilagda delen av mandrängen med hepariniserad fysiologisk koksaltlösning för att ta bort spår av blod och kontrastmedel.
- Mata fram systemet över mandrängen tills stenten kommer fram till handlingsområdet.

Om ovanligt motstånd uppstår under någon fas ska systemet inte forceras: Dra tillbaka införaren, mandrängen och enheten tillsammans som en enda enhet. Om för stor kraft används, och/eller vid felaktig hantering, kan följden bli att stenten oavsettlig vecklas ut eller att placeringsskataterna skadas.

Frammatringning av enheten

- Mata fram systemet tills stenten kommer bortom lesionen.
- Dra tillbaka systemet tills stenten befinner sig mitt för lesionen.
- Kontrollera att den del av inläggningssystemet som är utanför patientens kropp är utsträckt utan hinder och rak.

Varning: Om inläggningssystemet inte sträcks ut korrekt kan stenten vecklas ut utanför mäldesonen.

Stentimplantation och expansion

- Ta ordentligt tag i handtaget med ena handen och kontrollera att de röntgentäta markörerna på stenten är placerade proximalt och distalt i förhållande till lesionen.
- Försäkra dig om att inläggningsskidan inte rubbas när stenten vecklas ut.
- Vrid säkerhetsnyckeln på handtaget moturs (figur 1, detalj B) för att lösa upp det (STEG 1) och dra sen ut det helt (STEG 2).
- Medan handtaget hålls i ett fixerat läge i förhållande till patienten ska du ännu en gång kontrollera att de röntgentäta markörerna är i önskat läge i förhållande till lesionen. Börja veckla ut stenten genom att vrida på hjulet (figur 1, objekt 9) med tummen i pilens riktning, såsom framgår av figur 1.
- När stentens distala ände är ordentligt fåst vid kärlets väggar fortsätter du utvecklingen med hjälp av fluoroskop genom att vrida på hjulet till änden på stenten öppnats och den är heltimplanterad i kärlväggarna.
- Om snabb utveckling krävs ska du göra så här: Se till att det inte finns några hinder (t.ex. iskravud lueradapter, hona) i den bakre änden av handtaget, ta tag i den bakre änden av enheten (för utdragning, figur 1, objekt 1) med den andra handen och dra ut, medan du håller den främre delen av handtaget helt stilla i förhållande till patienten, såsom framgår av figur 1.
- Kontrollera med hjälp av fluoroskop att stenten har expanderat helt.
- Vid behov kan stenten expanderas ytterligare med hjälp av en PTA-ballongkaterter. Vid val av diameter på ballongkatertern, och när efterexpansion utförs, ska du ta hänsyn till den kändiameter som har utvärderats med hjälp av angiografi. Du måste under alla omständigheter vara särskilt noga med att inte expandera stenten utöver dess nominella diameter som står angiven på etiketten.
- Stentens slutgiltiga diameter måste passa referenskärllets diameter.

15. MÖJLIGA BERVERKNINGAR

Eventuella oönskade effekter som kan vara förbundna med implantation av en perifer stent är bl.a. risker relaterade till perkutan transluminal angioplastik och ytterligare risker förbundna med användningen av stent, enligt vad som anges nedan.

- Infektion, smärta och hematom vid accessen
- Allergisk eller oönskad reaktion mot kontrastmedel, läkemedel som används under proceduren eller material som stenten består av
- Artärspasm
- Artär- eller stenttrombos
- Lärbensartäraneurysm eller pseudoaneurysm
- Aterosklerotisk distal embolisering
- Blödning
- Dödsfall
- Dissektion, perforering eller bristningar i det stentade kärllet
- Emboli
- Njursvikt
- Ischemi i de nedre extremiteterna (som kräver kirurgiskt ingrepp)
- Restenos i den artär där stenten har implanterats
- Stentembolisering
- Kärlocklusion eller olöst stenos

16. ANSVAR OCH GARANTI

Tillverkaren garanterar att allt som är möjligt har gjorts för att konstruera, tillverka och förpacka enheten med de metoder som är tillgängliga på teknikens nuvarande standpunkt som anses som lämpligast. Vidare har principer om integrerad säkerhet tillämpats vid design och konstruktion. Detta säkerställer säker användning under angivna förhållanden och för avsedda åndamål, genom att följa de försiktighetsåtgärder som indikeras i föregående punkter, med målet att så långt som möjligt minimera, även om det inte går att helt eliminera, riskerna i samband med användning av enheten.

Enheten får uteslutande användas på specialistläkares ansvar, och kvarstående risker och eventuella biverkningar och komplikationer med den behandling som den är avsedd för måste beaktas, såsom nämnts i övriga avsnitt i denna bruksanvisning.

Den tekniska komplexiteten, och den kritiska naturen av medicinska val och metoder för att tillämpa enheten, undantalar tillverkaren från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, för verkningssättet resultaten efter användningen av enheten eller dess verkningsgrad för att åtgärda en funktionsnedsättning, sjukdomstillstånd eller något annat medicinskt problem. I själva verket beror resultaten, både ur klinisk synvinkel och vad gäller enhetens funktionellitet och varaktighet, också på många faktorer som ligger utanför tillverkarens kontroll, bland annat patientens tillstånd, det kirurgiska förarandet för implantering eller användning, och metoderna för manipulation av enheten efter att förpackningen har öppnats.

Mot bakgrund av dessa faktorer gäller tillverkarens ansvar endast om det har konstaterats att enheten påverkades av defekter när den släpptes på marknaden. För detta åndamål måste kunden omedelbart ställa enheten till tillverkarens förfogande, i enlighet med villkoren för utgång och preskription som krävs enligt lag. Tillverkaren förbehåller sig rätten att undersöka enheten som anses vara felaktig och att fastställa om den faktiskt påverkas av defekter som kan påverka produkterns säkerhet. Tillverkarens ansvar utesluts om (i) den påstådda defekten beror på att enheten uppfyller en obligatorisk regel eller en bindande bestämmelse, och/eller (ii) defekten som orsakade skadorna inte fanns när tillverkaren lanserade enheten och/eller (iii) om teknisk och vetenskaplig kunskap vid den tidpunkt då tillverkaren lanserade enheten fortfarande inte var tillräcklig för att kunna betrakta enheten som defekt, och/eller (iv) i något annat fall, utöver vad som angelägts ovan, i vilket lagen uttryckligen utesluter eller begränsar tillverkarens ansvar för skador på grund av defekta produkter. Garantin består uteslutande av utbyte av den defekta enheten mot en annan av samma eller likvärdig typ som tillverkas av tillverkaren. Garantin gäller endast om enheten returneras korrekt till tillverkaren tillsammans med en skriftlig och detaljerad rapport om de påstådda defekterna och, i fall med

en planterad enhet, orsakerna till borttagning från patienten. De påstådda defekterna måste omedelbart rapporteras till tillverkaren i enlighet med villkoren för förvarande och lagstadgad preskrift.

När bytet har gjorts ersätter tillverkaren kunden de utgifter som denne ådragit sig för att returnera den erkänt defekta enheten.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar i fall då de av användningsmetoder och försiktighetsanvisningar som indikerats i denna bruksanvisning inte har beaktats, och vid användning efter det utgångsdatum som indikerats på förpackningen.

Vidare frånsäger sig tillverkaren allt ansvar vad beträffar följderverkningarna av medicinska val och användningsmetoder eller tillämpning av enheten och ska därför inte, under några omständigheter, hållas ansvarig för materiell, biologisk eller ideell skada av något slag som uppkommer som ett resultat av att enheten tillämpas, och operatörens val av den implantateknik som använts.

Tillverkarens agenter och representanter är inte behöriga att ändra något av de ovannämnda villkoren eller påta sig några ytterligare förpliktelser eller utfästa någon garanti beträffande denna produkt, utöver vad som faststälts ovan. Den här garantin regleras i italiensk lag, såvida inte obligatoriska lagar i annat land gäller i fall då tillverkaren har godkänt distribution av produkten i ett eller flera andra länder än Italien.

NEDERLANDS

NITIDES

Met *Carbofilm™ gecoat zelfexpanderend perifeer stentsysteem dat Amphilius™ (Sirolimus+vetzuur) afgeeft*

1. BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL

De serie NiTiDES hulpmiddelen bestaat uit een zelfexpanderende stent en een introductiesysteem voor de juiste plaatsing en ontplooiing ervan.

De **stent** is een buigzaam, zelfexpanderend implanteerbaar hulpmiddel. Hij is gemaakt van een nikkel-titaniumlegering (nitinol) met een coating van *Carbofilm™*, een dun laagje koolstof met een turbostratische structuur met hoge dichtheid die in essentiële gelijk is aan de structuur van de pyrolytische koolstof. Door de coating van het substraat krijgt dit de biocompatibele en hemocompatibele kenmerken van pyrolytische koolstof, zonder dat de fysieke en structurele eigenschappen van het substraat zelf worden aangetast.

Op de stent zitten zes radiopake tantaalmarkers (drie aan elk uiteinde) om een correcte plaatsing ter hoogte van de doelaësie mogelijk te maken.

De buitenkant van de stent heeft speciale, volledig met *Carbofilm™* gecoate groeven waarin de farmaceutische formulering Amphilius™ zit, die bestaat uit het geneesmiddel Sirolimus en een mengsel van langeketenvetzuren.

De specifieke geneesmiddeldosering voor het behandelde bloedvatoppervlak is ongeveer 0,9 µg/mm², hetgeen overeenkomt met een minimum dosis van 270 µg op de kleinere stent (6,0x20 mm) en een maximum dosis van 2420 µg op de grotere stent (8,0x150 mm).

Het gebruikte **introductiesysteem** is van het 'over de draad' type, hetgeen verzekert dat de stent veilig over de laesie geplaatst en losgelaten kan worden.

Het wordt schematisch weergegeven op Afbeelding 1 en bestaat uit:

- een katheretericaaht (7) met een diameter van 6F, bestaande uit:
 - een terugtrekbare externe huls, waarvan het distale, semi-transparante deel (3) de stent (4) bevat; de huls heeft een radiopake kraag (13) bij de tip van de katheret;
 - een binnenlumen met een spool (6) en een binnenbus (2) die compatibel is met een voerdraad van 0,035 inch; het binnenlumen strekt zich over de katheret uit vanaf een luerbevestiging (12) die proximaal aan het handvat is vastgezet en distaal bij de tip (1) van radiopak materiaal eindigt, om de locatie en plaatsing van de stent te vergemakkelijken terwijl deze bekeken wordt op een beeldvormingssysteem. Een aanslag (5) geïntegreerd met het binnenlumen voorkomt axiale verplaatsing van de stent tijdens het terugtrekken van de buitenste huls;
- een handvat (8) met een introductiesysteem waarmee de katheret kan worden gepositioneerd en de stent in situ kan worden ontplooid.

Het ergonomisch gevormde handvat maakt het de gebruiker mogelijk het vast te pakken en te gebruiken, ook met één hand. Aan het proximale uiteinde heeft hij een lueraansluiting (12) die gebruikt wordt om het voerdraadlumen uit te spoelen, een veiligheidsspie (10), een wietje (9) en een terugtrekbaar staartstuk (11). De fabrikant produceert de perifeire stent en het ontplooibare katheretersysteem rechtstreeks en voert alle kwaliteitscontroles uit, zowel gedurende de productie als op het eindproduct, in overeenstemming met de goede productiepraktijken.

2. BEOOGD GEBRUIK VAN HET HULPMIDDEL

Het zelfexpanderende perifeire stentsysteem is bestemd voor de behandeling van perifeire slagaderaanoechingen die de oppervlakkige dijbeenslagader en de proximale popliteale slagader aantasten.

3. INDICATIE VAN HET HULPMIDDEL

Het hulpmiddel is geïndiceerd voor de behandeling van stenose van femoropopliteale slagaders boven de knie bij volwassen symptomatiche [Rutherford categorie 2-5] patiënten. De behandelde laesie, met een maximale lengte van 14 centimeter, moet geoccludeerd zijn of een stenose hebben van meer dan 50%, de-novo of restenotisch, en niet eerder behandeld zijn met een stent.

4. CONTRA-INDICATIES

Gebruik van de stent is gecontra-indiceerd in de volgende situaties:

- Laesies die onbehandelbaar worden geacht met PTA of andere intervencietechnieken.
- Vrouwen die zwanger zijn, borstvoeding geven.
- Laesies die zich in de twee distale derden van de popliteale slagader bevinden of bij het kneiegewricht.
- Klinische aandoeningen die het gebruik van een therapie met antiaggregantia en/of anticoagulantia belemmeren.

5. WAARSCHUWINGEN

- Het gebruik van het hulpmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten van wie bekend is dat ze overgevoelig of allergisch zijn voor Sirolimus, vetzuren (zoals stearinezuur, palmitinezuur, behenezuur) of de metalen componenten van de stent (zoals nikkel, titanium en tantaal).
- Dit hulpmiddel is bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken, opnieuw behandelen of opnieuw steriliseren. Dit zou risico's voor verontreiniging van het hulpmiddel en/of infecties bij de patiënt, ontsteking, en overdracht van infectieziekten van de ene patiënt op de andere kunnen veroorzaken.
- Het hulpmiddel is ontworpen om als systeem te functioneren. Gebruik de onderdelen ervan niet apart.
- Gebruik het hulpmiddel niet als de verpakking geopend of beschadigd is, onjuist opgeslagen is, of als de aangegeven uiterste houdbaarheidsdatum verstreken is. In dergelijke gevallen wordt de steriliteit van het product niet gewaarborgd.
- Het hulpmiddel mag alleen worden gebruikt door artsen die specifiek getraind zijn in het uitvoeren van percutane transluminale angioplastiek (PTA) en implantatie van perifeire stents.

- Als er ergens weerstand wordt ondervonden gedurende de procedure, mag u het systeem niet forceren: trek het stentsysteem en de gehele introductiekatheret, de voerdraad en de introducer als één geheel terug. Het uitoefenen van sterke druk en/of onjuiste hantering kunnen ertoe leiden dat de stent onopzetdelijk ontplaat wordt of de plaatsingskatheret wordt beschadigd.
- Op elk moment tijdens de operatie kan onjuiste hantering dissectie, perforatie of scheuring van het bloedvat veroorzaiken.
- Het stentsysteem mag tijdens de plaatsing niet vooruit of achteruit worden geschoven: dit kan ernstige schade aan de vaatwanden veroorzaken.
- De implantaatie van een zelfexpanderende perifeer stent kan bloedvatdissectie distaal en/of proximaal ten opzichte van de stent veroorzaken, en tevens acute blokkering van het bloedvat veroorzaiken waardoor een extra ingreep nodig is (chirurgische ingreep voor bloedvatvervanging, verdere dilatatie, ontploeing van verdere stents of andere procedures).
- Als de stent eenmaal gedeeltelijk is ontplaat, kan hij niet meer worden teruggehaald met het introductiesysteem.

6. VOORZORGEN

- Gebruik nooit het quick-release-systeem aan het begin van de stentverwijding. Gebruik dit **alleen indien noodzakelijk**, nadat minstens de **helft van de lengte** van de stent is losgelaten.
- Het hulpmiddel moet voorzichtig gehanteerd worden om aanraking met metalen of schurende instrumenten te vermijden die het zouden kunnen beschadigen of mechanische wijzigingen zouden kunnen veroorzaken.
- Voorafgaand aan de voorbereiding en positionering mag het hulpmiddel niet in aanraking komen met vloeistoffen.
- Het plaatsingssysteem van het hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik met contrastmiddelen/liquors.
- Worden stents in tandem geimplanteerd, dan moeten de betreffende radiopake markers elkaar overlappen. De overlapping mag niet meer dan twee stents betreffen.
- In geval van overlappende stents wordt een overlapping van minder dan 20 mm aanbevolen.
- Om beschadiging van de stent te voorkomen, moet u uiterst voorzichtig zijn wanneer u een voerdraad of een ballonkatheret of een ander hulpmiddel door de ontplaatde stent voert.

7. MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE

Niet-klinische tests hebben aangegetoond dat de Nitinol-stentproductlijnen van de fabrikant MR-conditioneel zijn. Een patiënt met dit hulpmiddel kan veilig worden gescand in een MR-systeem dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Statisch magnetisch veld van 1,5-Tesla (1,5T) of 3-Tesla (3T)
- Maximale ruimtelijke veldgradiënt van 6,140 G/cm (61,40 T/m)
- Gerapporteerde maximale, over het gehele lichaam gemiddelde specifieke absorptiesnelheid (SAR) van het MR-systeem van:
 - 1 W/kg (normale bedrijfsmodus) bij 1,5T
 - 1 W/kg (normale bedrijfsmodus) bij 3T

RF-verwarming

Onder de hierboven omschreven scanomstandigheden zullen de Nitinol-stentproductlijnen van de fabrikant naar verwachting een maximale temperatuurstijging van minder dan 6,8 °C te zien geven na 15 minuten continu scannen bij een voor het MR-systeem gerapporteerde, gemiddelde specifieke absorptiesnelheid (SAR) over het gehele lichaam van 1,0 W/kg.

	1,5 T	3 T
Configuratie enkele stent		
Hoogste temperatuurverandering	≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
Configuratie overlappende stent		
Hoogste temperatuurverandering	≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C

MRI-artefact

Bij niet-klinische tests strekt de door het hulpmiddel veroorzaakte beeldartefact zich uit tot ongeveer 0,7 cm vanaf Nitinol-stents van de fabrikant bij beeldvorming met gradiënt-echo- en spin-echo-pulssequenties in een 3T MRI-systeem.

8. LEVERINGSWIJZE

Het NiTiDES hulpmiddel wordt steril geleverd (door gebruik van een mengsel van ethyleenoxide en CO₂), voor eenmalig gebruik, verpakt in twee zakjes die niet binnen een steriel gebied mogen worden gebracht. **OPMERKING: de binnenzak is de enige steriele barrière.**

De steriliteit en chemische stabiliteit worden gewaarborgd zolang de verpakking ongeopend blijft, tot aan de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat vermeld (ZIE ÚITERSTE HOUDBAARHEIDSDATUM).

Inhoud: een (1) met Carbofilm™ gecoat zelfexpanderend perifeer stentsysteem dat Amphilimus™ (Sirolimus+vetzuur) afgeeft

9. OPSLAG

Het product moet worden bewaard zoals aangegeven op de verpakking, op een koele en droge plaats, bij een bewaartemperatuur van maximaal 25 °C.

10. MODELLEN

Elk NiTiDES hulpmiddel wordt geïdentificeerd door een modelcode en een partijnummer; de beschikbare productcodes worden vermeld in tabel 1.

11. GENEESMIDDELENREGIME

Onderzoeken in de klinische literatuur wijzen op de noodzaak om antiaggregantia toe te dienen vóór de operatie, anticoagulantia tijdens procedure en antiaggregantia na de operatie.

De behandeling met antiaggregantia in de periode na de procedure bestaat uit de toediening van:

- Thienopyridine (ticlopidine of clopidogrel of prasugrel) in de doseringen die worden aangegeven in de bijbehorende instructieboekjes of overeenkomstig medisch voorschrijft

- Aspirine in een minimumhoeveelheid van 100 mg/dag, voor onbepaalde tijd. Gezien de complexiteit van de procedure en de vele factoren die van invloed zijn op de conditie van de patiënt, wordt het bepalen van de juiste therapie overgelaten aan het oordeel van de arts.

12. INTERACTIES MET GENEESMIDDELLEN

Hoewel er geen specifieke klinische gegevens beschikbaar zijn, kunnen bepaalde geneesmiddelen, zoals Tacrolimus, die ageren via hetzelfde bindende eiwit (FKBP), de doelmatigheid van Sirolimus aantasten. Sirolimus wordt gemetaboliseerd door CYP3A4. Sterke CYP3A4-remmers kunnen een verhoogde blootstelling aan Sirolimus veroorzaken, vooral in het geval van meervoudige implantaatie. Systemische blootstelling aan Sirolimus als de patiënt gelijktijdig immunosuppressieve geneesmiddelen gebruikt, moet eveneens in aanmerking worden genomen.

13. KLINISCHE PROEF MET NITIDES

De belangrijkste veiligheid en doeltreffendheid van de NiTiDES-stent zijn vastgesteld in de pivotale klinische proef ILLUMINA die aan het in de handel brengen voorafging.

Opzet van de studie: Binnen een multicenter, éénarmige studie werden 100 patiënten met symptomaticke femoropopliteale laesieën van 14 cm met de NiTiDES-stent behandeld. De primaire werkzaamheid (primaire doorgankelijkheid) en het primaire veiligheidseindpunt (een samenstelling van belangrijke ongewenste voorvalen: overlijden, amputatie van het doeldeelmaat, ischemie van het doeldeelmaat waarvoor chirurgische interventie of chirurgische reparatie van het doelvat nodig was of klinisch aangedreven revascularisatie van het doeldeelmaat, verslechtering van de Rutherford-score met 2 klassen, of tot klasse 5 of 6) werden vergeleken met een Objective Performance Goal (OPG) na 12 maanden.

Resultaten: Procedureel succes werd in 100% verkregen.

Resultaten voor Doppler echografie toonden een primaire doorgankelijkheid van 87% (77/89, 95% betrouwbaarheidsinterval 80-94) aan, waarmee werd voldaan aan de eisen van het OPG (73%). De primaire doorgankelijkheid over 24 maanden was 81% (63/78).

Het primaire veiligheidseindpunt over 12 maanden was 96,8% (90/93), waarmee werd voldaan aan de vereisten van het OPG (19,6%). 2,2% (2/93) van de patiënten had een klinisch aangedreven revascularisatie van het doeldeelmaat, 1,1% (1/93) overleed, 0 had amputatie van een doeldeelmaat, 0 had ischemie van een ledemaat waarvoor chirurgische interventie of chirurgische reparatie van het doelvat nodig was en 0 had verslechtering van de Rutherford-score met twee klassen, of klasse 5 en 6.

Het veiligheidseindpunt over 24 maanden was 87,8% (79/90), 6,7% (6/90) van de patiënten had een klinisch aangedreven revascularisatie van het doeldeelmaat, 3,3% (3/90) overleed, 0 had amputatie van een doeldeelmaat, 1,1% (1/90) had ischemie van een ledemaat waarvoor chirurgische interventie of chirurgische reparatie van het doelvat nodig was en 1,1% (1/90) had verslechtering van de Rutherford-score met twee klassen, of klasse 5 en 6.

14. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Selectie van het hulpmiddel

Bekijk de lengte van de doelaesie om te bepalen welke lengte de stent moet hebben. Om de laesie goed te bedekken, moet de lengte van de stent ten minste 5 mm langer zijn dan de laesie zelf.

Meet de diameter van het bloedvat proximaal en distaal van de laesie om de juiste stentmaat te bepalen. Om een veilige plaatsing van de stent te garanderen, gebruikt u de grotere diameter als basis voor het kiezen van de juiste stentmaat. Zie voor de selectie van het model de informatie in tabel 1.

Voorbereiding van het hulpmiddel

Vóór de introductie van de stent moet heparine worden toegediend en worden gecontroleerd of de geactiveerde stollingstijd (ACT - Activated Clotting Time) van de patiënt adequaat is, in overeenstemming met de praktijken in het centrum.

Tijdens de voorbereiding van het systeem moet er bijzonder op worden gelet dat de stent niet in aanraking komt met welke vloeistof dan ook.

- Open de doos en haal de zak die het steriele zakje bevat eruit.
- Na onderzoek van de verpakking op eventuele beschadigingen, open u het buitenste niet-steriele zakje van aluminiumfolie en hält u vervolgens de inhoud uit het binneste zakje. (N.B.: Het zakje van aluminiumfolie en het buitenoppervlak van het binneste plastic zakje **ZIJN NIET STERIEL**. Alleen de inhoud van het plastic zakje is STERIEL).
- Zet de steun op een vlakke ondergrond in een steriel gebied, maak de band rondom het handvat los en verwijder de katheret van de beschermende spool.
- Controleer of de introductiekatheret niet geknikt of verbogen is en geen andere beschadigingen vertoont. Door beschadiging van het hulpmiddel kunnen de prestaties ervan worden aangetast.
- Vul een injectiespuik van 3 ml met een fysiologische oplossing die heparine bevat, sluit hem aan op de luer-spoelaansluiting (afbeelding 1, punt 12) en pas positieve druk toe. Ga door met spoelen totdat de fysiologische oplossing uit het distale uiteinde van de katheret naar buiten komt.
- Inspecteer het distale uiteinde van de katheret, waarbij verzekerd moet worden dat de stent (afbeelding 1, punt 4) volledig wordt bedekt door de externe huls. Gebruik het hulpmiddel niet als het beschadigd is of als de stent gedeeltelijk uitgezet is.

Compatibiliteit met accessoires

Met het NiTiDES-hulpmiddel kunnen introducerhulzen met een doorsnede van 6F (2,0 mm) of groter worden gebruikt.

Met het NiTiDES-hulpmiddel kunnen voerdraden van 0,035 inch (0,89 mm) of minder worden gebruikt. De keuze van de stijfheid en de tipconfiguratie van de voerdraad hangt af van de klinische ervaring van de arts.

Mocht het nodig zijn om een geleidekatheret te gebruiken, dan zijn de systemen compatibel met geleidekathereten met een diameter van 8F (2,7 mm) of groter.

Zorg in dit geval dat de hemostatische klep helemaal open is, voordat u het geselecteerde samenstel naar binnen voert.

Inbrengen van de stent

- a) Controleer of de veiligheidsspie (afbeelding 1, punt 10) van het handvat in de vergrendelde stand staat (detail B).
- b) Spoel het blootgestelde deel van de voerdraad af met een fysiologische oplossing die heparine bevat, om bloedsporen of restanten contrastmiddel te verwijderen.
- c) Verplaats het systeem voorwaarts over de voerdraad totdat de stent de plaats bereikt die behandeld moet worden.

Als op enig moment ongewone weerstand wordt ondervonden, forceert het systeem dan niet: trek de introducer, de voerdraad en het hulpmiddel samen als één geheel terug. Het uitvoeren van sterke druk en/of onjuiste hantering kunnen ertoe leiden dat de stent onopzettelijk ontploid wordt of de plaatsingskatheter wordt beschadigd.

Voorwaarde verplaatsing van het hulpmiddel

- a) Verplaats het systeem voorwaarts tot het punt waarop de stent voorbij de laesie is.
- b) Trek het systeem terug totdat de stent op één lijn ligt met de laesie.
- c) Controleer of het deel van het introductiesysteem buiten het lichaam van de patiënt ongehinderd uitgestrekt en recht is.

Voorzichtig: als het introductiesysteem niet goed uitgestrek is, kan de stent worden ontploid voorbij de doellaesie.

Implantatie en expansie van de stent

- a) Pak het handvat stevig vast met één hand en controleer of de radiopake markers op de stent proximaal en distaal ten opzichte van de laesie zitten.
- b) Zorg ervoor dat de introducerhuis niet beweegt tijdens het ontplooien van de stent.
- c) Draai de veiligheidsspie op het handvat linksom (afbeelding 1, detail B) om hem te ontgrendelen (STAP 1) en trek hem vervolgens volledig uit (STAP 2).
- d) Controleer nogmaals, terwijl u de handgreep in een vaste positie houdt ten opzichte van de patiënt, of de radiopake markers zich in de gewenste positie ten opzichte van de laesie bevinden; begin de stent te ontplooien door het wietje (afbeelding 1, item 9) met uw duim in de richting van de pijl te draaien, zoals getoond in afbeelding 1.
- e) Wanneer het distale uiteinde van de stent goed vastzit aan de vaatwanden, gaat u verder met het ontplooien van de stent onder fluoroscopie door aan het wietje te draaien totdat het uiteinde van de stent geopend is en volledig in de vaatwanden geimplanteerd is.
- f) Indien een snelle ontplooiing nodig is, gaat u als volgt te werk: zorg ervoor dat er zich geen obstakels (bv. vrouwtelijke luerbevestiging vastgeschroefd) in het achterste uiteinde van het handvat bevinden, pak het achterste uiteinde van het hulpmiddel (terugtrekken, afbeelding 1, punt 11) met uw andere hand vast en trek eraan, terwijl u het voorste deel van de handgreep ten opzichte van de patiënt volkomen stijl houdt, zoals aangegeven in afbeelding 1.
- g) Controleer met fluoroscopie of de stent volledig verwijd is.
- h) De stent kan indien nodig nog verder worden verwijd met behulp van een PTA-ballontkatheret. Houd bij het selecteren van de diameter van de ballontkatheret en bij het uitvoeren van de post-expansie rekening met de bloedvatdiameter die beoordeeld is door middel van angiografie. Zorg er in ieder geval voor dat de stent niet voorbij de nominale diameter die op het label is vermeld wordt verwijd.
- i) De uiteindelijke doorsnede van de stent moet geschikt zijn voor de doorsnede van het referentiebloedvat.

15. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

De mogelijke bijwerkingen die gepaard kunnen gaan met de implantatie van een perifere stent omvatten risico's die verband houden met percutane transluminale angioplastiek en extra risico's die verband houden met het gebruik van stents, zoals hieronder aangegeven.

- Infectie van de toegangsplaats, pijn en hematoom
- Allergische reactie op of bijwerking van contrastvloeistof, geneesmiddelen die tijdens de procedure worden gebruikt of materialen waaruit de stent is vervaardigd
- Slagaderspasme
- Arteriële of stenttrombose
- Aneurysma of pseudoaneurysma van de dijslagader
- Atherosclerotische distale embolisatie
- Bloeding
- Overlijden
- Dissectie, perforatie of scheuring van het gestente bloedvat
- Embolie
- Nierfalen
- Ischemie van de onderste ledematen (waarvoor speciale chirurgie nodig is)
- Restenose van de slagader waarin de stent geimplanteerd is
- Stentembolisatie
- Bloedvatocclusie of onopgeloste stenoze

16. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

De fabrikant garandeert dat het hulpmiddel met de grootste zorg is ontworpen, vervaardigd en verpakt, met gebruikmaking van de technieken die het meest geschikt worden geacht onder die welke bij de huidige stand van de technologie beschikbaar zijn en met toepassing van de beginselen van integratie van de veiligheid in ontwerp en constructie om een veilig gebruik te waarborgen wanneer het wordt gebruikt onder de omstandigheden en voor de doeleinden waarvoor het bestemd is, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen die in de voorgaande punten zijn genoemd, en in ieder geval gericht op het zoveel mogelijk beperken, doch niet volledig uitsluiten, van de risico's die aan het gebruik van het hulpmiddel zijn verbonden.

Het hulpmiddel mag uitsluitend worden gebruikt onder de verantwoordelijkheid van gespecialiseerd medisch personeel en rekening houdend met de restrisico's en de mogelijke bijwerkingen en complicaties van de therapie waarvoor het bestemd is, met inbegrip van die welke in de andere hoofdstukken van deze

gebruksaanwijzing worden genoemd.

De technische complexiteit en de kritische aard van medische keuzes en toepassingsmethoden van het hulpmiddel sluiten elke expliciete of impliciete garantie van de fabrikant over de doeltreffendheid van het resultaat na het gebruik van het hulpmiddel of over zijn doeltreffendheid in het oplossen van een toestand van invaliditeit, of enige andere pathologie of medisch probleem uit. De resultaten hangen namelijk, zowel vanuit klinisch oogpunt als qua functionaliteit en duur van het hulpmiddel, ook af van talrijke factoren die buiten de controle van de fabrikant vallen, waaronder slechts als voorbeeld en niet als uitputtende omstandigheden van de patiënt, de chirurgische procedure van implantatie of gebruik, de hanteringsmethoden van het hulpmiddel na het openen van de verpakking worden genoemd.

In het licht van deze factoren is de fabrikant slechts aansprakelijk indien is vastgesteld dat het hulpmiddel gebreken vertoont op het tijdstip waarop het in omloop is gebracht. Daartoe dient de klant het hulpmiddel onverwijld ter beschikking van de fabrikant stellen, met inachtneming van de door de wet voorgeschreven verjaringstermijnen; de fabrikant behoudt zich het recht voor om het hulpmiddel dat als defect wordt beschouwd te onderzoeken en vast te stellen of het daadwerkelijk gebreken vertoont die de veiligheid van het product kunnen beïnvloeden. De aansprakelijkheid van de fabrikant is uitgesloten indien (i) het beweerde gebrek te wijten is aan de overeenstemming van het hulpmiddel met een dwingend voorschrift of een bindende bepaling, en/of (ii) het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond toen de fabrikant het hulpmiddel op de markt bracht en/of (iii) indien de stand van de technische en wetenschappelijke kennis op het moment dat de fabrikant het hulpmiddel uitbracht, nog niet toeliet het hulpmiddel als gebrekig te beschouwen, en/of (iv) in elk ander geval, ook verschillend van die hierboven vermeld, waarin de wet uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de fabrikant uitsluit en beperkt voor schade als gevolg van defecte producten. De garantie bestaat uitsluitend uit de vervanging van het defecte hulpmiddel door een ander van hetzelfde of een gelijkwaardig fabricagetype van de fabrikant.

De garantie is alleen van toepassing indien het hulpmiddel correct naar de fabrikant wordt teruggestuurd samen met een schriftelijk en gedetailleerd rapport over de beweerde defecten en, in het geval van een geïmplanteerd hulpmiddel, over de redenen voor verwijdering uit de patiënt. De beweerde defecten moeten onverwijld aan de fabrikant worden gemeld met inachtneming van de verval- en wettelijke verjaringstermijnen.

Zodra de vervanging heeft plaatsgevonden, zal de fabrikant de klant de door hem gemaakte kosten voor de terugzending van het als defect erkende hulpmiddel terugbetaLEN.

De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af in elk geval van niet-naleving van de gebruiksmethoden en de voorzorgsmaatregelen aangegeven in deze gebruiksaanwijzing en in het geval van gebruik na de vervaldatum aangegeven op de verpakking.

Bovendien wijst de fabrikant alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen van medische keuzes en de wijze van gebruik of toepassing van het hulpmiddel en zal derhalve in geen geval worden vervuld voor enige materiële, biologische of morele schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de toepassing van het hulpmiddel en uit de keuze van de implantatietechniek door de gebruiker. De agenten en vertegenwoordigers van de fabrikant zijn niet gemachtigd om voornoemde voorwaarden te wijzigen, noch om enige bijkomende verbindenis aan te gaan of om enige garantie met betrekking tot dit product te geven, anders dan hierboven aangegeven. Deze garantie wordt beheerst door de Italiaanse wet, tenzij de dwingende wetten van een andere staat van toepassing zijn, in het geval dat de fabrikant toestemming heeft gegeven voor de omloop van het product in een of meer andere staten dan Italië.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NiTIDES

επικαλυμμένο με «Carbofilm™ αυτοδιαιτείνομενο σύστημα stent περιφερικών αγγείων Amphillimus™ (ραπαμυκίν+λιπαρό οξύ)

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι συσκευές της οικογένειας NiTIDES αποτελούνται από ένα αυτοδιαιτείνομενο stent και ένα σύστημα προώθησης για τη σωστή τοποθέτηση και έκπτυξή του. Το stent είναι μία εύκαμπτη, αυτοδιαιτείνομη εμφυτεύσιμη συσκευή. Είναι κατασκευασμένο από κράμα νικελίου και τιτάνιου (NiTi) και επικαλυμμένο με «Carbofilm™» μία λεπτή επιστρώματα άνθρακα με απροβιλοστρωματική δομή ωηλής πυκνότητας, ουσιαστικά τανομοιότυπη με τη δομή του πυρολυτικού άνθρακα. Η επικαλυψη παρέχει στο υπόστρωμα τα χαρακτηριστικά βιοσυμβατότητας και αιμοσυμβατότητας του πυρολυτικού άνθρακα, χωρίς να επηρέαζε τις φυσικές και δομικές ιδιότητες του υποστρώματος.

Το στέντ φέρει έξι ακτινοσκειρούς δείκτες από ταντάλιο (τρεις σε κάθε άκρο) ώστε να είναι δυνατή η σωστή τοποθέτησή του στην περιοχή της βλάβης.

Στην εξωτερική επιφάνεια του stent υπάρχουν ειδικές αύλακες, πλήρως επικαλυμμένες με «Carbofilm™», που περιέχουν τα φαρμακευτικό παρασκεύασμα Amphillimus™, το οποίο αποτελείται από τη φαρμακευτική ουσία ραπαμυκίνη και ένα μείγμα λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας.

Η δοσολογία της φαρμακευτικής ουσίας που πήρε την επιφάνεια του αγγείου όπου θα εμφυτευθεί το stent είναι περίπου 0,9μg/mm², η οποία αντιστοιχεί σε ελάχιστη δόση 270 μg για το μικρότερο stent (6,0x20 mm) και μέγιστη δόση 2420 μg για το μεγαλύτερο stent (8,0x150 mm).

Το σύστημα τοποθέτησης είναι τύπου over-the-wire (πάνω από το σύρμα), ώστε να διασφαλίζεται ότι το stent θα τοποθετηθεί και θα απτελεύθερωθεί με ασφάλεια πάνω στην περιοχή της βλάβης. Απεικονίζεται σχηματικά στην Εικόνα 1 και αποτελείται από:

- το σώμα του καθετήρα (7) με διάμετρο 6F, το οποίο αποτελείται από:
 - ένα αποσύρμενο εξωτερικό θηκάρι, μέσα στο άπω, μηδιανάντες τμήμα (3) το οποίο συγκρατεί το stent (4) ο θηκάρι φέρει ένα ακτινοσκειρό κολάρο (13) κοντά στο άκρο του καθετήρα:
 - έναν εσωτερικό αυλό που αποτελείται από ένα ελατήριο (6) και έναν εσωτερικό σωλήνα (2) συμβατό με οδήγη σύρμα 0,035 in-tens® του εσωτερικού αυλού εκτείνεται κατά μήκος του καθετήρα. Έκπιννεταις από το συνδετικό luer (12) στο εγγύς άκρο της λαβής και φθάνοντας μέχρι το άπω άκρο (1) του καθετήρα από ακτινοσκειρό υλικό, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός και η τοποθέτηση του stent υπό απεικονική καθοδήγηση. Το πάμα (5) που είναι ενωμένω με τον εσωτερικό αυλό επιδοιποίεται την αξονική μετατόπιση του stent όταν αποσύρεται το εξωτερικό θηκάρι·
 - μία λαβή (8) με σύστημα τοποθέτησης, που επιτρέπει την τοποθέτηση του καθετήρα και την εκπτυξή του stent in situ.

Η λαβή είναι εργονομικά σχεδιασμένη για να επιτρέπει στον χειριστή να την κρατά και να τη χρησιμοποιεί ακόμα και με το ένα χέρι. Διαθέτει μία θύρα luer (12) στο εγγύς άκρο, που χρησιμοποιείται για την εκπτυξή του αυλού του οδηγή σύρματος, ένα κλείδι ασφαλείας (10), ένα ροδάκι (9) και πίσω μέρος απόδυρος (11).

Ο κατασκευαστής κατασκευάζει απευθείας το σύστημα του stent περιφερικών αγγείων + καθετήρα έκπτυξης και διενεργεί όλους τους ελέγχους διασφάλισης ποιότητας, τόσο κατά το στάδιο της παραγωγής όσο και επί των τελικών προϊόντων, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής κατασκευαστικής πρακτικής.

2. ΠΡΩΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το αυτοδιαιτείνομενο σύστημα stent περιφερικών αγγείων προορίζεται για τη θεραπεία της Ιερεφερικής Αρτηριακής Νόσου που προσβάλλει την επιπολής μηριαία αρτηρία και την εγγύς γνησακή αρτηρία.

3. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή ενδείκνυται για τη θεραπεία της στένωσης μηρογνησιακών αρτηριών επάνω από το γόνατο σε ενήλικες συμπτωματικούς ασθενείς [κατηγορία Rutherford 2-5]. Η βλάβη υπό θεραπεία, μέγιστου μήκους 14 εκατοστών, πρέπει να είναι φραγμένη ή με στένωση βαθμού υψηλότερου από 50%, de-novo ή επαναστεντική, που δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία με stent.

4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΣΕΙΣ

Η χρήση του stent αντενδέικνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Βλάβες που αξιολογούνται ως μη αντιμετωπίσμενες με PTA ή άλλες επεμβατικές τεχνικές.
- Γυναίκες που είναι έγκυες, θηλάζουν.
- Βλάβες εντοπισμένες στα περιφερικά δύο τρίτα της γνησακής αρτηρίας ή στην άρθρωση του γόνατος.
- Κλινικές καταστάσεις που εμποδίζουν τη χρήση ανταιμοπεταλικής και/ή αντιπηκτικής αγωγής.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η χρήση της συσκευής δεν συνιστάται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία ή αλλεργία στη ραπαμυκίνη, στα λιπαρά οξέα (όπως το στεατικό οξύ, το παλμιτικό οξύ, το βεχενικό οξύ) ή στα μεταλλικά υλικά του stent (όπως το νικέλιο, το τιτάνιο και το ταντάλιο).
- Η συσκευή προορίζεται για μία μόνο χρήση. Να μην επαναχρησιμοποιείται και να μην υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία ή επαναποστερώση. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο μόλυνσης της συσκευής και κίνδυνο λοίμωξης του ασθενή, φλέγμονης και μετάδοσης μολυσματικών νόσων από ασθενή σε ασθενή.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως ενιαία σύστημα. Μην χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα της ξεχωριστά.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν η συσκευασία της έχει ανοιχθεί ή έχει υποστεί ζημιά, αν δεν έχει φυλαχθεί υπό κατάλληλες συνθήκες ή αν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η στειρότητα

του προϊόντος δεν είναι εγγυημένη.

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον από ιατρούς ειδικά εκπαιδευμένους σε επειβάσεις διαδέρμικης διαυλίκης αγγειοπλαστικής (PTA) και διαδικασίες εμφύτευσης stent σε περιφερικά αγγεία.
- Εάν, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, συναντήσετε αντίσταση, μην πέσετε το σύστημα: αποσύρετε το σύστημα του stent και ολόκληρο τον καθετήρα ποτοθέτησης, το οδηγή σύρμα και τον εισαγωγέα ως ενιαίο σύρμα. Αν ασκήσετε υπερβολική δύναμη και/ή χειριστείτε λανθασμένα το σύστημα, μπορεί να εκπυκνθεί κατά λάθος το stent ή να προκληθεί ζημιά στον καθετήρα ποτοθέτησης.
- Σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης, ο λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει διαχωρίση, διάτρηση ή ρήξη του αγγείου.
- Μην προωθείτε ή αποσύρετε το σύστημα stent κατά τη διάρκεια της έκπτυξης: ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα τοιχώματα του αγγείου.
- Η εμφύτευση αυτοδιαιτείνομενου stent περιφερικών αγγείων μπορεί να προκαλέσει διαχωρίση του αγγείου πάω και/ή εγγύη του stent και μπορεί επίσης να προκαλέσει οξεία απόφραξη του αγγείου, καθιστώντας αναγκαία δεύτερη επέμβαση (χειρουργική ποτοθέτηση αγγειακού μοσχεύματος, επαναδιαστολή του αγγείου, έκπτυξη συμπληρωματικών stent ή άλλες διαδικασίες).
- Αφού εκπυκνθεί έστω και μερικώς το stent, δεν μπορεί να ανακτηθεί με το σύστημα ποτοθέτησης.

6. ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

- **Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το σύστημα ταχείας απτελεύθερωσης στην αρχή της διάστασης του stent.** Χρησιμοποιήστε το μόνο εάν είναι απαραίτητο, αφού απτελεύθερωθεί του λουλάκιστον το μισό μήκος του stent.
- Ο χειρισμός της συσκευής πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός, ώστε να αποφεύγεται κάθε επαφή με μεταλλικά ή τραχιά εργαλεία, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή μηχανικές βλάβες.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά πριν από την προετοιμασία και την τοποθέτηση της.
- Το σύστημα ποτοθέτησης της συσκευής δεν προορίζεται για χρήση με εγκυτήρες σκιαγραφικού μέσου.
- Κατά τη διαδοχική εμφύτευση περισσότερων stent, οι αντίστοιχοι ακτινοσκειροί δείκτες πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται. Η αλληλεπικάλυψη δεν πρέπει να ενέχει περισσότερα από δύο stent.
- Σε περίπτωση αλληλεπικάλυψης stent, συνιστάται μήκος αλληλεπικάλυψης μικρότερο από 20 mm.
- Για να μην προκαλέσει ζημιά στο stent, προσέχετε πάρα πολύ όταν περνάτε ένα σύργο σύρμα που έχει καθετήρα με μπαλόνι ή κάποια άλλη συσκευή μέσα από το stent.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI)

Μην κλινικές δοκιμές κατέδεχται ότι οι σειρές του κατασκευαστή του προϊόντος stent Nitinol είναι ασφαλείς σε περιβάλλον MR υπό δρόμου. Ένας ασθενής με αυτή τη συσκευή μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια σε ένα σύστημα MR που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Στατικό μαγνητικό πεδίο 1,5-Tesla (1,5T) ή 3-Tesla (3T)
- Μέγιστρο χωρικό μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο 6,140 G/cm (61,40 T/m)
- Μέγιστρο, αναφρόδιμον από το σύστημα MR, μέστι τημ έιδικου ρυθμού απορρόφησης (SAR) για ολόκληρο το σύρμα
- 1 W/kg (Κανονικός τρόπος λειτουργίας) σε 1,5T
- 1 W/kg (Κανονικός τρόπος λειτουργίας) σε 3T

Θέρμανση RF

Στις συνθήκες σάρωσης που ορίζονται ανωτέρω, οι σειρές του κατασκευαστή του προϊόντος stent Nitinol αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας μικρότερη από 6,8 °C μετά από 15 λεπτά συνεχούς σάρωσης σε αναφρόδιμην από το σύστημα MR, μεστη τημ ειδικού ρυθμού απορρόφησης (SAR) για ολόκληρο το σύρμα 1,0 W/kg.

Διαμόρφωση ενιαίου stent

Μέγιστρη μεταβολή θερμοκρασίας

Διαμόρφωση αλληλεπικάλυψης stent

Μέγιστρη μεταβολή θερμοκρασίας

1,5 T 3 T

≤ 6,3 °C ≤ 6,2 °C

≤ 6,8 °C ≤ 6,3 °C

Τεχνογρύμα MR

Με βάση στοιχεία από μη κλινικές δοκιμές, το τεχνογρύμα της εικόνας που δημιουργείται από τη συσκευή εκτείνεται περίπου 0,7cm από τα stent του κατασκευαστή Nitinol κατά τη σάρωση με πλαμικές ακολουθίες βαθμιδωτής ηχούς ή ιδιοστροφορμής σε σύστημα MRI 3T.

8. ΠΩΣ ΠΑΡΕΧΑΤΑΙ

Η συσκευή NiTIDES παρέχεται αποστειρωμένη (χρησιμοποιώντας ένα μείγμα οξείδιου του αιθανένιου και CO₂), για μία χρήση, περιτύλιγμένη σε δύο σακουλάκια που δεν πρέπει να μεταφερθούν σε στέριο πεδίο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το εσωτερικό σακουλάκι είναι ο μόνος στέριος φραγμός.**

Η αποστείρωση και η χημική σταθερότητα είναι εγγυημένες, εφόσον η συσκευασία παραμένει ακέραια και μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάνω στη συσκευασία (HM/NIA ΛΗΞΗΣ).

Περιεχόμενα: ένα (1) επικαλυμμένο με «Carbofilm™ αυτοδιαιτείνομενο σύστημα stent περιφερικών αγγείων Amphillimus™ (ραπαμυκίν+λιπαρό οξύ)

9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται όπως υποδεικνύεται πάνω στη συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό χώρο, με μέγ. θερμοκρασία φύλαξης 25 °C.

10. ΜΟΝΤΕΛΑ

Η συσκευή NiTIDES αναγνωρίζεται από τον κωδικό μοντέλου και τον αριθμό παρτίδας. Οι κωδικοί των διαθέσιμων προϊόντων αναγράφονται στον Πίνακα 1.

11. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η κλινική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι πρέπει να χορηγείται αντιαιμοπεταλιακή αγωγή πριν από την επέμβαση, αντιτητική αγωγή κατά τη διάρκεια της επέμβασης και αντιαιμοπεταλική αγωγή μετά την επέμβαση.

Η αντιαιμοπεταλική αγωγή μετά την επέμβαση περιλαμβάνει χορηγήση:

- Θειενοπαρδίνων (τικλοπιδίνη ή κλοπιδογρέλη ή πρασουργέλη, στη δοσολογία που υποδεικνύει το φυλλάδιο δογηγών του αντιστοιχού φαρμάκου ή σύμφωνα με τη συνταγή του ιατρού)
- Ασπτίρινης, με ελάχιστη δόση 100 mg/ημέρα δια βίου

Με δεδομένη, ωστόσο, την πολυπλοκότητα της διαδικασίας και τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του ασθενή, η τελική απόφαση για την επιλογή της κατάλληλης αγωγής εναπόκειται στον ιατρό.

12. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κλινικά στοιχεία διαθέσιμα, ορισμένα φάρμακα, όπως το τακρόλιμπος, που δρουν μέσω της ίδιας ζεσμευτικής πρωτεΐνης (FKBP), ενδέχεται να επηρεάζεται την αποτελεσματικότητα της ραταμακίνης. Η ραταμακίνη μεταβολίζεται από το κυτταρόχρωμα CYP3A4. Οι ισχυροί αναστολές του CYP3A4 ενδέχεται να προκαλέσουν αυξημένη έκθεση στη ραταμακίνη, ιδιαίτερα στην περίπτωση πολαπλών εμφυτευμάτων. Η συστημική έκθεση στη ραταμακίνη θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη, εάν ο ασθενής λαμβάνει παράλληλα συστημική ανοσοκαταστατική αγωγή.

13. ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ NITIDES

Το κυριότερα στοιχείο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του stent NiTiDES καθορίστηκαν από την κλινική δοκιμή ILLUMINA, καίριας σημασίας πριν από τη διάθεση στην αγορά.

Σχεδιασμός της μελέτης: Εντός μίας πολυκεντρικής, μονού σκέλους μελέτης, 100 ασθενείς με συμπλωματική μηρολύναντι νόσο με μέγιστη μήκος βλάβης 14cm αντιμετωπίστηκαν με το stent NiTiDES. Η βάσημη αποτελεσματικότητα (βάσημη βατόπτωτα) και το βάσιμο τελικό σημείο ασφάλειας (μία σύνθετη σοβαρών παρενεργειών: θάνατος, ακρωτηριασμός άκρου-στόχου, ισχαίμια άκρου-στόχου που απαιτεί χειρουργική επέμβαση ή χειρουργική επιπλούρωση της βλάβης-στόχου, επιδείνωση της βαθμολογίας Rutherford κατά 2 κατηγορίες, ή στην κατηγορία 5 ή 6) συγκρίθηκαν με έναν Objective Performance Goal (OPG - Στόχος Αντικειμενικής Επιδούσης) για 12 μήνες. Αποτελέσματα: Η επιτυχία της διαδικασίας επιτεύχθηκε κατά 100%.

Τα αποτελέσματα μας τους υπέρτειν Doppler εμφανίζουν βάσιμη βατόπτωτα του 87% (77/89, 95% διαστήματος εμπιστοσύνη 80-94), πληρούν τις απαιτήσεις του OPG (73%). Στους 24 μήνες η βάσημη βατόπτωτα ήταν 81% (63/78).

Στους 12 μήνες το βάσιμο τελικό σημείο ασφάλειας ήταν 96,8% (90/93), πληρώντας τις απαιτήσεις του OPG (98,6%). 2,2% (2/93) των ασθενών υπέστη επέμβαση επαναγγείωσης της βλάβης-στόχου, 1,1% (1/93) απεβίωσε, Ο υπέστη ακρωτηριασμό του άκρου-στόχου. Ο υπέστη ισχαίμια που άκρου-στόχου που να απαιτεί χειρουργική επέμβαση ή χειρουργική επιδιόρθωση του αγγείου-στόχου και Ο υπέστη επιδείνωση της βαθμολογίας Rutherford κατά δύο κατηγορίες, ή στην κατηγορία 5 και 6.

Στους 24 μήνες το τελικό σημείο ασφάλειας ήταν 87,8% (79/90), 6,7% (6/90) των ασθενών υπέστη επέμβαση επαναγγείωσης της βλάβης-στόχου, 3,3% (3/90) απεβίωσε, Ο υπέστη ακρωτηριασμό του άκρου-στόχου, 1,1% (1/90) υπέστη ισχαίμια που άκρου-στόχου που να απαιτεί χειρουργική επέμβαση ή χειρουργική επιδιόρθωση του αγγείου-στόχου και 1,1% (1/90) υπέστη επιδείνωση της βαθμολογίας Rutherford κατά δύο κατηγορίες, ή στην κατηγορία 5 και 6.

14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επιλογή της συσκευής

Ανατρέξτε στο μήκος της βλάβης-στόχου για να προσδιορίσετε το μήκος του απαιτούμενου stent. Για να καλυφθεί όπως αρμόδει η βλάβη, το μήκος έκπτωσής του stent πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm μακρύτερο, από την ίδια τη βλάβη, σε αμφότερες τις πλευρές.

Ανατρέξτε στη διάμετρο του αγγείου εγγύς και άπω της βλάβης για να προσδιορίσετε το κατάλληλο μέγευσθον του stent. Για να εξασφαλίσετε η ασφαλής τοποθέτηση του stent, χρησιμοποιήστε τη μεγαλύτερη διάμετρο ως βάση για την επιλογή του ενδεδειμένου μεγέθους stent. Όταν επιλέγετε το μοντέλο, ανατρέξτε στις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 1.

Προτοιμασία της συσκευής

Πριν ξεκινήστε τη διαδικασία τοποθέτησης του stent, χορηγήστε πηπαρίνη και ελέγχετε τον ενεργοποιημένο χρόνο πήξης (ACT) του ασθενών για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στην επίπεδη που αριθμείται στην επιτέλη σου ορίζουν οι καθιερωμένες διαδικασίες του νοσηλευτικού σας ίδρυμάτος.

Κατά την προτοιμασία του συστήματος, προσέξτε ιδιαίτερα ώστε το stent να μην έρθει σε επαφή με υγρά.

α) Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε το φάκελο που περιέχει το αποστειρωμένο σακουλάκι.

β) Μετά την εξέταση της συσκευασίας για τυχόν ζημιές, ανοίξτε το εξωτερικό μη αποστειρωμένο αλουμινιένιο σακουλάκι και στη συνέχεια αφαιρέστε το περιεχόμενο από το εσωτερικό σακουλάκι. (Σημείωση: Το αλουμινιένιο σακουλάκι και η εξωτερική επιφάνεια του εσωτερικού πλαστικού σακουλού **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ**. Μόνο τα περιεχόμενα του πλαστικού σακουλού είναι ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ).

γ) Αφού τοποθετήστε τη βάση πάνω σε επίπεδη επιφάνεια μέσα σε στείρο πεδίο, λύστε την τανίνη γύρω από τη λαβή και αφαιρέστε τον καθετήρα από το προστατευτικό ελαστήριο.

δ) Βεβαιωθείτε ότι ο καθετήρας τοποθέτησης δεν είναι τσακισμένος ή λυγισμένος σύτερες φέρει καμία άλλη ζημιά. Αν η συσκευή φέρει ζημιές, μπορεί να μην έχει την προβλεπόμενη απόδοση.

ε) Γεμίστε με σύριγγα 3 ml με ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό, συνδέστε τη συνδετική λιγνί για την έκτηση (εικόνα 1, στοιχείο 12) και ασκήστε θετική πίεση. Συνεχίστε την έκτηση μέχρι να εξέλθει ο φυσιολογικός ορός από το άπω άκρο του καθετήρα.

στ) Ελέγχετε το άπω άκρο του καθετήρα, για να βεβαιωθείτε ότι το stent (εικόνα 1, στοιχείο 4) βρίσκεται ολόκληρο μέσα στο εξωτερικό θηκάρι.

Μη χρησιμοποιήστε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά ή αν το stent έχει διαταθεί μερικώς.

Συμβάτηση με βοηθητικά εξαρτήματα

Η συσκευή NiTiDES μπορεί να χρησιμοποιηθεί με θηκάρια εισαγωγής διαμέτρου 6F (2,0 mm) ή μεγαλύτερα.

Οι συσκευές NiTiDES μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σύρματα 0,035 ίντσων (0,89 mm) ή μικρότερα. Ο βαθμός ακαμψίας και η διαμόρφωση του άκρου του διηγού σύρματος πρέπει να επιλέγονται με βάση την κλινική εμπειρία του γιατρού.

Αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί οδηγό καθετήρα, τα συστήματα είναι συμβατά με οδηγούς καθετήρες διαμέτρου 8F (2,7mm) ή μεγαλύτερους. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι είναι αιμοστατική βαλβίδα είναι εντελώς ανοικτή πριν από την εισαγωγή της επιλεγμένης διάταξης.

Εισαγωγή του stent

α) Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ασφαλείας (εικόνα 1, στοιχείο 10) στη λαβή βρίσκεται στην κλειδωμένη θέση (λεπτομέρεια B).

β) Ξεπλύνετε το εκτεθειμένο τμήμα του οδηγού σύρματος με ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό, για να απομακρύνετε τα υπολείμματα αίματος και σκιαγραφικού.

γ) Προώθηστε αργά το σύστημα πάνω από το οδηγό σύρμα μέχρι να φτάσει το stent στην περιοχή της βλάβης.

Εάν, σε σποιοδήρτηση σημείο, συναντήστε ασυνήθιστη αντίσταση, μην πιέσετε το σύστημα: αποσύρετε μαζί την εισαγωγή, το οδηγό σύρμα και τη συσκευή ως ενιαίο σώμα. Αν ασκήστε υπερβολική δύναμη και/ή χειριστείτε λανθασμένα το σύστημα, μπορεί να εκπυγηθεί κατά λάθος το stent ή να προκληθεί ζημιά στην καθετήρα τοποθέτησης.

Προώθηση της συσκευής

α) Προώθηστε το σύστημα μέχρι να φτάσει το stent πέραν της βλάβης.

β) Αποσύρετε το σύστημα προς τα πίσω μέχρι να ευθυγραμμιστεί το stent με τη βλάβη.

γ) Βεβαιωθείτε ότι το τμήμα του συστήματος τοποθέτησης που βρίσκεται έξω από το σώμα του ασθενή έχει εκπυγηθεί ελεύθερα και είναι ευθύγραμμο.

Προσοχή: αν το σύστημα τοποθέτησης δεν έχει εκπυγηθεί σωστά, το stent μπορεί να απτελευθερωθεί πέρα από την περιοχή της βλάβης.

Εμφύτευση και διάταση του stent

α) Συγκρατήστε γερά τη λαβή με το ένα χέρι και ελέγχετε τους ακτινοσκειρούς δείκτες πάνω στο stent για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται εγγύς και άπω της βλάβης.

β) Βεβαιωθείτε ότι το θηκάρι εισαγωγής δεν μετακινείται κατά την απελευθέρωση του stent.

γ) Γύριστε το κλειδί ασφαλείας πάνω στη λαβή αριστερόστροφα (εικόνα 1, λεπτομέρεια B) για να το ζεκτείνωσετε (BHMA 1), στη συνέχεια το αφαιρείτε τελείως (BHMA 2).

δ) Κρατώντας τη λαβή στη σταθερή θέση ως προς τον ασθενή, ελέγχετε έξαντας ακτινοσκειρούς δείκτες για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται στην επιθυμητή θέση ως προς τη βλάβη. Σεκινήστε την έκπτηση του stent γυρώντας το ροδάκι (εικόνα 1, στοιχείο 9) με τον αντίχειρα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

ε) Υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, μόλις προσκολληθεί καλά το άπω άκρο του stent στο τοιχώματα του αγγείου, συνεχίστε την έκπτηση του stent γυρώντας το ροδάκι πάνω στον αγγείο πάνω στην επίπεδη πλάτη της συσκευής (απόστρωση, εικόνα 1, στοιχείο 11) με το άλλα σας χέρι και πραγμάτευτε την κρατώντας το μπροστινό μέρος της λαβής απολύτως ακίνητο ως προς τον ασθενή, άπως φαίνεται στην εικόνα 1.

ζ) Βεβαιωθείτε ακτινοσκοπικά ότι το stent έχει διαταθεί πλήρως.

η) Μπορείτε να διατελέστε περισσότερο το stent, αν χρειάζεται, χρησιμοποιώντας καθετήρα PTA με μπαλόνι. Κατά την επιλογή της διάμετρο του καθετήρα με μπαλόνι και κατά τη διενέργεια της εκ των υστέρων διάτασης, ανατρέξτε στη διάμετρο του αγγείου που έχει εκπυγηθεί αγγειογραφικά. Σε κάθε περίπτωση, προσέξτε ιδιαίτερα να διατελέστε το stent πέρα από την ονομαστική του διάμετρο, που δηλώνεται στην ετικέτα.

θ) Η τελική διάμετρο του stent πρέπει να είναι κατάλληλη για τη διάμετρο του αγγείου αναφοράς.

15. ΠΙΘΑΝΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Τα δυνητικά ανεπιθύμητα συμβάντα που ενδέχεται να σχετίζονται με την εμφύτευση stent περιφερικών αγγείων περιλαμβάνουν κινδύνους που σχετίζονται με επεμβάσεις διαδεμέρησης διαυλικής αγγειοπλαστικής και άλλους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση stent, άπως των αναφέρονται παρακάτω.

- Λοιμώδη θέσης προσθέτων, άλγος και αιμάτωμα
- Αλλεργική ή ανεπιθύμητη αντίδραση στο οσιαγραφικό μέσο, στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία ή στα υλικά κατασκευής του stent
- Αρτηριακής οπαστάσης
- Αρτηριακή θρόμβωση ή του stent
- Ανεύρυσμα ή ψευδοσανεύρυσμα μηριαίας αρτηρίας
- Αθηροσκληρωτική περιφερική εμβολή
- Αιμορραγία
- Θάνατος
- Διαχωρισμός, διάτρηση ή ρήξη του αγγείου που φέρει το stent
- Εμβολή
- Νεφρική ανεπάρκεια
- Ισχαιμία κάτω άκρου στον που απαιτεί χειρουργική επέμβαση
- Επαναστένωση της αρτηρίας όπου εμφυτεύθηκε το stent
- Εμβολή του stent
- Απόφραξη αγγείου ή ανεπιλύτη στένωση

tikanılığa yol açıp ek bir ameliyat gerektirebilir (cerrahi vasküler replasman ameliyatı, daha ileri dilatasyon, ek stentlerin yerine yerleştirilmesi veya başka işlemler).

- Stent kısmen yerine yerleştirildikten sonra iletme sistemiyle geri alınamaz.

6. ÖNLEMLER

- Hızlı serbest bırakma sistemini asla stent genişlemesinin başlangıcında **kullanmayın**. Bunu **ancak gerekirse**, stent uzunluğunun en az **yarısını** serbest bırakıktan sonra kullanın.
- Cihaza zarar verebilecek veya mekanik değişikliklere yol açabilecek şekilde metalik veya abraziv aletlerle teması önlemek için cihaz dikkatli kullanılmalıdır.
- Cihaz hazırlık ve konumlandırma öncesiinde sivilarda temas etmemelidir.
- Cihaz yerleştirme sisteminin kontrast madde enjektörleriyle kullanılması amaçlanmamıştır.
- Stentler arkaya implante edildiğinde ilgili radyoopak işaretler örtüsmelidir. Örtüşmede iki stentten daha fazlası yer almamalıdır.
- Örtüşen stentlerin olması halinde, en az 20 mm örtüşme uzunluğu önerilir.
- Stente zarar vermekten kaçınmak için kılavuz tel veya balon katerineleri veya farklı bir cihazı yerleştirmiş bir stent içinden geçirirken çok dikkatli olun.

7. MRI GÜVENLİK BİLGİLERİ

Klinik olmayan testler, üreticinin Nitinol stent ürün yelpazesinin MR Koşullu olduğunu göstermiştir. Bu cihazı kullanan bir hasta, aşağıdaki koşulları sağlayan bir MR sistemine güvenle bağlanabilir:

- 1.5-Tesla (1,5T) veya 3-Tesla (3T) statik manyetik alan
- Maksimum 6.140 G/cm (61,40 T/m) mekanikal alan gradyeni
- Raporlanan maksimum MR sistemi, tüm vücut ortalama spesifik soğurma oranı SAR:
 - 1 W/kg (Normal Çalıştırma Modu), 1,5T
 - 1 W/kg (Normal Çalıştırma Modu), 3T

RF Isıtma

Yukarıda tanımlı tarama koşullarında, üreticinin Nitinol stent ürün yelpazesinin tüm vücut ortalama spesifik soğurma oranı (SAR) 1,0 W/kg olduğu bildirilen MR sisteminde 15 dakikalık sürekli tarama sonrasında 6,8 °C'den daha az bir maksimum sıcaklık artışı üretemesi beklenir.

	1,5 T	3 T
Tekli Stent Konfigürasyonu En yüksek sıcaklık değişimi	≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
Örtüşen Stent Konfigürasyonu En yüksek sıcaklık değişimi	≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C

MR Artefakt

Klinik olmayan bir teste, 3 T MRI sisteminde gradyen eko ve spin eko nabız sırası ile görüntülenliğinde cihazın sebebi olduğu görüntü artefaktı üreticinin Nitinol stentlerinden yaklaşık 0,7 cm uzanır.

8. SAĞLANMA SEKLİ

NiTIDES cihazı, tek kullanım için steril olarak (etilen oksit ve CO₂ karışımı kulanılarak) ve steril alanında getirilmemesi gereken iki poşette paketlenmiş şekilde sağlanır. **NOT: İÇ POŞET TEK STERİL BARIYERİRDİR.**

Paket sağlam kaldığı sürece ve ambalajda basılı son kullanma tarihine kadar (SON KULLANIM TARİHİ) sterilliği ve kimyasal stabilitesi garanti edilir.

İçindekiler: bir (1) eCarbofilm™ kaplı kendiliğinden genişleyen Amphilimus™ (Sirolimus+yağ asidi) salgılanan periferal stent sistemi

9. SAKLAMA

Ürün, ambalajda belirtildiği şekilde ambalajı içinde serin ve kuru bir yerde maksimum 25 °C depolama sıcaklığında saklanmalıdır.

10. MODELLER

NiTIDES cihazı bir model kodu ve parti numarasıyla tanımlanır; mevcut ürün kodları Tablo 1'de verilmiştir.

11. İLAC REJİMİ

Klinik literatürdeki çalışmalar preoperatif antitrombotik tedavi, işlem sırasında antikoagulan tedavi ve postoperatif antitrombotik tedavi uygulanması gerektiğine işaret etmektedir.

İşlem sonrasında dönemde antitrombotik tedavi şunların uygulanmasını gerektirir:

- Tienopiridinler (tibbi reçeteye göre veya ilgili prospektüslerde belirtilen dozlarda Ticlopidin veya Clopidogrel veya Prasugrel)
- Minimum 100 mg/gün dozunda süresiz aspirin

İşlemenin karmaşıklığı ve hastanın durumunu etkileyen birçok faktör dikkate alındığında uygun tedavinin seçilmesi doktorun takdirine bırakılır.

12. İLAÇLARLA ETKİLEŞİM

Spesifik klinik veriler bulunmamasına rağmen Takrolimus gibi aynı bağlayıcı protein (FKBP) yoluyla etki eden bazı ilaçlar Sirolimus etkinliğini olumsuz etkileyebilir. Sirolimus, CYP3A4 tarafından metabolize edilir. Kuvvetli CYP3A4 inhibitörleri özellikle çoklu implantlar durumunda Sirolimus'a daha çok maruz kalmaya neden olabilir. Hastalar eszamanlı sistemik immünsupresif ilaçlar alırsa da Sirolimus'a sistemik maruz kalma dikkate alınmalıdır.

13. NITIDES İLE YAPILAN KLINİK ÇALIŞMALAR

NiTIDES stentinin prensip olarak güvenliği ve etkinliği, pazar öncesi eksensel klinik çalışma ILLUMINA'dan elde edilmiştir.

Çalışmanın tasarıması: Çok merkezli ve tek kollu çalışmada, semptomatik femoropopliteal hastalığı ve maksimum 14 cm lezyon uzunluğu olan 100 hasta, NiTiDES stent ile tedavi edilmiştir. Birinci etkinlik (birincil etkinlik) ve birinci güvenlik bitiş noktası (büyük yan etkilerin kombinasyonu: ölüm, hedef uzuv amputasyonu, cerrahi müdahale veya hedef damarın cerrahi olarak onarılması gerektiren hedef uzuv iskemi veya klinik olarak yapılan hedef lezyon revaskülarizasyon,

Rutherford puanının 2 sınıf kötüleşmesi veya 5 veya 6 sınıfına gelmesi), 12 ay boyunca Nesil Performans Hedefine (OPG) göre karşılaştırılmıştır. Sonuçlar: İşlemenin başarısı %100 olarak sağlanmıştır.

Doppler ultrason sonuçları, %87 düzeyinde (77/89, %95 güven aralığı 80-94) birincil etkinlik ortaya koymustur, bu da OPG gereksinimlerini karşılamaktadır (%73, 24 aylık birincil etkinlik %81 idi (63/78).

12 aylık birincil güvenlik bitiş noktası %96,8'dir (90/93) ve bu da OPG gereksinimlerini karşılamaktadır (%19,6). Hastaların %2,2'sinde (2/93) klinik olarak hedef lezyon revaskülarizasyon görüldü, %1,1'i (1/93) oldu, 0 kişide hedef uzuv amputasyonu oldu. 0 kişide cerrahi müdahale veya hedef damarın cerrahi olarak onarılması gerektiren hedef uzuv iskemi yaşandı ve 0 kişide Rutherford puanının iki sınıf kötüleşmesi veya 5 veya 6 sınıfına gelmesi yaşandı.

24 aylık birincil güvenlik bitiş noktası %87,8 (79/90) idi. Hastaların %6,7'sinde (6/90) klinik olarak hedef lezyon revaskülarizasyon görüldü, %3,3'ü (3/90) oldu, 0 kişide uzuv amputasyonu oldu, %1,1'i (1/90) cerrahi müdahale veya hedef damarın cerrahi olarak onarılması gerektiren hedef uzuv iskemi yaşandı ve %1,1'inde (1/90) kişide Rutherford puanının iki sınıf kötüleşmesi veya 5 veya 6 sınıfına gelmesi yaşandı.

14. KULLANMA TALİMATI

Cihazın seçilmesi

Gerekli stent uzunluğunun belirlemek üzere hedef lezyon uzunluğuna bakın. Lezyon doğru bir şekilde kaplamak için yerleştirilen stent uzunluğu her iki tarafa lezyondan en az 5 mm daha uzun olmalıdır.

Uygun stent boyutunu belirlemek için lezyonun proksimal ve distalindeki damarın capına bakın. Stentin güvenli bir şekilde yerleşmesini temin etmek için uygun stent boyutunu seçmek için daha büyük bir çap kullanın. Modeli seçerken tablo 1'de verilen bilgiyi bakın.

Cihazın hazırlanması

Stent iletmeye önce heparin uygulayın ve hastanın Aktive Pihtılaşma Süresinin (ACT) Merkezin uygulamasıyla uyumlu olarak yeterli olduğunu kontrol edin.

Sistemin hazırlanmasında **stente sıvı temas etmesine izin vermeme** özellikle dikkat edin.

- Kutuyu açın ve steril poşeti içeren tutbayı dışarı çıkarın.
- Paketle herhangi bir hasar olup olmadığından incelemek için dış kışımındaki steril olmayan alüminyum folyo poşeti açın, ardından iç poşetteki malzemeleri çıkarın. (Not: Alüminyum folyo poşet ve iç plastik poşetin dış yüzeyi **STERİL DEĞİLDİR**). Yalnızca plastik poşetin içeriği **STERİLDİR**).
- Desteği steril bir bölgede düz bir yüzey üzerine koymaya dikkat ederek sap etrafındaki bandı gevşetin ve kateteri koruyucu sarmaladan çıkarın.
- İletme kateterinden herhangi bir bırakılm, eğilme veya başka hasar bulunmadığını kontrol edin. Cihazın hasar görmesi performansını etkileyebilir.
- 3 ml sıringayı heparin içeren fizyolojik solüsyonla doldurun, sıvi geçirme luer bağlantısına (şekil 1, öge 12) takın ve pozitif basınç uygulayın. Fizyolojik solüsyon kateterin distal ucundan içinkine kadar sıvi geçmeye devam ederek sıvi geçirme işlemini tekrarlayın.
- Kateterin distal ucunu inceleyip stentin (şekil 1, öge 4) tamamen dış kılıfı kaplı olduğunu emin olun.

Stent kısmen genişlemiş veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse cihazı kullanmayın.

Aksesuarlarla uyumluluk

Çapı 6F (2,0 mm) veya üstünde olan introducer kılıflar NiTiDES cihazla birlikte kullanılabılır.

0,035 inç (0,89 mm) veya daha kısa kılavuz teller NiTiDES cihazlarla birlikte kullanılabılır. Doktorlar kılavuz tel seriliği ve uç konfigürasyonunu klinik deneyimlerine dayanarak seçerler.

Bir kılavuz kateter kullanmak gereklisi sistemler çapı 8F (2,7 mm) veya üstünde olan kılavuz kateterlerle uyumlidır. Bu durumda seçilen tertiibi yerleştirmeden önce hemostatik valfin tamamen açık olduğundan emin olun.

Stent insersiyonu

- Sap üzerindeki güvenlik anahtarının (şekil 1, öge 10) kiliti pozisyonda olduğundan emin olun (ayırtı B).
- Kılavuz telli maruz kalın kısmını kan ve kontrast madde izlerini gidermek üzere heparin içeren bir fizyolojik solüsyonu yıkayın.

- Sistemi kılavuz telli üzerinden stentin distal bölgesinde erişinceye kadar ilerletin. Herhangi bir zamanda olasıdırı dirençle karşılaşılırsa sistemi zorlamayın: introduseri, kılavuz telli ve cihazı tek bir unite olarak birlikte geri çekin. Aşırı güç uygulanması ve/veya hatası kullanım stentin yanılıklarla yerleştirmesine veya yerleştirme kateterinin zarar görmesine neden olabilir.

Cihazı ilerletme

- Sistemi, stentin lezyonun ötesinde olduğu bir noktaya kadar ilerletin.
- Sistemi, stent lezyon ile hizalanıncaya kadar geri çekin.

- Hasta vücutu dışındaki stentin tamamen büüklememiş ve düz olduğundan emin olun.

Dikkat: İletme sistemi uygun şekilde büüklememiş durumda değilse stent hedef lezyonun ötesinde yerine yerleştirelibilir.

Stent implantasyonu ve genişletme

- Sapi bir elle sıkıca tutarken stent üzerindeki radyoopak işaretlerin lezyona göre proksimal ve distalde konumlandığından emin olun.

- Introduser kılıfın stentin yerine yerleştirmesini sırasında hareket etmediğinden emin olun.

- Sap üzerindeki güvenlik anahtarını kilitli açmak için (1. ADIM) ok yönünden tersine (şekil 1, ayırtı B) çevirin ve sonra tamamen dışarı çekin (2. ADIM).

- Sapi hastaya göre sabit bir pozisyonda tutarken radyoopak işaretlerin lezyona göre istenilen konumda olduğunu tekrar kontrol edin; tekeri (şekil 1, öge 9) başparmağınzla şekil 1'de gösterildiği gibi ok yönünde çevirerek stenti yerine yerleştirmeye başlayın.

- Floroşkopı altında, stentin distal ucu duvarlarını iyice tutunduğunda

yerine yerleştirmeye tekeri stent ucu açılıncaya ve tamamen damar duvarları içine implanté edilinceye kadar devam edin.

- f) Hizi yerine yerleştirme gerekliliye, şöyle ilerleyin: sapın arkası ucunda bir tikanıklık (ör. dişsi luer bağıntısının vidalaması) olmadığında emin olun, cihazın arkası ucunu (geri çekme, şekil 1, öge 11) diğer elinizin tutun ve sapın ön kısmını hastaya göre şekil 1'de gösterildiği gibi tamamen hareketsiz tutarak çekin.
g) Floraskopik olarak stentin tamamen açıldığını kontrol edin.
h) Gerekirse stent bir PTA balon kateter kullanılarak daha fazla genişletilebilir. Balon kateter çapını sezerken ve post genişletmeyi yaparken lütfen angiografi yoluyla değerlendirilmiş damar çapına bakın. Her durumda, stenti etikette yazılan belirlenmiş nominal çapın ötesine genişletmemeye özellikle dikkat edin.
i) Stentin son çapı referans damar çapıyla uyumlu olmalıdır.

15.İSTENMEYEN ETKİLER

Bir periferal stentin implantasyonuyla ilişkili olabilecek olası advers olaylar perkutan transluminal angioplasti ile ilişkili riskler ve aşağıda belirtildiği gibi stent kullanımıyla ilişkili ek riskleri içerir.

- Erişim bölgesi enfeksiyonu, ağrı ve hematom
- Kontrast maddeyle, işlenen sırasında kullanılan ilaçlara veya stentin oluşturduğu materyallere karşı alerjik veya advers reaksiyon
- Arteriyel spazm
- Arteriyal veya stent tromboz
- Femoral arter anevrizması veya psödoanevrizması
- Aterosklerotik distal embolizasyon
- Kanama
- Ölüm
- Stentlenen damarın diseksiyonu, perforasyonu veya rüptürü
- Emboli
- Böbrek yetmezliği
- Alt uzuv iskemisi (cerrahi müdahale gerektiren)
- Stent implant edildiği artrde restenoz
- Stent embolizasyonu
- Damar oklüzyonu veya çözülmemiş daralma

16.YÜKÜMLÜLÜK VE GARANTİ

Üretici, önceki paragraflarda belirtilen önləmlere uyulduğunda ve kullanım koşullarına ve kullanım amacına uyulduğunda güvenli kullanımı temin etmek amacıyla ve her halükarda cihazın kullanımını ile ilgili riskleri tamamen ortadan kaldırılmıştır da münkün olduğu kadar azaltılmıştır. Cihazın mevcut teknolojik durumua göre kullanılabilir olan en uygun teknikleri kullanarak ve tasarımları ve üretimi konusunda sağılmıştı prensiplerini uygulayarak gerekli özenle cihazın tasarılandığı, üretiltiğini ve paketlendirdiğini temin etmektedir.

Bu cihaz, yalnızca uzman tip personelinin sorumluluğunda, altında ve tedavinin rezidül riskleri ve olsayı etkileri ve komplikasyonları dikkate alınarak (bu talimat kitapçığının diğer bölümünde belirtilenler dahil olsak üzere) kullanılmalıdır. Tibbi tercihlerin ve cihazın uygulama yöntemlerinin teknik karmaşaklılığı ve kritik yapısı, Üreticinin cihazın kullanımını takiben sonuçların etkinliği konusunda veya engellilik durumunu gözleme etkinliği hakkında veya dişer patoloji veya tibbi sorunlarda ister açık ister zimni tüm garantilerini hariç tutmaktadır. Bunuluna birlikte, klinik bakış açısından göre ve cihazın işlevselligi ve süresi açısından, sonuçlar üreticinin kontrolünden aşan birden fazla faktöre bağlıdır, ki bunlara örnek olarak çok az atıfta bulunan ve kapasityi olmayan hasta hastaları, implantasyon veya kullanımı cerrahi prosedür, ambalaj açıldıktan sonra cihazın kullanım yöntemleri olarak sıralanabilir.

Bu etmenlere göre, üreticinin yükümlülüğü yalnızca cihazın kullanımına sunulduğu zamanki kusurlardan etkilenildiğinden emin olunması halinde vardır. Bu amaçla, Müşteri son kullanım koşullarına ve yasaların zaman aşımı hükümlerine uygun olarak cihazı derhal Üreticinin kullanımına sunulmalıdır; Üretici arızalı olduğu düşünülen cihazı inceleme ve ürünün güvenliğini etkileyebilecek kusurlardan gerçekteki etkilenme etkilenmedirini belirlemeye hakkını saklı tutmaktadır. Şu durumlarda üreticinin yükümlülüğü yoktur: (i) İddia edilen kusurun cihazın zorunlu bir kural veya bağlayıcı bir hükmeye nedeniyle ortaya çıkması ve / veya (ii) Üreticinin cihazı testim ettiğinde hasara sebep olan kusurun mevcut olmaması ve / veya (iii) Üreticinin cihazı testim ettiği zamanda teknik ve bilimsel bilginin cihazın kusuruna olarak kabul edilmesine hennet olanaç verecek seviyede olmaması ve / veya (iv) yukarıda belirtilenlerden farklı olarak diğer durumlarında ise yasaların Üreticinin hasarı veya kusuru ürünler için sorumluluğunu hariç tutması veya sınırlaması. Bu garanti sadece kusurlu cihazın üretici tarafından üretilen aynı veya benzer tipte bir başkasıyla değiştirmesini kapsar.

Bu garanti sadece cihaz üreticisi iddia edilen kusurların ayrıntılı bir yazılı raporuya birlikte ve implanté edilmiş bir cihaz durumunda hastadan çıkarılmasının nedeniyle birlikte doğru bir şekilde gönderilmesi durumunda geçerli olacaktır. İddia edilen kusurlar, hakkın kaybedilmesi ve yasal zaman aşımı hükümlerine uygun olarak derhal Üreticiliye bildirilmelidir.

Degisikliklerin gerçekleştiğinde, Üretici kabul edilen arızalı cihazın iadesi nedeniyle Müşterinin maruz kaldığı maaşları geri ödeyecektir.

Üretici, kullanım yöntemlerine ve bu kullanım talimatlarında belirtilen önləmlere uyulmaması sebebiyle veya ambalaj üzerinde yazan son kullanım tarihinden sonraki kullanımın nedeniyle ortaya çıkan tüm sorumlulukları reddetmektedir. Ayrıca Üreticinin cihazın tibbi tercih ve kullanım yöntemleri veya uygulama yöntemleri nedeniyle ortaya çıkan sonuçlarla bağlantılı hiçbir sorumluluk kabul etmez; bu nedenle operatörün kullandığı implantasyon tekniği veya cihaz uygulaması sonucunda oluşan herhangi bir maddi, biyolojik veya etik bir hasar için hiçbir şart altında sorumlu olmayacağıdır.

Üreticinin bayi ve temsilcilerinin yukarıda bahsi geçen koşulları değiştirmeye veya yukarıda belirtilenler dışında el taahhütlerde bulunulma veya ilgili herhangi bir ek garanti verme yetkileri yoktur. Bu garanti, Üreticinin ürünü Italya dışında bir veya daha fazla ülkede piyasaya sunma yetkisi varsa farklı bir devletin zorunlu yasaları geçerli olmadıkça Italyan yasalarına tabidir.

ČESKY

NITIDES

Systém samorozažitelného periferálního stentu potaženého materiélem „Carbofilm™ s elucí líku Amphiliimus™ (Sirolimus + mastné kyseliny)

1. POPIS ZAŘÍZENÍ

Ráda zařízení NiTiDES je tvořena samorozažitelným stentem a zaváděcím systémem pro jeho správné vložení a rozvinutí.

Stent je ohebné, samorozažitelné implantabilní zařízení. Je vyroben ze slitiny niklu a titánu (Nitinol) a potažen materiélem „Carbofilm™, což je tenká vrstva uhlíku s vysokodenitnou turbostratickou strukturou, která je v podstatě identická se strukturou pyrolytického uhlíku.

Potažení dodává substrátu biokompatibilní a hemokompatibilní vlastnosti pyrolytického uhlíku bez ovlivnění fyzikálních a strukturálních vlastností samotného substrátu.

Na stentu je umístěno šest rentgenkontrastních tantalových značek (na každém konci tří), které umožňují správné umístění v místě cílové léze.

Vnější povrch stentu má dedikované drážky zcela potažené materiélem „Carbofilm™ pro farmaceutický preparát Amphiliimus™, který je tvořen lékem Sirolimus a směsi mastných kyselin s dlouhými řetězci.

Specifické dávkování léku pro povrch ošetřované cévy je přibližně 0,9 µg/mm², což odpovídá minimální dávce 270 µg na menším stentu (6,0 x 20 mm) a maximální dávce 2420 µg na větším stentu (8,0 x 150 mm).

Zaváděcí systém je typu over-the-wire (přes vodicí drát) a zajišťuje možnost bezpečného zavedení a uvolnění stentu v místě léze. Schematicky je znázorněn na obr. 1 a skládá se z následujících součástí:

- tělo katétru (7) o průměru 6F, tvořené:
 - statízelné vnější pouzdro, jehož distální polopruhledná část (3) obsahuje stent (4); pouzdro má rentgenkontrastní prstenec (13) blízko hrotu katétru;
 - vnitřní lumen tvorého cívku (6) a vnitřní trubici (2) kompatibilní s 0,035in vodicím drátem; vnitřní lumen sahá po délce katétru od konektoru Luer (12), který je připevněn proximálně k rukojeti, a konci distálně u hrotu stentu (1) z rentgenkontrastního materiálu, což napomáhá zavedení a umístění stentu při prolížení na zobrazovacím systému. Zarážka (5) integrovaná do vnitřního lumenu brání axiálnímu posunu stentu během stahování vnějšího pouzdra;
 - rukojet (8) se zaváděcím systémem, který umožňuje umístění katétru a rozvinutí stentu na místě.
- Rukojet má ergonomickou konstrukci, která obsluze umožňuje uchopení a používání, a to i jednou rukou. Na proximální konci má port s konektorem Luer (12), který se používá k propojení lumenu s vodicím drátem, pojistný klin (10), kolečko (9) a vytahovací konec (11).

Výrobce je přímým výrobcem systému periferálního stentu a zaváděcího katétru; jak při výrobě, tak u konečných výrobků má zavedeny všechny postupy fízení jakosti v souladu se zásadami správné výrobní praxe.

2. ÚCEL POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Systém samorozažitelného periferálního stentu je určen k léčbě onemocnění periferických tepen, které ovlivňuje stěnní tepnu a proximální podkolenní tepnu.

3. INDIKACE ZAŘÍZENÍ

Zařízení je indikováno k léčbě stenozy femoropopliteálních tepen nad kolennem u dospělých symptomatických pacientů [kategorie 2-5 podle Rutherforda]. Ošetřovaná léze o maximální délce 14 centimetrů musí mít buď uzávér, nebo stenozu vyšší než 50 %, novou nebo restenotickou, která nebyla dříve ošetřena stentem.

4. KONTRAINDIKACE

Použití tohoto stentu je kontraindikováno v následujících situacích:

- Léze, které jsou považovány za neléčitelné pomocí PTA nebo jiných intervenciálních technik.
- Těhotná a kojící ženy.
- Léze umístěné v distálních dvou třetinách arteria poplitea nebo u kolenního kloubu.
- Klinické podmínky, které brání použití protideštíkové a/nebo antikoagulační léčby.

5. VAROVÁNÍ

• Použití tohoto zařízení se nedoporučuje u pacientů se známou hypersenzitivitou nebo alergií na Sirolimus, mastné kyseliny (například kyselinu stearovou, kyselinu palmitovou, kyselinu behenovou) nebo Kovové součásti stentu (jako jsou nikl, titan a tantal).

• Toto zařízení je určeno pouze k jednomu použití. Nepoužívejte opakováně, opakováně neprípravujte ani opakováně nesterilizujte. Mohlo by vzniknout riziko kontaminace zařízení a/nebo infekcí pacienta, zánětu a přenosu infekčních chorob z pacienta na pacienta.

• Zařízení je navrženo tak, aby fungovalo jako systém. Nepoužívejte jeho součásti samostatně.

• Nepoužívejte zařízení, pokud došlo k otevření nebo poškození obalu, zařízení nebo správně skladování nebo nebylo překročeno uvedené datum použitelnosti. V takových případech není zaručena sterilita výrobku.

• Zařízení smí používat pouze lékaři s odpovídající kvalifikací pro provádění perkutánní transluminální angioplastiky (PTA) a implantační periferálního stentu.

• Pokud se kdykoli během zákrusu setkáte s odporem, nevyvijete na systém neprímeněno silu, vytáhněte systém stentu, celý zaváděcí katétr, vodicí drát a zaváděcí pouzdro jako jeden celek. Při použití nadměrné sily a/nebo nesprávném zacházení se může stent neplánovaně roztáhnout nebo se může poškodit zaváděcí katétr.

• Nesprávné zacházení může kdykoli během operace způsobit disekci, perforaci nebo rupturu cévy.

- Během rozvinování neposunujte ani nevyloučte systém stentu; mohlo by vážně poškodit steny cévy.
- Implantace samoroztažitelného periferního stentu může způsobit disekci cévy distální a/nebo proximální od stentu a může rovněž způsobit akutní uzávěr cévy, který se výzaduje další operaci (chirurgickou nahradu cévy, další dilataci, zavedení dalších stentů nebo jiné zároky).
- Obnovení původního stavu částečně rozvinutého stentu pomocí zaváděcího systému není možné.

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Na začátku rozvinutí stentu **nikdy nepoužívejte** systém rychlého uvolnění. Používejte ho **pouze v případě potřeby** po rozvinutí alespoň **poloviny délky** stentu.
- Se zařízením se musí zacházet opatrně, aby se nedostalo do kontaktu s kovovými nebo abrazičními nástroji, které by ho mohly poškodit nebo způsobit mechanické změny.
- Zařízení před průpravou a umístěním nesmí dostat do styku s tektinami.
- Zaváděcí systém zařízení není určen k použití s injektovy kontrastní látky.
- Při tandemové implantaci stentů by se mely příslušné rentgenkontrastní značky překryvat. Překrytí by nemělo zahrnovat více než dva stenty.
- V případě překryvajících se stentů se doporučuje překrytí o délce menší než 20 mm.
- Při protahování vodicího drátu, balónkového katétru nebo jiného zařízení rozvinutým stentem budete krajně opatrní, aby nedošlo k poškození stentu.

7. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O MRI

Neklinické zkoušky prokázaly, že výrobkové řady stentů ze slitiny Nitinol od tohoto výrobce jsou za stanovených podmínek bezpečné v prostředí MR. Pacienta s tímto zařízením lze bezpečně vyšetřovat v systému MR za následujících podmínek:

- Statické magnetické pole s indukcí 1,5 tesla (1,5 T) nebo 3 tesla (3 T)
- Maximální prostorový gradient magnetického pole 6 140 G/cm (61,40 T/m)
- Maximální průměrná specifická míra absorpcie (SAR) celého těla hlášená systémem MR:

- 1 W/kg (normální pracovní režim) při 1,5 T
- 1 W/kg (normální pracovní režim) při 3 T

VF zahřívání

Za níže definovaných podmínek snímkování se předpokládá, že výrobkové řady stentů ze slitiny Nitinol od tohoto výrobce způsobí maximální nárůst teploty méně než 6,8 °C po 15 minutách nepřetržitého snímkování při průměrné specifické míře absorpcie (SAR) celého těla hlášené systémem MR 1,0 W/kg.

1,5 T 3 T

Konfigurace s jediným stentem	
Nejvyšší změna teploty	≤ 6,3 °C ≤ 6,2 °C
Konfigurace s překryvajícími se stenty	
Nejvyšší změna teploty	≤ 6,8 °C ≤ 6,3 °C

Artefakty MR

Při snímkování systémem MRI s indukcí 3 T metodou pulzních sekvencí s gradientovým echem a spinovým echem během neklinických zkoušek překrývají velikost artefaktů způsobených stenty ze slitiny Nitinol od tohoto výrobce přibližně 0,7 cm.

8. ZPŮSOB DODÁVKY

Zařízení NiTiDES je určeno k jednomu použití: dodává se sterilizované (směsí etylénoxidu a CO₂) a balené ve dvou sáčcích, které se nesmí pokládat do sterilního pole. **POZNÁMKA: vnitřní sáček je jediná sterilní bariéra.**

Sterilita a chemická stabilita jsou zaručeny při neporušeném obalu do data použitelnosti uvedeného na obalu (POUŽIJTE DO).

Obsah: jeden (1) systém samoroztažitelného periferního stentu potaženého materiálem „Carbofilm™“ s elucí léku Amphilius™ (Sirolimus + mastné kyseliny)

9. SKLADOVÁNÍ

Výrobek by se měl skladovat podle pokynů na obalu na chladném a suchém místě při skladovací teplotě max. 25 °C.

10. MODELY

Zařízení NiTiDES je identifikováno kódem modelu a číslem šarže; kód dostupných výrobků jsou uvedené v tabulce 1.

11. REŽIM PODÁVÁNÍ LÉKŮ

Podle studií uvedených v lákařské literatuře je nutno před operací podávat protidištěckou léčbu, během zákraku antikoagulační léčbu a po operaci protidištěckou léčbu.

Protidištěckou léčbu v době po zákroku zahrnuje podávání následujících léků:

- Thienopyridiny (ticlopidin, clopidogrel nebo prasugrel v dávkách uvedených v příslušných návodech k použití nebo podle lákařského předpisu)
- Aspirin v minimálním množství 100 mg/den po neurčitou dobu

Vzhledem ke složitosti postupu a mnoha faktorům, které mají vliv na stav pacienta, je výběr odpovídající léčby ponechán na rozhotovnutí lékaře.

12. INTERAKCE S LÉKY

I když nejsou k dispozici žádné konkretní klinické údaje, některé léky jako Tacrolimus, které poskytuje prostřednictvím stejné vazebné bilkoviny (FKBP), mohou snižovat účinnost léku Sirolimus. Sirolimus je metabolizován látkou CYP3A4. Silné inhibitory CYP3A4 mohou vyvolat zvýšené působení léku Sirolimus, zejména v případě vícenásobné implantace. Také je nutné vzít v úvahu systémové působení léku Sirolimus v případě, že pacient bere doprovodně imunosupresivní léky.

13. KLINICKÁ ZKOUŠKA SE ZAŘÍZENÍM NITIDES

Základní bezpečnost a účinnost stentu NiTiDES byly stanoveny na základě rozhodující klinické zkoušky ILLUMINA před uvedením na trh.

Koncepce studie: V rámci multicentrické, jednoramenné studie bylo stentem

NiTiDES ošetřeno 100 pacientů se symptomatickým femoropopliteálním onemocněním s maximální délkou léze 14 cm. Primární účinnost (primární průchodnost) a primární bezpečnostní koncový bod (souhrn významných nezpříznivých účinků: smrt, amputace cílové končetiny, ischemie cílové končetiny nezpříznivějící chirurgický zásah, chirurgickou opravu cílové cévy nebo klinicky vedenou revaskularizaci cílové léze, které zhoršují hodnocení podle Rutherforda o dvě třídy nebo na třídu 5 či 6) byly po 12 měsících porovnány s objektivním výkonnostním cílem (OPG).

Výsledky: Ve 100 % případů bylo dosaženo úspěchu postupu.

Výsledky dopplerovského ultrazvukového vyšetření ukazují 87% primární průchodnost (77/89, 95% interval spolehlivosti 80-94), což splňuje požadavky OPG (73%). Primární průchodnost za 24 měsíce byla 81 % (63/78).

Primární bezpečnostní koncový bod po 12 měsících byl 96,8 % (90/93), což splňuje požadavky OPG (19,6 %), 2,2 % (2/93) pacientů mělo klinicky vedenou revaskularizaci cílové léze, 1,1 % (1/93) zemřelo, 0 mělo amputaci cílové končetiny, 0 mělo ischemii cílové končetiny vyžadující chirurgický zásah nebo chirurgickou opravu cílové cévy a 0 mělo zhoršení hodnocení podle Rutherforda o dvě třídy nebo na třídu 5 a 6.

Primární bezpečnostní koncový bod po 24 měsících byl 87,8 % (79/90), 6,7 % (6/90) pacientů mělo klinicky vedenou revaskularizaci cílové léze, 3,3 % (3/90) zemřelo, 0 mělo amputaci cílové končetiny, 1,1 % (1/90) mělo ischemii cílové končetiny vyžadující chirurgický zásah nebo chirurgickou opravu cílové cévy a 1,1 % (1/90) mělo zhoršení hodnocení podle Rutherforda o dvě třídy nebo na třídu 5 a 6.

14. NÁVOD K POUŽITÍ

Výběr zařízení

Pode délky cílové léze určete potřebnou délku stentu. Aby bylo možné náležitě pokryt lézi, délka rozvinutého stentu na obou stranách by měla být alespoň o 5 mm větší než délka samotné léze.

Podejměte úvahu o výběru vhodné velikosti stentu. Jako základ pro volbu vhodné velikosti stentu použijte větší průměr, aby bylo zajištěno bezpečné umístění stentu. Při výběru modelu přihlédjte k informacím uvedeným v tabulce 1.

Příprava zařízení

Před zavedením stentu podávejte heparin a zkontrolujte, zda je pacientův aktivovaný čas srážení (Activated Clotting Time – ACT) v souladu s postupy zdravotnického zařízení.

Během přípravy systému věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se stent nedostal do stuku se žádnou tekutinou.

- Otevřete krabičku a vyměňte vše obsahující sterilní sáček.
- Až prozkoumáte obal, zda není poškozený, otevřete vnější, nesterilní sáček z hliníkové fólie a potom vyměňte obsah vnitřního sáčku. (Poznámka: Sáček z hliníkové fólie a vnější povrch vnitřního plastového sáčku **NEJSOU STERILNÍ**. STERILNÍ je pouze obsah plastového sáčku.)
- Dejte pozor, abyste položili opěru na rovný povrch ve sterilním prostředí; povolte pásku kolem rukojeti a vyměňte katétr z ochranné cívky.
- Zkontrolujte, zda není zařízení katétr zkroucený, ohnutý či jinak poškozený. Při poškození zařízení může dojít ke zhoršení jeho funkčnosti.
- Například inkjekční stříšku na objemu 3 ml fyziologickým roztokem obsahujícím heparin, připojte ji k propchlávacímu konku toru Luer (obrázek 1, položka 12) a vyvříte pozitivní tlak. Propchlávajte, až fyziologický roztok začne vytéká z distálního konce katétru.
- Prohlédněte distální konec katétru a ujistěte se, že je stent (obrázek 1, položka 4) zcela pokryt vnějším pouzdrem.

Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo je stent částečně rozvinutý.

Kompatibilita s příslušenstvím

Se zařízením NiTiDES lze používat zaváděcí pouzdro a průměru 6F (2,0 mm) nebo větším.

Se zařízením NiTiDES lze používat vodicí dráty o průměru 0,035 in (0,89 mm) nebo menší. Výběr tuhosti vodicího drátu a konfigurace hrotu bude záviset na klinických zkoušenostech lékaře.

Při nezbytnosti použít zaváděcí katétr jsou systémy kompatibilní se zaváděcími katétry o průměru 8F (2,7 mm). V takovém případě se před zavedením zvolené sestavy ujistěte, že je hemostatický ventil zcela otevřen.

Zavedení stentu

a) Ujistěte se, že pojistný klín (obrázek 1, položka 10) rukojeti je v uzavřené poloze (detail B).

b) Opláchněte obnaženou část vodicího drátu fyziologickým roztokem obsahujícím heparin, abyste odstranili stopy krve a kontrastní látky.

c) Posunujte systém přes vodicí drát, až stent dosáhne místa lézy.

Pokud se kýdoly setkáte s neobvyklým odporom, nevyvrijte na systém nejmířenou silou, společně vytáhněte zaváděcí pouzdro, vodicí drát a zařízení jako jeden celek. Při použití nadměrné síly a/nebo nesprávném zacházení se může stent neplánovaně roztáhnout nebo se může poškodit zaváděcí katétr.

Zasunování zařízení

a) Posunujte systém, dokud nebude stent přesahovat přes lézi.

b) Zatáhněte za systém směrem zpět, dokud nebude stent zarovnán s lézí.

c) Ověřte, že část zaváděcího systému mimo tělo pacienta je volně natažena a rovná.

Pozor: pokud není zaváděcí systém správně natažen, může dojít k rozvinutí stentu mimo cílovou lézi.

Implantace a rozvinutí stentu

a) Jednou rukou pevně uchopte rukojet, abyste ověřili, že se rentgenkontrastní značky na stentu naležejí proximálně a distálně od léze.

b) Ujistěte se, že se zaváděcí pouzdro během roztáhování stentu nepohybuje.

c) Otočením pojistného klínu na rukojeti doleva (obrázek 1, detail B) odjistěte (KROK 1) a potom ho úplně vytáhněte (KROK 2).

- d) Držte rukojet' v pevné poloze vzhledem k pacientovi a znovu zkонтrolujte, že jsou rentgenkontrastní značky v požadované poloze vzhledem k lézi; začněte uvolňovat stent otáčením kolečka (obrázek 1, položka 9) palcem ve směru šípky, jak je znázorněno na obrázku 1.
- e) Až bude distální konec stentu řádně pripínán ke stěnám cévy, pod fluoroskopickou kontrolou pokračujte v zavádění tak, že budete otáčet kolečkem, dokud se stent neotevře a nebude zcela implantován ve stěnách cévy.
- f) Je-li nutné rychlé zavedení, pokračujte následujícím způsobem: ujistěte se, že na zadním konci rukojeti nejsou žádné překážky (např. našroubovaný konektor Luer), druhou rukou uchopte zadní konec zařízení (vytahovací, obrázek 1, položka 11) a vytahuje ho, zatímco budete držet přední část rukojeti naprosto nehybně vzhledem k pacientovi, jak je znázorněno na obrázku 1.
- g) Pod fluoroskopickou kontrolou ověřte, že se stent plně rozvinul.
- h) Stent můžete v případě potřeby dále roztáhnout pomocí balónkového katétru pro PTA. Při vyběru průměru balónkového katétru a dodatečném roztáhování použijte průměr cévy, který byl vyhodnocen pomocí angiografie. V každém případě budte zvlášť opatrní, abyste neroztahlí stent více, než je jeho nominální průměr uvedený na štítku.
- i) Konečný průměr stentu musí být slučitelný s referenčním průměrem cévy.

15. MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY

Případné nepříznivé účinky, které mohou být spojeny s implantací periferního stentu, zahrnují rizika související s perkutánní transluminální angioplastikou a další rizika související s používáním stentu, jak je uvedeno níže.

- Infekce, bolesti a hematom v místě přístupu
- Alergická nebo nepříznivá reakce (na kontrastní látku, léky použité při zákroku nebo materiály tvořící stent)
- Arteriální spazmus
- Trombolizace tepny nebo stentu
- Aneurisma nebo pseudoaneurisma stehenní tepny
- Aterosklerotická distální embolizace
- Krvácení
- Smrt
- Disekce, perforace nebo ruptura cévy se stentem
- Embolie
- Selhání ledvin
- Ischemická dolní konchetin (vyžadující chirurgický zásah)
- Restenóza tepny, do níž byl implantován stent
- Embolizace stentu
- Uzávěr cévy nebo neurčená stenóza

16. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA

Výrobce zaručuje, že toto zařízení bylo navrženo, vyrobeno a zabaleno s veškerou možnou péčí, za pomocí metod považovaných za nejvhodnější z těch, které jsou k dispozici s ohledem na aktuální stav technologie, a s použitím principů integrace bezpečnosti do návrhu a konstrukce tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání za stanovených podmínek a k určeným účelům při dodržování bezpečnostních opatření uvedených v předchozích odstavcích a v každém případě se do značné míry snížila, avšak zcela nevyložilá rizika související s používáním zařízení. Toto zařízení musí být používáno výhradně na odpovědnost specializovaného zdravotnického personálu s přihlédnutím k jakémkoliv zbytkovým rizikům a možným vedlejším účinkům a komplikacím léčby, pro jíž je určeno, včetně těch, které jsou uvedeny v jiných částech tohoto návodu použití.

Technická složitost a kritická povaha zvolených lékařských postupů a způsobů aplikace tohoto zařízení vylučují jakoukoli výslovou či implikovanou záruku výrobce na účinnost výsledků vyplývajících z použití tohoto zařízení nebo na jeho účinnost při řešení stavu zdravotního postavení či jakémkoliv jiné patologie nebo lékařského problému. Výsledky léčby jsou z klinického hlediska, tak ve smyslu funkčnosti a odolnosti zařízení ve skutečnosti závisejí na řadě faktorů mimo možnou kontrolu ze strany výrobce, mezi nimiž se uvádí pouze nevyloženě a jako příklady stav pacienta, chirurgický postup nebo použití implantátu a způsoby manipulace se zařízením po otevření obalu.

Vzhledem k této faktorům existuje odpovědnost výrobce pouze v případě, že se prokáže, že zařízení bylo dotčeno vadami v okamžiku, kdy bylo uvedeno do oběhu. Za tímto účelem musí zákazník neprodleně poskytnout zařízení k dispozici výrobci v souladu s podmínkami expirace a zákonnými predpisy; výrobce si vyhrazuje právo prozkoumat domněle vadné zařízení a stanovit, zda je skutečně dotčeno vadami, které by mohly ovlivnit bezpečnost výrobku. Odpovědnost výrobce je vyloučena, pokud (i) je vada reklamována kvůli souladu zařízení se závazným pravidlem nebo závazným ustanovením a/nebo (ii) vada, která způsobila poškození, neexistovala v okamžiku, kdy výrobce uvedl zařízení na trh, a/nebo (iii) jestliže stav technických a vědeckých poznatků v okamžiku, kdy výrobce uvedl zařízení na trh, dosud neumožňoval považovat zařízení za vadné a/nebo (iv) v jakémkoliv jiném případě, který se také liší od výše uvedených případů, kdy zákon výslově vylučuje nebo omezuje odpovědnost výrobce za škody způsobené vadnými výrobky. Záruka spočívá pouze ve výměně vadného zařízení za jiné zařízení stejněho nebo rovnocenného typu, které vyrábí tento výrobce.

Záruka platí pouze v případě, že je zařízení správně vráceno výrobci společně s podrobnou písemnou zprávou o reklamovaných vadách a v případě implantovaných zařízení jsou uvedeny důvody vyjmuty z těla pacienta. Reklamované vady musí být neprodleně oznámeny výrobci v souladu s podmínkami propadnuté a zákonnémi předpisy.

Jakmile je provedena výměna, výrobce uhradí základní náklady, které mu vznikly v souvislosti s vrácením zařízení, jehož vada byla uznána.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení způsobů použití a bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu k použití a v případě použití po datu expirace uvedeném na obalu.

Dále výrobce odmítá veškerou odpovědnost za následky zvolených lékařských postupů a způsobů použití nebo aplikace zařízení, a proto nebudou za žádných okolností stíhán za žádné hmotné, biologické nebo morální škody libovolné povahy vzniklé v důsledku použití tohoto zařízení nebo techniky implantace, kterou uživatel zvolil.

Jednatelé a zástupci výrobce nejsou oprávněni měnit žádné z výše uvedených podmínek, přijímat jakékoli další závazky, ani poskytovat jakoukoli jinou záruku v souvislosti s tímto výrobkem, než jaká je uvedena výše. Tato záruka se řídí italskými zákony, pokud se neuplatní závazné zákony jiného státu v případě, že výrobce schválí distribuci výrobku do jednoho nebo více států jiných než Itálie.

ESTI

NiTIDES

„Carbofilm™-i kattega iselaienev Amphilimus™-e (sirolimus + rasvhape) ravimkaetud perifeerne stendisüsteem

1. SEADME KIRJELDUS

NiTIDES-i seadmete perekonda kuuluvad iselaienev stent ja selle öigeks paigaldamiseks ning kasutamiseks mõeldud süsteem.

Stent on paindav, iselaienev implanteeritav seade. See on valmistatud niklist ja titaansulamist (nitinool) ning kaetud „Carbofilm™-iga – õhukese süsiniukkihiiga, mille ülitundlik turbostaatiline struktuur on sisuliselt identne pürolütilise süsiniku struktuurile.

Alusmaterjalil katmine annab sellele pürolütilise süsiniku bioühilduvat ja hemühilduvat omaduseid, mõjutamata alusmaterjalil füüsikalisi ja struktuurilisi omadusi.

Stendi on kuus kiirgust läbilaskmatud tantaalmarkerit (kolm kummaski otsas), võimaldamaks stenti haiguskoldele õigesti asetada.

Stendi väline pind, kus on eriotstarbelised sooneed, on kaetud „Carbofilm™-iga, sest see sisaldaab ravimit siroliinu ja pikaaehalaga rasvhapete segust koosnevat ravimit Amphilimus™.

Ravitava veresoone pinna jaoks mõeldud ravimi kindel doos on umbes 0,9 µg/mm², mis vastab väiksema stendi (6,0 × 20 mm) minimaalsele doosile 270 µg ja suurema stendi (8,0 × 150 mm) maksimaalsele doosile 2420 µg.

Kasutatava paigaldussüsteemi tüüp on „ile traadi”, mis tagab, et stendi saab ohutult haiguskoldele asetada ja vabastada. See on näidatud joonisel 1 ja koosneb järgmisest osadest:

- kateeter (7), läbimõõduga 6F, mis koosneb järgmistes osadest:
 - sissetömmatav väline kest, distaalne, poollääbiptaistevosa (3), kus on stent (4). Kestal on kateetri tipu läbitalt kiirgust läbilaskmatu võre (13);
 - sisemine luumen, mis koosneb keerust (6) ja sisemisest torust (2), mis ühildub 0,035 tollise juhtetraadiga. Sisemine luumen läheb pikki kateetrit alates Luer-tüüpi liitmikust (12), kinnitudes proksimaalselt käepidele külje ja lõpeb distaalselt kateetri otsas (1) kiirgust läbilaskmatu materjalil, hõlbustades stendi asukoha määramist ning paigutamist pildindussüsteemil.
 - Sisemise luuengi seotud pidut (5) takistab stendi teljelt nihkumist välisse kestat sissetömbamisel;
- Paigaldussüsteemiga käepide (8), mis võimaldab paigaldada kateetrit ja stenti algsele kohale.

Käepideme ergonomioonilise kuju võimaldab kasutajal seda haarata ja kasutada isegi ühe käega. Selle proksimaalses otsas on Luer-tüüpi port (12), mida kasutatakse juhtetraadi luuemu loputamiseks, ohutuslüliti (10), ketas (9) ja tagasitõmbamise osa (11).

Toote toodab perifeerseid stente ja paigalduskateetreid otse ja rakendab nii tootmisproseduuride ajal kui ka valmisteodele köiki kvaliteedikontrolli toiminguid vastavalt heade tootmistavade juhistele.

2. SEADME SIHTOSTARVE

Perifeerne iselaienev stendisüsteem on mõeldud perifeersete arterite haiguse raviks, mis mõjutab pindmest reiearterit ning proksimaalset põlvõndla arterit.

3. SEADME NÄIDUSTUSED

Seade on näidustatud reie-õndla arterite stenooside raviks põlvvest ülevalpool sümptomaatilistel [Rutherfordi kategooria 2–5] täiskasvanud patsientidel. Ravitud haiguskolle, pikkusega kuni 14 sentimeetrit, peab olema kas oklusiونiga või rohkem kui 50% ulatases stenoosiga, de-novo tekkinud või restenoos, mida pole varem stendiga ravitud.

4. VASTUNÄIDUSTUSED

Stendi kasutamine on vastunäidustatud järgmistes olukordades.

- PTA- või muude sekkumistehnikate abil ravimatuks peetavad haiguskolded.
- Rasedad, rinnaga toitvad naised.
- Põleõndlaarteri või põlevliigeesse kahel distaalsel kolmandikul asuvad haiguskolded.
- Kliinilised tingimused, mis takistavad antitrombotsütaarse ja/või hüübeimsvastast ravi kasutamist.

5. HOIATUSED

- Seadme kasutamine pole soovitatav patsientidel, kellel on teadaolev ülitundlikkus või allergia sirolimuse, rasvhapete (nt steariinhappe, palmitiinhappe, beeheenhappe) või stendi metallide (nt nikkel, titaan ja tantaal) suhtes.
- Seade on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Mitte korduskasutada, uuesti töödelda ega uesti steriliseerida. See võib põhjustada seadme saastumisrohu ja/või patsiendi infektsioonihoitu, põletikku ning patsiendilt patsiendile kanduvat infektsioonihaiuga.
- Seade on mõeldud kasutamiseks süsteemina. Ärge kasutage selle osi eraldi.
- Ärge kasutage seadet, kui pakend on avatud või kahjustatud, valesti hoiustatud või aegumiskuupäeval on mõödas. Sellisel juhul pole toote steriilsus garantteeritud.
- Seadet lohivad kasutada ainult arstid, kes on läbinud erikoolitusse perkutaanse transluminaalse angioplastika (PTA) tegemiseks ja perifeerse stendi paigaldamiseks.
- Kui protseduuri ajal tekib takistus, ärge rakendage süsteemile jõudu: tömmake stendisüsteem ja kogu paigaldamiskateeter, juhtetraat ning sisesti ühe üksusena välja. Liigse jõu kasutamine ja/või vale käsitsimine võib põhjustada stendi kogemata hetkel võib vale käsitsimine paigaldamiskateeterit.
- Mis tahes operatsiooni hetkel võib vale käsitsimine põhjustada veresoone dissektiooni, perforeerumist või rebenemist.
- Ärge lükake ega tömmake stendisüsteemi paigaldamise ajal: see võib tõsiselt kahjustada veresoone seinu.

- Iselaieneva perifeerse stendi paigaldamine võib põhjustada stendi lähedal ja/või sellest eemal paikneva veresoone dissektiooni ning põhjustada ka veresoone akutset blokadi, tekitades lisaooperatsiooni vajaduse (kirurgiline veresoonte vahetamine, edasi laiendamine, lisastentide paigaldamine või muud protseduuri).
- Kui stent on osaliselt paigaldatud, ei saa seda paigaldussüsteemil abil eemaldada.

6. ETTEVAATUSBAINÖÜD

- Ärge kunagi kasutage stendi laiendamise alguses kiire vabastamise süsteemi. Kasutage seda ainult vajadusel, kui vähemalt pool stendi pikkusest on vabastatud.
- Seadet tuleb käsitseda hoolikalt, et vältida kokkupuudet metallist või abrasiivsete instrumentidega, mis võivad seda kahjustada või mehaaniliselt muuta.
- Seade ei tohiks enne ettevalmistamist ja paigale asetamist vedelikega kokku puutuda.
- Seadme paigaldussüsteem ei ole mõeldud kasutamiseks kontrastaine süstevhenditega.
- Kui stente paigaldatakse kahekaupa, peavad vastavad kiirgust läbilaskmatud märgised kattuma. Kattuda ei tohiks rohkem kui kaks stenti.
- Kattuvate stentide korral on soovitatav kattumise ulatus vähem kui 20 mm.
- Stendi kahjustamise vältimiseks olge juhtetraadi, balloonkateetri või muu seadme viimisel läbi äsja paigaldatud stendi läärmiselt ettevaatlak.

7. MRT OHUTUSTEAVE

Mitteklüinilised katsed on näidanud, tootja Nitinol stendi tootesarjad on MRT-ingimustel. Selle seadmega patsienti saab ohutult skannida MR-süsteemis, mis täidab järgmisi tingimusi.

- Staataline magnetvälis tugevusega 1,5 Teslat (1,5 T) või 3 Teslat (3 T)
- Välia ruumilise maksimumgradient 6140 G/cm (61,40 T/m)
- Teatatud maksimaalne MR-süsteem, kogu keha keskmise spetsiifilise needumiskiirusega (SAR):
 - 1 W/kg (tavaline töörežiim) 1,5 T juures
 - 1 W/kg (tavaline töörežiim) 3 T juures

Dielektriline soojenemine

Ülaltootud skannimistinqimuste korral on tootja Nitinoli stendi tootesarja suurim ootuspärane temperatuuriõhus alla 6,8 °C 15-minutilise pideva skannimise järgselt teatatud MR-süsteemis ning kogukeha keskmine spetsiifiline needumiskiirus (SAR) on 1,0 W/kg.

	1,5 T	3 T
Ühestendilne konfiguratsioon Surim temperatuuriõmootus	≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
Kattuvate stendi konfiguratsioon Surim temperatuuriõmootus	≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C

MR-artefakt

Mitteklüinilistes katsetes on seadme põhjustatud pildiartefakt ulatunud ligikaudu 0,7 cm kaugusele tootja Nitinoli stentidest, kui piltdiagnostikaks kasutati 3 T MRT-süsteemis kaja-gradiendi või spinnkaja impulsijadasid.

8. TARNIMINE

NiTIDES-i seade tarnitakse steriliksena (etüleenoksidi ja CO₂, seguga steriliseeritud), see on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ja on pakitud kahte kotti, mida ei tohi sterilisseesse keskkonda via. **MÄRKUS:** sisemine kott on ainus steriline töke. Sterilius ja keemiline stabilisus tagatakse seni, kuni pakend on puutumatud ning kuni pakendile trükitud aegumiskuupäevani (KASUTADA ENNE KUUPÄEVA).

Sisu: üks (1) „Carbofilm™-i kattega iselaienev Amphilimus™-e (sirolimus + rasvhape) ravimkaetud perifeerne stendisüsteem

9. HOIUSTAMINE

Tootet tuleb säilitada pakendil näidatud viisil, jahedas ja kuivas kohas, säilitustemperatuuriuga kuni 25 °C.

10. MUDELID

NiTIDES-i seade on tuvastatav mudeli koodi ja partiinumbri alusel; saadaolevad tootekoodid on esitatud tabelis 1.

11. RAVIMIREŽIIM

Kliinilises kirjanduses kirjeldatud uuringud näitavad operatsioonielsele antitrombotsütaarse ravi, protseduuriägse antikoagulantravi ja operatsioonijärgse antitrombotsütaarde ravi vajadust.

Antitrombotsütaarne ravi pärast protseduuri hõlmab järgmiste ravimite manustamist:

- Thienopyridines (tklipodiini, klopodigreel või prasugreel ravimi infolehel esitatud kogustes või retsepti järgi).
- Aspirin minimaalses koguses 100 mg ööpäevas määramata ajaks.

Protceduuri kompleksust ja paljusid patsiendi olukorda mõjutavaid faktoreid arvestades jäab sobiva ravi määramine arsti otsustada.

12. KOOSTOIME RAVIMITEGA

Kuigi saadaval ei ole üksikasjalikke kliinilisi andmeid, võivad mõned ravimid, näiteks takrolimius, mille toime avaldub läbi sama siduva valgu (FKBP), segada sirolimuse möju. Sirolimust metabolismeerib CYP3A4. Tugevad CYP3A4 inhibitorid võivad suureneda sirolimuse vabastamist, eriti mitme implantaadiga juhtudel. Arvestada tuleb ka sirolimuse süsteemse vabastamisega, kui patient võtab samal ajal süsteemelt immuunreaktsiooni pärssivaid ravimeid.

13. NITIDESI KLIINILINE UURING

NiTIDES-i stendi peamine ohutus ja efektivsus on kindlaks määratud turustamise eelse keskse kliinilise uuringuga ILLUMINA.

Uuringu ülesehitus: mitmekesikuselises ühe rühmagaga uuringus raviti 100

sümpтоматilist reie-õnblaarteri tövega patsienti, kelle maksimaalne haiguskolde piikkus on 14 cm, NiTiDES-i stendiga. Esmane efektiivsus (esmane läbitavus) ja esmane ohutusnäitaja (peamiste kõrvaltoimete liinätaja: surm; sihtmärkjäseme amputeerimine; sihtmärkjäseme isheemia, mistöttö ja vajalik kirurgiline sekkumine või sihtmärkveresoone operatiivne parandamine või kliiniliselt juhitud sihtmärkhaiguskolde revaskulariseerimine; Ruthefordi skoor halvenemine 2 klassi võrra või klassini 5 või 6) võrreldi objektiivse tulemusliku eesmärgiga (Objective Performance Goal, OPG) 12. kuul.

Tulemused: protseduuri edukus oli 100%.

Doppleri ultraheli tulemusel on näidatud esmasti läbitavust 87% (77/89, 95% usaldusvahemik 80–94), mis vastab OPG nõuetele (73%). 24-kuune esmane läbitavus oli 81% (63/78).

12-kuune esmane ohutusnäitaja oli 96,8% (90/93), mis vastab OPG nõuetele (19,6%). 2,2%-l (2/93) patsientidest oli kliiniliselt juhitud sihtmärkhaiguskolde revaskulariseerimine, 1,1% (1/93) suri, oli 0 sihtmärkjäseme amputeerimist, 0 sihtmärkjäseme isheemia, mistöttö ja vajalik kirurgiline sekkumine või sihtmärkveresoone operatiivne parandamine ning 0 patsientidel halvenes Ruthefordi skoor kahe klassi võrra või klassini 5 ja 6.

24-kuune ohutusnäitaja oli 87,8% (79/90). 6,7%-l (6/90) patsientidest oli kliiniliselt juhitud sihtmärkhaiguskolde revaskulariseerimine, 3,3% (3/90) suri, oli 0 sihtmärkjäseme amputeerimist, 1,1%-l (1/90) oli sihtmärkjäseme isheemia, mistöttö ja vajalik kirurgiline sekkumine või sihtmärkveresoone operatiivne parandamine ning 1,1%-l (1/90) patsientidest halvenes Ruthefordi skoor kahe klassi võrra või klassini 5 ja 6.

14. KASUTUSJUHISED

Seadme valimine

Vajaliku stendipikkuse tuvastamiseks juhinduge haiguskolde piikkusest. Haiguskolde nõuetekohaseks katmiseks peaks paigaldatud stendi piikkus olema vähemalt 5 mm pikem kui haiguskolle ise mõlemalt poolt. Sobiva stendi suuruse tuvastamiseks juhinduge haiguskolde proksimaalse ja distaalse veresoone läbimõõdust. Stendi kindla paigutuse tagamiseks valige nõuetekohane stent suurema veresoone läbimõõdu järgi. Mudeli valimisel juhinduge tabelisi 1 olevalt teabest.

Seadme ettevalmistamine

Enne stendi paigaldamist manustage hepariini ja kontrollige, et patsiendi aktiveeritud hüübimoodus (ACT) ültib keskuse praktikaga.

Süsteemi ettevalmistamise ajal jälgige eriti hoolikalt, et stent ei puutuks kokku ühegi vedelikuga.

- avage karb ja võtke steriilset kotikest sisaldat kott välja;
- päras tõenäoliselt pakendatud kahjustustest kontrollimist avage välimine mittesteriilne poolumikott ning seejärel eemaldage sisemise kotikese sisu; (Märkus. Sisemise plastotki välispind ja poolumikust EI OLE STERIILSED. Ainult plastotki sisu on STERIILNE).
- c) oletektiivsust tulenevalt sterilises keskkonnas tasapinnale, tehke käepideme ümber olevin kinnitus lahti ja eemaldaage kateeteri kaitsekeeremest;
- d) kontrollige, et paigaldusketere pole keerdus, kokku pigistatud ega muul moel kahjustatud. Seadme kahjustamine võib rikkuda selle tõõvõimet;
- e) täitke 3 ml süstal hepariini sisaldaava füsioloogilise lahusega, ühendage looputamise Luer-tüüpi liitukiga (joonis 1, element 12) ja rakendage positiivset rõhku. Jatkake looputamist, kuni füsioloogilise lahust tuleb kateetri distaalses otsas nähtavale;
- f) vaadlege kateetri distaalt otsa, tehes kindlaks, et stent (joonis 1, element 4) oleks täielikult välise kestaga kaetud.

Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustunud või kui stent on osaliselt väljas.

Sobivus tarvikutega

Seadmeega NiTiDES võib kasutada 6F (2,0 mm) või suurema diameetriga sisestest kestasid.

Seadmetega NiTiDES võib kasutada 0,035 toliseid (0,89 mm) või väiksemaid juhtetraadi. Juhtetraadi jäikuse ja tipu kuju valik sõltuvad arsti kliinilisest kogemusest.

Kui juhtekateetri kasutamine peab vajalikuks osutuma, ühilduvad süsteemid 8F (2,7 mm) või suurema läbimõõduga juhtekateetrile. Sellisel juhul veenduge enne valitust koostu sisestamist, et hemostaatilise klapp on täiesti avatud.

Stendi sisestamine

- veenduge, et käepideme ohutuslüliti (joonis 1, element 10) on lukustatud asendis (detail B);
- vere ja kontrasteeringu jälgede eemaldamiseks peske juhtetraadi väljajääv osa hepariini sisaldaava füsioloogilise lahusega;
- viige süsteem üle juhtetraadi, kuni stent jõuab ravitava kohani.

Kui mis tahes ajal tekib ebatavaline katustus, ärge rakendage süsteemile jõudu: tömmake sisesti, juhtetraadi ja seade ühtse üksusena koos välja. Liigse jõu kasutamine ja/või vale käsitsimine võib põhjustada stendi kogemata paigaldamist või kahjustada paigaldusketetrit.

Seadme edasiliükamine

- viige süsteem punkti, kus stent on haiguskoldest mõodas;
- tömmake süsteemi tagasi, kuni stent on haiguskoldega joondatud;
- kontrollige, et paigaldussüsteemi patsiendi kehast väljapoole jäädv osa on vabalt pikendatud ja sirge.

Ettevaatust! Kui paigaldussüsteem ei ole õigesti pikendatud, võib stent paigalduda sihthaiuskoldest eemale.

Stendi paigaldamine ja laiendamine

- hoedes käepidemest ühe käega tugevasti kinni, kontrollige, et stendl olevad kiirust läbilaskmatud markerid on asetatud haiguskollete suhtes proksimaalselt ja distaalselt;
- veenduge, et sisest kest stendi paigalduse ajal ei liigu;
- põörake käepidemel olevat ohutuslüliti (joonis 1, detail B) avamiseks vastupäeva (1. SAMM), seejärel tömmake see täielikult välja (2. SAMM);

- hoedes käepidet patsiendi suhtes fikseeritud asendis, kontrollige uuesti, et kiirust läbilaskmatud markerid on haiguskolde suhtes vajalikus asendis. Alustage stendi paigaldamist, keerates ketast (joonis 1, element 9) pooldlagu noole suunas, nagu on näidatud joonisel 1;
- etätkake fluoroskoopia all ketta põõramist, kui distaalte stendi ots on hästi kinnitunud veresoone seintele, kuni stendi ots on avatud ja see on täielikult veresooneeseinadesse paigaldatud;
- kui vaja on kiret paigaldamist, toimige järgmiselt: veenduge, et käepideme tagumises otsas ei ole ühtegi takistust (nt on Luer-tüüpi liitnik kinni keeratud), võtke teise käega seadme tagumisest otsast (tagasisihaarde mehanism, joonis 1, element 11) kinni ja tömmake seda, hoedes käepideme esimest osa patsiendi suhtes täiesti paigal, nagu on näidatud joonisel 1;
- kontrollige fluoroskoopiliselt, et stent oleks täielikult laiendatud;
- stendi saab vajadusel PTA balloonkateetri abil edasi laiendada. Balloonkateetri läbimõõdu valimisel ja järelaienduse tegemisel juhinduge veresoone läbimõõdust, mida hinna angioagraafia abil. Igal juhul põõrake erilist tähelepanu sellele, et stendi ei laiendataks üle selle nominaal läbimõõdu, mille leiate sildilt;
- stendi lõplik läbimõõt peab sobima veresoone vordlus läbimõõduga.

15. VÕIMALIKUD KÖRVALTOIMED

Perifeerse stendi paigaldamisega seostatavad võimalikud körvaltoimed hõlmavad perkuutanse transluminaalse angioplastika seotud ohtusid ja täiendavaid stendi kasutamisega seotud ohtusid, mis on esitatud allpool.

- Sisestuskoha infektsioon, valu ja hematoom
- Allergilise reaktsiooni või körvaltoime kontrastainele, protseduuri käigus kasutatavatele ravimitele või stendi materjalidele
- Arteri spasm
- Arteriaalne või stendi tromboos
- Reiearteri aneurüsm või pseudoaneurüsm
- Aterosklerootiline distaalne embolisatsioon
- Veritus
- Surm.
- Stenditööt veresoone dissektioon, perforatsioon või rebenemine
- Embolia
- Neerupuudulikkus
- Alumiste jäsemete isheemia (vajalik kirurgiline sekkumine)
- Restenoos arteris, kuhu stent paigaldati
- Stendi embolisatsioon
- Veresoone oklusiōon või lähendamata stenoos

16. VASTUTUS JA GARANTI

Tootja kinnitab, et seade on kujundatud, valmistatud ja pakitud hoolitsemaks selle eest, et kasutatakse praeguse seisuga kõige sobivamat tehnika, ning rakendamaks kasvandamisel ja konstrukteerimisel ohutuse integreerimise põhimõtteid, et tagada selle oolutus ettenähtud tingimustel ja sihtotstarbel kasutamisel. Järgides eelnäevates lõikudes esitatud ettevaatusabinõisust, on igal juhul üritatud võimaluse pires sedmaga seotud riske maandada, kuigi neid täielikult kõrvaldada pole võimalik.

Seadet tohib kasutada ainult koolititud tervishoiutöötajate vastutusel ja võttes arvesse ravi näidustusega kaasnevaid jäänkähtusid ning võimalikke körvaltoimeid ja tüsitsusi, sealhulgas neid, mis on esitatud sellse juhendi eelnäevates osades. Tehnilisest keerulise olemus ja seadme kasutamisega seotud kritilised meditsiinilised otsused ning paigaldamismeetod valistavad tootja otseste või kauduse garantii seadme kasutamisest järgselt tõhususe kohta või selle haigusseisundi, patoloogia või meditsiinilise probleemi lähendamise tõhususe kohta. Tegelikult sõltuvat tulemused nii klinilisest vaatenurgast kui ka seadme toimivuse jakestuse osas paljudest teguritest, mis ei sõltu tootjast. Muuhulgas on esile tööstetud ainult näited ja mitte ammendavad patsiendiiga, implantierimise kirurgilise protseduuri, seadme kasutamisega või pakendi avamise järgselt manipuleerimise meetoditega seotud tingimusel.

Neid tegureid silmas pidades vastutab tootja ainult siis, kui on töestatud seadme defektid nende ringlusse võtmise ajal. Seetõttu peab klient seadme andma viivitamatult tootja katusse, järgides seaduses nõutavaid kehtivusajia ja aegumise seotud tingimusi; tootja jätab endale õiguse kontrollida vigaseks peetud seadet ja teha kindlaks sellel tutvastatavad defektid, mis võivad mõjutada toote ohutust. Tootja ei vastuta, kui (i) vältidetav defekt on tingitud seadme vastavustest kohustustlike reeglike või siduvate sätete ja/või (ii) kahju tekitannud defekt puudus, kui tootja seadme vastabaslast, ja/või (iii) kui tehnilise ja teadusliku teabe alusel tootja seadme vastabastamise ajal polnud võimalik seadet veel defektseks pidada ja/või (iv) mis tahes muul juhul, isegi kui see erineb eeltoodust, kus seadus selgesõnaliseks vältist või piirab tootja vastutust defektsete toode teahedest kahjustustest. Garanti katab üksnes defektke seadme asendamise tootja valmistatud teise samasuguse või samaväärse seadme tüübiga.

Garanti kehtib üksnes juhul, kui seade tagastatakse õigesti tootjale koos kirjaliku ja ülsikasjaliku aruandega vältidetavatest defektidest ja implantieritud seadme puhul ka selle patsiendiidem eemaldamise põhjustest. Tootjale tuleb viivitamatult vältidetavast defektset teatada koosksaliseks seadustes ettenähtud konfiskeerimise tingimustega. Asendamise järgselt hüpib tootja kliendile kulutused, mis viimane kandis kinnitatud vigase seadme tagastamise töötu.

Tootja loobub igasugusest vastutusest selles kasutusjuhendis märgitud kasutusmeetodite ja ettevaatusabinõude eiramise korral ning pärast pakendi märgitud aegumiskuupäeva.

Tootja keelud ka igasugusest meditsiinilisest ostsustest ja seadme kasutamisest või rakendamise meetoditest tulemenen tagajärgede vastutusest ning seega ei saa mitte mingil juhul vastutusele võtta kasutaja seadmekasutusest ja kasutatavast implantatsioonitehnikast tingitud mis tahes materiaalse, bioloogiliste ega märaalsete kahjude eest.

Tootja vahendajel ja esindajatel pole õigust väljaspool ülaltoodule muuta ühtegi eelinavalt seadust tingimustega ega võtta lisakohustusi ega pakkuda selle tooteaga seotud garantisiid. Sedas garantid reguleerivad Itaalia seaduseid, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse mõne muu riigi seadusi, juhul kui tootja on andnud loa toote ringlusesse võtmiseks ühes või mitimes riigis väljaspool Itaaliat.

NITIDES

Carbofilm™ bevonatú öntáguló Amphilimus™ (Sirolimus+zsírsav) eluáló perifériás sztentrendszer

1. ESKÖZKÖZLEÍRÁS

A Nitides terméksalád egy öntáguló sztentből és egy olyan szállítórendszerből áll, amely a sztent megfelelő elhelyezését és beültetését szolgálja.

A sztent egy rugalmas, öntáguló, beültethető eszköz. A sztent nikkel- és titániumötvözetből (Nitinol) készül, és a Carbofilm™ bevonattal rendelkezik; ez a pirolitikus szénél gyakorlatilag megegyező, nagy sűrűségű, turbosztrátikus szerkezetű, vékony szénréteg.

Az anyag bevonata felrúházza azt a pirolitikus szén bio- és hemokompatibilis tulajdonságait az anyagok és szerkezet jellemzőinek befolyásolás nélkül. A sztentet hat sugarafogó tantálmarkerrel látták el (mindkét végén hárrommal) a kezelendő elváltószárat területre történő megfelelő behelyezés érdekében.

A sztent külön felszínén az Amphilimus™ nevű gyógyszerkészítményt tartalmazza, teljesen „Carbofilm™-mel” bevont vágatok találhatók. Az Amphilimus a Sirolimus nevű gyógyszerből és hosszú láncrendszerből keverékhez készített.

A gyógyszer érffelület kezelésére alkalmazott specifikus dózisa 0,9 µg/mm², ami 270 µg-os minimális dózisnak felel meg a kisebb sztenten (6,0x20 mm) és 2420 µg-os maximális dózisnak a nagyobb sztenten (8,0x150 mm).

Az alkalmazott **bevezetőrendszer** drótban vezetett típusú, amely biztosítja a sztentnek az elváltózásra történő biztonságos elhelyezését és használatát. Az 1. ábra szemükön ábrázolja az eszközt, amelynek részei a következők:

- egy 6 F átmérőjű katétertest (7), amely az alábbi alkotórészekből áll:
 - egy visszahúzható külüi hüvelykből, egy disztalis, félíg áttetsző részből (3), amely a sztentet tartalmazza (4); a hüvelyen található sugarafogó gyűrűből (13), amely a katéter hegyének közelében van;
 - egy belső lumenből, amely tartalmaz egy tekercset (6) és egy belső csövet (2), amely kompatibilis egy 0,035 hüvelyk átmérőjű vezetődróttal; a belső lumen a katéteren belül proximálisan a fogantyúhoz rögzítéssel luerszereléktől (12) disztilisan a sugarafogó anyagból készült katéterhegyig (1) terjed, elősegítve a sztent lokalizációját és behelyezését képalátó berendezéssel. A belső lumennel egybeépített zároszeret (5) megelőzi, hogy a sztent a külülső hüvely visszahúzása során axiális irányban elmozduljon;
 - egy fogantyú (8) behelyezőrendszerrel, amely lehetővé teszi a katéter pozicionálását és a sztent in situ elhelyezését.

A fogantyú ergonomikus kialakítású, így akár egy kezzel is megfogható és használható. Proximális végén luerportot (12) tartalmaz, amely a vezetődrót lumenének átmossására használhatós, ezenkívül egy biztonsági csapot (10), egy kereket (9) és egy visszahúzó végét (11).

A periferiás sztentet és a behelyező katéterrendszer közvetlenül a gyártó állítja elő, és minden gyártás során, minden a kész termékkel esetében a helyes gyártási gyakorlat (Good Manufacturing Practice) előírásai szerint jár el.

2. AZ ESZKÖZ JAVALLOTT FELHASZNÁLÁSA

Az öntáguló periferiás sztentrendszer használata a superficialis femoralis artériát és a proximális popliteális artériát érintő periferiás arteriabetegek kezelésére javasolt.

3. AZ ESZKÖZ JAVALLATAI

Az eszköz a femoropopliteális artériák térd feletti szűkületének kezelésére alkalmas, tüneteket mutató felnőtt betegek (Rutherford 2-5) esetében. Feltétel, hogy a kezelnivaló lézió maximum 14 cm hosszú legyen, elzáródás vagy 50%-osnál nagyobb szénzitózis legyen, amely de novo keletkezett vagy kiújult, és korábban nem kezeltek szenttel.

4. ELLENJAVALLATOK

A sztent alkalmazása ellenjavallat az alábbi esetekben:

- PTA eljárással és más, beavatkozással járó technikával nem kezelhetőnek minősűlő elváltózások.
- Terhes és szoptató nők.
- Az arteria poplitea disztális kétharmadában vagy a térdízületnél elhelyezkedő léziók.
- A trombocitaellenes és/vagy az antikoaguláns kezelés használatát akadályozó klinikai állapotok.

5. FIGYELMEZTETÉSEK

- Az eszköz használata nem javasolt olyan betegek esetében, akik túlerzékenyek vagy allergiásak a Sirolimusra, zsírsavakra (pl. szteinrinsav, palmitinsav és behénsav) vagy a sztent fémösszetevőre (pl. nikkel, titán vagy tantál).
- Az eszközt kizárolják egyszeri használatra terveztek. Újrafelhasználása, újrafeldolgozása vagy újraszerelésre tilos! Az újrafelhasználás, újrafeldolgozás vagy újraszerelés fokozza az eszköz kontaminációjának kockázatát és a beteg fertőződését, gyulladást és fertőző betegséget betegről betegre törtenő átvitel okozhatja.
- Az eszközt egy rendszerként történő használatra terveztek. Alkotórészeit tilos külön-külön használni.
- Ne használja fel az eszközt, ha csomagolását felnyitották vagy sérült, ha nem megfelelően tárolt, vagy ha a megjelölt szavatossági idő lejárt. Ilyen esetekben a termék sterilitása nem garantált.
- Az eszközt csak kifejezetten a perkután transzluminális angioplastika (PTA) és a periferiás sztentbeültetés végzésére kiképzett orvosok használhatják.
- Amennyiben a behelyezési eljárás során bármikor ellenállás tapasztal, ne erőltesse a rendszer alkalmazását: egyetlen egységként húzza vissza a sztentrendszeret és a teljes vezetőkatétert, a vezetődrótot és a bevezetőhüvelyt. A túlzott erőkifejtés és/vagy nem megfelelő kezelés a sztent véletlen behelyezésével vagy a behelyezőkatéter sérülésével járhat.
- Az eszköz nem megfelelő kezelése az operáció során az ér disszekcióját,

perforációját vagy ruptúráját okozhatja.

- Behelyezés közben ne tolja előre és ne is húzza vissza a sztentrendszer, mert ez súlyos károsíthatja az érfalat.
- Az öntáguló periferiás sztent beültetése az ér szenthez viszonyított disztrális és/vagy proximális szakaszának disszekciót okozhat, és az ér akut elzáródását is eredményezheti, ami további műtéttel tesz szükséges (műteti érpótlás, további tágítás, további sztentek behelyezése vagy egyéb eljárások).
- A sztent részleges kinyitását követően az eredeti állapot a bevezetőrendszerrel nem állítható vissza.

6. ÖVINTÉZKEDÉSEK

- **Soha ne használja** a gyors keresztő rendszert a sztent kitágulásának kezdetei. Csak **szükség esetén** használja, azután, hogy a sztent legalább a **hosszának a feléig** kijutt.
- Az eszközöt óvatatosan kell kezelni, azaz el kell kerülni bármilyen érintkezést fém- vagy csiszolányokkal, amelyek károsíthatják az eszköz vagy mechanikai eltéréseket okozhatnak rajta.
- Az eszköz ne érintkezék folyadékokkal az előkészítést és a pozicionálást megelőzően.
- Az eszköz behelyezőrendszer nem használható kontrasztanyag-injektorral együt.
- A sztentek egymás utáni (tandem) beültetésének esetében a relativ sugarafogó jelöléseknek átfedésben kell lenniük. Az átfedés maximum kettő szentet érinthet.
- Átfedő szentek esetében 20 mm-nél kisebb átfedési hosszúság javasolt.
- A sztent sérvülésének elkerülése érdekében különös körültekintést járjon el, miközben a vezetődrót vagy a ballonkatétert vagy egy másik eszközöt a behelyezett sztenten keresztül mozgatja.

7. MR BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Nem klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a gyártó Nitinol sztent terméksaládja MR kondicionális. Az ilyen eszközöt viselő beteg biztonságosan vizsgálható a következő feltételeknek megfelelő MR berendezéssel:

- 1,5 teslás (1,5 T) vagy 3 teslás (3 T) statikus mágneses mező
- Maximális mágneses térfogás 6 140 G/cm (61,40 T/m)
- Maximális MR rendszer, egész testes átlagolt specifikus abszorpciói ráta (SAR):
 - 1 W/kg (normál üzemmód) 1,5 T esetében
 - 1 W/kg (normál üzemmód) 3T esetében

RF (rádiófrekvenciás) hőmérséklet-emelkedés

A fent leírt szkennelési körülmenyek között a Nitinol sztent gyártója szerint 15 perc folyamatos, MR rendszerben történő vizsgálat után kevesebb, mint 6,8°C hőmérséklet-emelkedés várható; 1,0 W/kg SAR (egész testes átlagolt specifikus abszorpciói ráta) esetén.

Konfiguráció egyenlő sztent esetében

Lengyelobb hőmérséklet-változás $\leq 6,3^{\circ}\text{C}$ $\leq 6,2^{\circ}\text{C}$

Konfiguráció átfedő szentek esetében

Lengyelobb hőmérséklet-változás $\leq 6,8^{\circ}\text{C}$ $\leq 6,3^{\circ}\text{C}$

MR műtermékek

A nem klinikai vizsgálatokban az eszköz által kiváltott műtermék megközelítőleg 0,7 cm-re terjed a gyártó Nitinol sztentjein túl gradiens-echo és spin-echo impulzussorral készített felvételeken 3T MRI rendszerben.

8. KISZERELÉS

A Nitides eszköz steril kiszerelési (etilén-oxid és CO₂ keverékkel sterilizált), egyszer használatos, és dupla tasakba csomagolt. A tasakok steril területre nem kerülhetnek. **MEGJEZYÉS: a belsejük az egyetlen sterilítési gát.** A sterilitás és a kémiai stabilitás addig garantált, amíg a csomagolás sérülten és amíg a csomagoláson feltüntetett lejárat idő (FELHASZNÁLHATÓSÁG DÁTUMA) le nem járt.

Tartalom: egy (1) Carbofilm™ bevonatú öntáguló Amphilimus™ (Sirolimus+zsírsav) eluáló perifériás sztentrendszer

9. TÁROLÁS

A termék a csomagoláson feltüntetett szabályok szerint, száraz és hűvös helyen kell tárolni; maximum 25°C hőmérsékleten.

10. TÍPUSOK

Minden Nitides eszközt típuskód és téteszám azonosít; a forgalmazott termékódok listája az 1. táblázatban található.

11. GYÓGYSZERADAGOLÁS

Klinikai vizsgálatok alapján a beavatkozás előtt és után trombocitaaggregáció-gátló, a beavatkozás alatt pedig antikoagulációs kezelés alkalmazása szükséges. A trombocitaaggregáció-gátló kezelés az eljárás utáni időszakban a következők alkalmazását jelenti:

- Thienopyridin (ticlopidin, clopidogrel vagy prasugrel) a vonatkozó használati utasításnak vagy az orvosi előírásnak megfelelő dózisokban)
 - Aspirin minimum 100 mg napi dózisban, határozatlan ideig
- Az eljárás összetettsége és a beteg állapotát befolyásoló számos tényező miatt a megfelelő kezelés megvalósítása az orvos megtéltére van bízva.

12. GYÓGYSZERINTERAKCIÓK

Bár specifikus klinikai adatok nem állnak rendelkezésre, bizonyos gyógyszerek, például a Tacrolimus, amelyek ugyanazon kötőfehérjén (FKBP) keresztül fejtik ki hatásukat, a Sirolimus hatékonyságát csökkenhetik. A Sirolimus a CYP3A4 metabolizálja. A CYP3A4 erős inhibitorai a sirolimusexpozíció növelhetik, különösen többszörös beültetés esetén. A Sirolimusnak való szisztemás expozíció akkor is számításba kell veni, ha a beteg egyidejűleg szisztemás immunszuppresszív gyógyszereket szed.

13.A NITIDES TERMÉKKEL FOGLALKOZÓ KLINIKAI VIZSGÁLATOK
A NITIDES fő biztonságosságát és hatékonyságát egy forgalomba hozás előtt végzett, sarkalatos klinikai vizsgálat, az ILLUMINA alapozta meg.
A vizsgálat leírása: Egy többközpontú, egykaros vizsgálatban 100, tüneteket mutató femoropopliteális betegségekben szerevődő, maximum 14 cm-es lézióval rendelkező beteg vett részt, akik NITIDES sztentet kaptak. Az elsődleges hatékonysági (elsődleges ájtárhatalóság) és az elsődleges biztonságossági végpontot (a főbb nemkívánt hatások: halál, a céltott vétag amputációja, a céltott vétag ischemiája, sebészsi beavatkozás szükségesessége vagy a céltott ér sebészsi helyreállítása, vagy a céltott lézió klinikai revaskularizálása, a Rutherford skála romlásá 2 osztállyal, esetleg az 5. vagy a 6. osztállyba sorolódás) a 12. hónapnál összevetették az objektív teljesítményükkel (OPG).
Eredmények: Az eljárás 100%-ban sikeres volt.

A Doppler ultrahang eredményei alapján az elsődleges ájtárhatalóság 87% volt (77/89, 95% konfidencia-intervallum 80-94), ez megfelelt az OPG követelményeinél (73%). A 24. hónápnál az elsődleges ájtárhatalóság 81% volt (63/78).

A 12. hónapnál az elsődleges biztonságossági végpont 96,8% volt (90/93), ez megfelelt az OPG követelményeinél (19,6%). A betegek 2,2%-a (2/93) átesett a lézió klinikai revaskularizációján, 1,1%-uk (1/93) meghalt, 0 esetben került sor a céltott vétag amputációra. 0 esetben került sor sebészsi beavatkozást vagy a céltott ér sebészsi helyreállítását igénylő ischemiára a céltott vétagon, továbbá 0 esetben került sor a Rutherford-skála két osztállyal történő romlására, vagy az 5., illetve a 6. osztállyba sorolódásra.

A 24. hónapnál a biztonságossági végpont 87,8% (79/90) volt. A betegek 6,7%-a (6/90) átesett a lézió klinikai revaskularizációján, 3,3%-uk (3/90) meghalt, 0 esetben került sor a céltott vétag amputációra. 1,1%-uk (1/90) esetében került sor sebészsi beavatkozást vagy a céltott ér sebészsi helyreállítását igénylő ischemiára a céltott vétagon, továbbá 1,1%-uk (1/90) esetében került sor a Rutherford-skála két osztállyal történő romlására, vagy az 5., illetve a 6. osztállyba sorolódásra.

14.HASZNÁLATI UTAZÍTÁS

Eszközválasztás

A sztent szükséges hosszának meghatározásához vegye figyelembe a kezelendő elváltozás hosszát. A lézió megfelelő lefedése érdekében az alkalmazott sztent hossza mindenkorral legalább 5 mm-rel haladja meg magának a léziónak a hosszát.

A megfelelő szenttípus kiválasztásához mérje meg az ér átmérőjét az elváltozáshoz képest proximálisan és disztálisan. A sztent biztonságos behelyezésére érdékben a nagyobb átmérőt vegye alapul a sztent kiválasztása során. A típus kiválasztásához olvassa el az 1. táblázatban foglalt információkat.

Az eszköz előkészítése

A sztent behelyezése előtt adjon heparint a betegnek, és ellenőrizze, hogy a beteg aktivált alvádási ideje megfelel-e az addit központban elfogadott értéknél.

A rendszer előkészítése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a sztent semmilyen folyadékkal ne kerüljön érintkezésbe.

- Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a steril tasakot tartalmazó tasakot.
- Mután ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét, nyissa ki a kúlsz, nem steril alulílusatasokat, majd vegyi ki belsejébe a belső tasakot. (Megjegyzés: Az alulílusatasak és a belső, műanyagtasak kúlsz felszíne **NEM STERIL**. Kizárolága a műanyagtasak tartalma STERIL.)
- Ügyelve arra, hogy a tartószereketől steril környezetben, vízzszentes felületre helyezze, távolítsa el a fogantyú körülvevő szalagot és a katétert védő tekerzetet.
- Ellenőrizze, hogy a vezetőkátkeret nincs-e hurkolódás, megtörés vagy egyéb sérülés. Az eszköz sérülése károsíthatja az eszköz működését.
- Egy 3 mm fecskendőt töltött meg heparint tartalmazó fiziológiai oldattal, csatlakoztasson az öblítéshez használt iuercsalakozóhoz (1. ábra, 12. elem), és alkalmazzon pozitív nyomást. Folytassa az öblítést addig, amíg a fiziológiai oldat meg nem jelenik a katéter disztális végén.
- Vízszála meg a katéter disztális végét, és győződjék meg arról, hogy a sztentet (1. ábra, 4. elem) teljesen beborítja-e a kúlsz hüvely.

Ne használja a sztentet, ha az részlegesen kinyílt vagy bármilyen módon sérült.

Kompatibilitás kiegészítő alkatrészekkel

A NITIDES eszközökkel 6F (2,0 mm) vagy annál nagyobb átmérőjű bevezetőhűvelylek alkalmazhatók.

A NITIDES eszközökkel 0,035 (0,89 mm) vagy annál kisebb átmérőjű vezetődrótok alkalmazhatók. A vezetődrót merevségeinek és a hegy kialakításának megválasztása az orvos klinikai tapasztalata alapján történjen.

Amennyiben vezetőkátkerette van szükség, a rendszerek legalább 8 F (2,7 mm) átmérőjű vezetőkátkerékkel kompatibilisek. Ilyen esetben a kiválasztott egység bevezetése előtt győződjék meg arról, hogy a hemosztatikus szelép teljesen nyitva van.

A sztent behelyezése

- Győződjék meg arról, hogy a fogantyú biztonsági csapja (1. ábra, 10. elem) zárt pozíciójában van (B rész).
- A maradék vér és kontrasztanyag eltávolításához öblítse le a vezetődrót érintett részét heparintartalmú fiziológiai sóoldattal.
- Tolja előre a rendszert a vezetődrótban, amíg a sztent el nem éri a kezelendő területet.

Amennyiben bármikor szokatlan ellenállást észlel, ne erőltesse a rendszer alkalmazását: egyetlen egységként húzza vissza a bevezető hüvelyt, a vezetőkátkeret, valamint az eszközöt. A túlzott erőkifejtés és/vagy nem megfelelő kezelés a sztent véletlen behelyezésével vagy a behelyezőkátkeret sérülésével járhat.

Az eszköz előrejuttatása

- A rendszert addig a pontig vezesse be, hogy a sztent az elváltozáson túl legyen.

b) Húzza vissza a rendszert addig, hogy a sztent az elváltozással egy vonalban legyen.

c) Győződjék meg arról, hogy a bevezetőrendszernek a beteg szervezetébe be nem vezetett része szabadon ki van nyújtva és egynes.

Övvételekedés: amennyiben a bevezetőrendszer nincs megfelelően kinyújtva, a sztent a célzott elváltozásra túl helyeződhet el.

A sztent elhelyezése és tágítása

a) Egyik kezével határozottan ragadjá meg a fogantyút, győződjék meg arról, hogy a sztent sugár fogó jelölései az elváltozáshoz képest proximálisan és disztálisan helyezkednek el.

b) Győződjék meg arról, hogy a sztent elhelyezése közben a bevezetőhűvel nem mozog.

c) A kinyitáshoz (1. LÉPÉS) fordítja el a biztonsági csapot a fogantyún az óraművet járásával ellentétesen (1. ábra, B rész), majd húzza ki teljesen (2. LÉPÉS).

d) A fogantyú a beteghez képest rögzített pozícióból tartva még egyszer győződjék meg arról, hogy a sugár fogó jelölések az elváltozáshoz képest a kívánt pozícióból vannak; kezdje meg a sztent elhelyezését úgy, hogy a kereket (1. ábra, 9. elem) hüvelykujával elfordítja a nyíl irányába, az 1. ábrán látható módon.

e) Fluoroszkópiai alatt (miközben a sztent disztális vége jól kapcsolódik az érfalhoz) folytassa a behelyezést a kerék elfordításával, amíg a sztent vége ki nem nylik és teljesen be nem ágyazódik az érfalba.

f) Ha gyors behelyezésre van szükség, tegye a következőket: győződjék meg arról, hogy nincsenek elzáródások (pl. a belső menetes luercsallakozó el van csavarva) a fogantyú hátsó végén, a másik kezével ragadjá meg az eszköz hátsó végét (vízzuházás, 1. ábra, 11. elem) és húzza, az elülső részt a beteghez képest tökéletesen mozdulatlanul tartva, ahogyan az 1. ábrán látható.

g) Fluoroszkópiai alatt ellenőrizze, hogy a sztent teljesen kinyilt-e.

h) Szükség esetén a sztent PTA ballonkátkerére segítségettekkel tovább tágítható. A ballonkátkerére átmérőjének kiválasztásakor és az utólagítás elvégzésekor az angiogrammával meghatározott ératmérőt vegye alapul. mindenkepp kerülje a sztent a címkén feltüntetett, névleges átmérőn túli tágítását.

i) A sztent végleges átmérőjének meg kell felelnie a referenciaér átmérőjének.

15.LEHETSÉGES NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK

Alehetőséges, a periferiás szent beültetésével kapcsolatba hozható mellékhatások között szerepelnek a perkután transzliniális angioplastika (PTA) kockázatai és további, az alábbiakban részletezett, a sztent használataival kapcsolatos kockázatok.

- A beültetési helyelforzódése, fájdalom és hematoma
- Allergia reakció kontrasztanyagra, az eljárás során használt gyógyszerekre vagy a sztent alkotó anyagokra, vagy a fentiekkel kapcsolatos nemkívánt hatások
- Arteriás paszmus
- Artériás vagy a sztentben jelentkező trombózis
- Femoralis arteriaaneurizma vagy pszeudoaneurizma
- Disztális atherosklerotikus embolizáció
- Vérzés
- Halál
- A sztenteltér disszzekciója, perforációja vagy ruptúrája
- Embolia
- Veseelégtelenség
- Alsó vétagi iszkémia (amely sebészsi beavatkozást igényel)
- Az arteria reszenzitózisa, amelybe a sztent beültetése történt
- A sztent embolizációja
- Az ér elzárása vagy megoldatlan szükület

16.FELELŐSSÉG ÉS JÓTÁLLÁS

A Gyártó biztosítja, hogy az eszközt a lehető legnagyobb gondossággal terveztek, gyártották és csomagolták, a jelenleg rendelkezésre álló legfejlettebb technikával; valamint a tervezés és a gyártás során végig belartatták azon integrált biztonsági előírásokat, amelyek biztosítják a termék biztonságos használatát a meghatározott feltételek mellett, a meghatározott indikációra történő alkalmazás során és a fentiekben leírt rendelkezések betartása mellett; minden a lehető legnagyobbra mértékben csökkeneti, de nem teljesen zára ki az eszköz használatával kapcsolatos kockázatokat.

Az eszköz kizárolága szakképzett egészségügyi személyzet felelősségvállalásával használható, a jelen használati utasítás más fejezeteiben említett rendeltekesszerű használatához addigi bármilyen reziduális kockázat, lehetséges mellékhatás és szövődmény figyelembevételével.

Az eszköz használatával kapcsolatos technikai összetettségből, a kezelésre vonatkozó döntések kritikus jellegéből és az alkalmazott módszerekből adódóan a Gyártó nem áll módjában arra vonatkozóan hallgatólagos vagy kifejezetten garanciát nyújtani, hogy az eszköz használata hatékony kezelést biztosít, illetve hatékony javítja a beteg állapotát, vagy megold bármilyen egyéb patológiai vagy orvosi problémát. Valójában az eredmények, mind klinikai szempontból, mind pedig az eszköz funkcionálisát és élettartamát tekintve, számos olyan tényezőtől függnek, amelyek kiül esnek a gyártó hatásáról; a teljeség igénye nélkül néhány példa: a beteg állapotá, a beültetéskor alkalmazott sebészeti eljárás, az eszköz használata, az eszköz manipulálása a csomagolás felbontását követően. Ezeken tényezők fényében a gyártó felelőssége csak akkor áll fenn, ha megbizonyosodtak arról, hogy az eszköz hibái már a forgalomba hozatal idején fennállnak. E célból az Ügyfélnél haladéktalanul a Gyártó rendeltekessére kell bocsátania a készüléket a törvény által előírt lejárat és egyéb feltételek betartásával; a Gyártó fenntartja a jogot, hogy megvizsgálja a hibásnak ítélt eszközöt, és megállapítja, hogy ténylegesen vannak-e olyan hibák, amelyek befolyásolhatják a termék biztonságát. A következő esetekben kizárt a gyártó felelőssége: (i) a jelentett hiba oka, hogy az eszköz megfelel egy kötelező érvényű szabálynak vagy egy kötelező érvényű rendelkezésnek, és/vagy (ii) a kár okozó nem állt fenn, amikor a gyártó kiadta az eszközöt, és/vagy (iii) hiba a műszaki és tudományos ismeretek abban az időben, amikor a gyártó kiadta az eszközöt, még

nen tettéből lehetővé, hogy az eszköz hibásnak minősüljön, és/vagy (iv) ideátozók bármely más, a fentiekkel eltérő eset is, amelyben a törvény kifejezetten kizárá vagy korlátozza a gyártó felelősséget a hibás termékhekből eredő károkért. A jótállás kizárából a hibás eszköz egy gyártó által gyártott, az eszközzel azonos vagy egyenértékű eszközre való cseréjére vonatkozik.

A jótállás kizárából akkor érvényesíthető, ha az eszköz a Gyártó részére megfelelő csomagolásban és a talált hibákrol szóló, illetve beültetett eszköz esetén a szervezetből való eltávolítás okait feltáró részletes, írásbeli jelentést mellékelve visszajuttatták. A reklámánál kívánt hibákat azonnal jelenteni kell a Gyártónak, az elvülés és a törvény előírás figyelembevételével.

A csere elvégzése után a Gyártó megtéríti az Ügyfélnek az elismerten hibás eszköz visszaszolgáltatása során felmerülő költségeit.

A Gyártó nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a jelen használati utasításban foglalt használati utasítások vagy övintézkedések terén mulasztás történt, vagy az eszköz a csomagoláson feltüntetett lejáratú idő után használták fel.

Továbbá a Gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a kezelésre és az eszköz használati vagy alkalmazási módjára vonatkozó orvosi döntések következményeiért, ennek értelmében semmilyen körülmenyek között nem vonható felelősségre az eszköz alkalmazásából és a felhasználó által választott implantációs technikából származó semmilyen anyagi, biológiai vagy morális kár vonatkozásában.

A gyártó megbízottainak és képviselőinek nincs felhatalmazása sem a jelen jótállás fent említett feltételeit módosítani, sem további kötelezettség- vagy garanciaellátást tenni a termékre vonatkozóan az itt kikötöttekben túl. Ez a garanciát az olasz törvények szabályozzák, kivéve, ha egy másik állam hatállyó törvényeit alkalmazzák abban az esetben, ha a gyártó engedélyezte a termék forgalmazását Olaszországon kívül egy vagy több államban.

LATVISKI

NITIDES

automātiski izplešamā Amphilius™ (Sirolimus+taukskābes) izdalošā perifērā stenta sistēma ar pārkājumu „Carbofilm™“

1. IERĪCES APRAKSTS

Ierīci saime NITIDES sastāv no automātiski izplešama stenta un ievades sistēmas stenta pareizai novietošanai un ievadei.

Stents ir lokana un automātiski izplešama implantējamā ierīce. Ierīce ir veidota no nikelā un titāna sakausējuma (nitinolu), un tai ir „Carbofilm™“ pārkājums — plāns oglekļa slānis, kura blīvā turbostratiskā struktūra ir tāda pati kā pirotlītiskajam ogleklim. Uzklājot pārkājumu pamatlaterālam, tam tiek piešķirtas pirotlītiskā oglekļa bioloģiskās un asins saderības īpašības, neitekmējot pamatlaterāla fiziskās un strukturālās īpašības.

Uz stenta ir izvietoti seši starojuma necauarlaidīgi tantala markieri (trīs katrā galā), kas sniedz iespēju pareizi novietot stentu novēršamā bojājuma vietā. Arēja stenta virsmā ir rievas, kas pilnībā klātas ar „Carbofilm™“, lai saturētu farmaceitisko formulu Amphilius™, kas sastāv no medikamenta Sirolimus un garo kēzu taukskābju maišajuma.

Specifiskā medikamenta deva ārstējamajai asinsvada virsmai ir apmēram 0,9 µg/mm², kas atbilst minimālajai devai 270 µg, lietojot mazāko stentu (6,0 x 20 mm), un maksimālajai devai 2420 µg, lietojot lielāko stentu (8,0 x 150 mm).

Tiek izmantota stieples ievades sistēma, kas sniedz iespēju droši novietot un izvadīt stentu bojājuma vietā. Tā ir shematiški attēlota 1. attēlā, un to veido:

- katētra korpus (7) ar diametru 6F, kas sastāv no:
 - izvelkama arēja apvalka, distālās, daļēji caurspīdgās dajās (3), kura satur stentu (4); netālu no katētra gala apvalkam ir starojuma necauarlaidīga manēze (13);
 - iekšējā lūmena, kas sastāv no apvalka (6) un iekšējās caurulītes (2), kas ir saderīga ar 0,035 collu vadītājsīgu. Iekšējais lūmens stiepijas caur katētru no luer tipa savienotāja (12), kas atrodas proksimālā no roktura, un distālā beidzis galā (1) starojuma necauarlaidīgā materiālā, lai, skatoties attēleidošanas sistēmā, varētu noteikt stenta novietojumu. Iekšējā lūmenā atrodas atdure (5), kas novēr stenta pārvietošanos gareniskā virzienā arēja apvalka izvilkšanas laikā;
 - rokturis (8) ar ievades sistēmu, kas nodrošina katētra novietošanu un stenta ievadi in situ.

Roktura konstrukcija ir ergonomiska, laujot lietojātam satvert un lietot rokturi pat ar vienu roku. Roktura proksimālajā galā atrodas luer tipa atvere (12), kas tiek lietojota vadītājsīgas lūmena izskalošanai, drošbas atslēga (10), ritenis (9) un atvilkšanas astē (11).

Razotājs patie veic perifērā stenta un ievades katētra sistēmas rāzošanu un kā rāzošanas laikā, tā arī gatavojāma izstrādājumiem veic visas kvalitātes kontroles procedūras saskaņā ar labas rāzošanas prakses vadlīnijām.

2. IERĪCES PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Automātiski izplešamā perifērā stenta sistēma ir paredzēta tādas perifēro artēriju slimības ārstēšanai, kas ieteikmē virsējo cikas artēriju un proksimālo pacēles artēriju.

3. IERĪCES LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

Ierīce ir indiçēta cikasas un pacēles artēriju stenozes ārstēšanai visi ceļa pieaugušiem simptomātiskiem (Rutherford kategorija 2–5) pacientiem. Ārstējamā bojājuma garums nedrīkst pārsniegt 14 cm, tam jābūt okluzētam vai ar stenozi, kas pārsnedz 50%, de novo vai ar atkārtotu stenozi, kas iepriekš nav ārstēta ar stentu.

4. KONTRINDIKĀCIJAS

Stenta izmantošana ir kontrindicēta šādos gadījumos:

- Bojājumus never novērst, izmantojot PTA vai citas kirurgiskas iejaukšanās metodes.
- Sievietēm stāvoklī vai sievietēm, kas baro ar krūti.
- Bojājumi atrodas pacēles artērijas divas distālajās trešādās vai ceļa locītavā.
- Pastāv medicīniski nosacījumi, kas ierobežo antītrombotiskās un/vai antikoagulantu terapijas veikšanu.

5. BRĪDINĀJUMI

- Nav ieteicams izmantot ierīci pacientiem ar zināmu hipersensitivitāti vai alerģijām pret Sirolimus, taukskābēm (piem., stearīnskābēm, behenskābēm) vai stenta sastāvdajām, kas izgatavotas no metāla (piem., niķelja, titāna un tantala).
- Ierīce ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Nelietot, neapstrādāt un nesterilizēt atkārtoti. Pretējā gadījumā var rasties ierīces kontaminācijas risks un/vai pacienti var tikt inficēti, var rasties iekaisums un no viena pacienta otram var tikt nodotas infekcijas slimības.
- Ierīce ir izstrādāta, lai darbotos kā sistēma. Tās sastāvdajās nedrīkst izmantot atsevišķi.
- Nelietojet ierīci, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts, nepareizi uzglabāts vai ir beidzies ierīces derīguma termiņš. Šādos gadījumos netiek garantēta izstrādājuma sterilitāte.
- Ierīci drīks izmantot tikai ārsti, kas ir īpaši apmācīti veikt perkutānā transluminālās angioplastījas (PTA) un perifērā stenta ieviešošanas procedūras.
- Ja jebkurā ievades procedūras laikā ir jūtama pretestība, nebūdēt sistēmu tālāk ar spēku; izvelcet stenta sistēmu, visu ievades katētru, vadītājsīgu un ievadītāju kā viendalīgu ierīci. Pārmērīga spēka lietošanas un/vai nepareizas rīcības dēļ stents var tikt netīši ievietots vai var tikt bojāts ievades katētrs.
- Jebkura brīdi procedūras laikā nepareiza rīcība var izraisīt asinsvada plīsumu, caurduršanu vai pārrāvumu.
- Ieviešošanas laikā nebūdēt stenta sistēmu uz priekšu vai atpakaļ; tā var nopietni savainot asinsvada sieniņas.

- Automātiski izplešama stenta implantēšana var izraisīt asinsvada disekciju distālāi un/vai proksimālo nonākumā, kā arī var izraisīt pēkšņu asinsvada nosprostošanos, kad nepieciešama papildu kirurgiska iejaukšanās (kirurgiska asinsvada nomaina operācija, turpmāka asinsvada paplašināšana, papildu stenta ieviešanā vai citas procedūras).
- Ja stents ir daļēji ievietots, to vairs nevar izņemt, izmantojot ievades sistēmu.

6. PIESARDĪBAS PASĀKUMI

- Stenta izplešanas sākumā **nekad nelietojet** ātrās palaišanas sistēmu. Izmantojiet šo sistēmu **tiem, kuri nepieciešamības gadījumā** pēc tam, kad ir ievietota **vismaz puse no stenta garuma**.
- Ar ierīci jārkojas, joļi piesardzīgi, lai tā nesaskartos ar metāliskiem vai abrazīviem instrumentiem, kas varētu bojāt savojāt vai izraisīt mehāniskas izmaiņas.
- Pirms sagatavošanas un novietošanas ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrumiem.
- Ierīces novietošanas sistēma nav paredzēta izmantošanai ar kontrastvielas inžektoriem.
- Ja tiek implantēti vairāki stenti kopā, attiecīgajiem starojuma necaurlaidīgajiem markieriem ir jāpārkājas. Pārkāšanās nedrīkst ietvert vairāk par diviem stentiem.
- Ja stentī pārkājas, ieteicamais pārkāšanās garums ir mazāks par 20 mm.
- Lai nesabojātu stentu, ievērojet tās piesardzību, ja vadītājsīga, balonkatetrs vairāk nevis citā ierīce ir jāizvada caur tikkō izplestu stentu.

7. INFORMĀCIJA PAR MRI DROŠUMU

Nekliniskā pārbaudē tika konstatēts, ka ražotāja Nitonola stentu izstrādājumi ir droši MR vidē noteiktos apstākjos. Pacientu ar šādu ierīci var droši skenerēt MR sistēmā, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

- Statiski magnētiskais laiks 1,5 tesla (1,5 T) vai 3 tesla (3 T)
- Maksimālais telpiskais gradients ir 6,140 G/cm (61,40 T/m)
- MR sistēmas ziņojatis maksimālais visa ķermeņa vidējais specifiskais absorbcijas rādītājs (SAR):
 - 1 W/kg (normāls ekspluatācijas režīms) pie 1,5 T
 - 1 W/kg (normāls ekspluatācijas režīms) pie 3 T

Sasīšana RF laikā

Iepriekš definētajos skenēšanas apstākļos ir sagaidāms, ka ražotāja Nitonol stentu izstrādājumu līnijās maksimālais temperatūras paleiņajums nepārsniedz 6,8 °C pēc 15 minūtēm nepārtrauktas skenēšanas MR sistēmā, visa ķermeņa vidējais specifiskais absorbcijas rādītājs (SAR) 1,0 W/kg.

	1,5 T	3 T
Viena stenta konfigurācija		
Augstāka temperatūras izmaiņa	≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
Konfigurācija ar stentu pārkāšanos		
Augstāka temperatūras izmaiņa	≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C

MR artefakts

Nekliniskās pārbaudēs ierīces radītās attēla artefakts sniedzas aptuveni 0,7 cm no ražotāja Nitonol stentiem, iegūstot attēlu gradiента ehoimpulsa un rotācijas ehoimpulsa secībā 3 T MRI sistēmā.

8. PIEGĀDES VEIDS

NiTIDES ierīce tiek piegādāta sterila (izmantojot etilēnoksīda un CO₂ maisījumu), ir paredzēta vienreizējai lietošanai un ar ietsevišķu iepakojuma dīvos maisījumiem, kas nedrīkst nonākt sterīlā vidē. **PIEZĪME: iekšējais maisījīš ir vienīgā sterīlā barjera.**

Ja iepakojums netiek atvērts vai bojāts, sterilitāte un kīmiskā stabilitāte tiek garantēta līdz derīguma termiņa beigu datumam (DERĪGUMA TERMIŅA BEIGU DATUMS), kas uzsdrukus uz iepakojuma.

Satus: viena (1) automātiski izplešamā Amphilimus™ (Sirolimus+taukskābes) izdalīša perifērā stenta sistēma ar pārkājumu zCarbofilm™

9. GLABĀŠANA

Izstrādājums jāglabā atbilstoši norādījumiem uz iepakojuma: vēsā un sausā vietā, glabāšanas temperatūra maks. 25 °C.

10. MODELI

Katrai ierīcei NiTiDES ir piešķirts modeļa kods un partijas numurs; pieejamie izstrādājumi kodi ir norādīti 1. tabulā.

11. MEDIKAMENTU LIETOŠĀNA

Saskāņā ar medicīniskā literatūru publicētajiem pētījumiem pirms operācijas ir jāveic antitrombotiskā terapija, procedūras laikā ir jāveic antiokagulantu terapija, un pēc operācijas atkāl ir jāveic antitrombotiskā terapija.

Antitrombotiskā terapijas ietvars pēcoperācijas periodā pacientam ir jāsaņem šādi medikamenti:

- tienopirodinis (tioklopodīns vai klopodogrelis, vairi prasugrels devas, kas norādītas attiecīgajās instrukcijās brošūrās vai atbilstoši ārsta norādījumiem)
- aspirīns, minimālā deva 100 mg/dienā uz ne noteiktu laiku

Nemot vērā procedūras sarežģītību un daudzus pacienta stāvokli ietekmējošos faktorus, ārstam pēc savieni ieskatiem ir jānosaka piemērotākā terapija.

12. MIJEDARBĪBA AR ZĀLĒM

Lai gan nav pieejami specifiski medicīniskie dati, dažas zāles, piemēram, takrolīns, kas darbojas ar to pašu saistošo proteinu (FKBP), var ietekmēt Sirolimus iedarbību. Sirolimus metabolīzē enzīms CYP3A4. Stipri CYP3A4 inhibitori var izraisīt lielāku Sirolimus iedarbību, iepriekš gadijumos, kad ir ievietoti vairāki implantāti. Jāapsver pakļaušana sistēmiskai Sirolimus iedarbībai, ja pacients vienkārši saņem sistēmiskos iemūnsupresīvos medikamentus.

13. KLINISKI IZMĒGINĀJUMI AR NITIDES

NiTIDES stenta pamatdrošība un efektivitāte tika noteikta bāzes kliniskajā pētījumā ILLUMINA pirms izstrādājuma ieviešanas tirgū.

Pētījuma apraksts. Daudzcentru nerandomizētā pētījumā NITIDES stents tika ievietots 100 pacientiem ar simptomātisku cikšķu un paceles arteriju slimību ar maksimālo bojājumu garumu 14 cm. Primārā efektivitāte (primārā skaidrība) un primārās drošības galapunkts (no pieņemtā blakuspārādību apkokojums: nāve, mērķa locekļa amputācija, mērķa locekļa išēmija, kad nepieciešama kirurgiska iejaukšanās vai mērķa asinsvada ārstēšana kirurgiskā veidā, vai kliniski noteikta mērķa bojājuma revaskularizācija, Rutherford rādītāja pasliktināšanās par 2 klasēm vai līdz 5. vai 6. klasēi) tika salīdzināti ar objektīvu snieguma mērķa rādītāju (Objective Performance Goal, OPG) pēc 12 mēnešiem.

Rezultāti. Procedūra bija veiksmīga 100% gadījumu.

Dopēra ultraskājas izmeklējumos tika iegūta primārā skaidrība 87% (77/89, 95% ticības intervals 80–94%), kas atbilst OPG prasībām (73%). Primārā skaidrība 24 mēnešu periodā bija 81% (63/78).

Primārās drošības galapunkts pēc 12 mēnešiem bija 96,8% (90/93), kas atbilst OPG prasībām (19,6%), 2,2% (2/93) pacientu bija kliniski noteikta mērķa bojājuma revaskularizācija, 1,1% (1/93) nomira, 0 bija mērķa locekļa amputācija, 0 bija mērķa locekļa išēmija, kad nepieciešama kirurgiska iejaukšanās vai mērķa asinsvada ārstēšana kirurgiskā veidā, un 0 bija Rutherford rādītāja pasliktināšanās par divām klasēm vai līdz 5. vai 6. klasēi.

24 mēnešu drošības galapunkts bija 87,8% (79/90), 6,7% (6/90) pacientu bija kliniski noteikta mērķa bojājuma revaskularizācija, 3,3% (3/90) nomira, 0 bija mērķa locekļa amputācija, 1,1% (1/90) bija mērķa locekļa išēmija, kad nepieciešama kirurgiska iejaukšanās vai mērķa asinsvada ārstēšana kirurgiskā veidā, un 1,1% (1/90) bija Rutherford rādītāja pasliktināšanās par divām klasēm vai līdz 5. vai 6. klasēi.

14. LIETOŠĀS NORĀDĪJUMI

Ierīces izvēle

Lai noteiktu nepieciešamā stenta garumu, izmēriet novēršamā bojājuma garumu. Lai atbilstoši nokļūtu bojājumu, izmantotajam stentam abās pusēs jābūt vismaz par 5 mm garākam par pašu bojājumu.

Nomēriet asinsvada diametru pirms un aiz bojājuma, lai noteiktu atbilstoša stenta izmēru. Lai pārliecinos, ka stents tiek novietots droši, kā bāzi atbilstoša stenta izmēra izvēle izmantojiet lielāko diametru. Izvēloties modeli, skaitiet 1. tabulā sniegtā informāciju.

Ierīces sagatavošana

Pirms stenta ievades procedūras ievadiet heparīnu un pārbaudiet, vai pacienta aktivitāts rečesānas laiks (Activated Clotting Time, ACT) ir adekvāts saskaņā ar centra praksi.

Sistēmas sagatavošanas laikā iepriekš uzmanīties, lai stents nesaskartos ne kādu šķidrumu.

a) Atveriet iepakojumu kārbu un izņemiet maisījumu, kurā ir sterilais maisījums.

b) Vispirš pārbaudiet, vai iepakojums nav bojāts, tad atveriet ārējo nesterilo aluminijs folijas maisījumu un pēc tam izņemiet saturu no iekšējā maisījuma. (Piezīme: aluminijs folijas maisījīš ir labi plāstmas maisījums ar ļoti vārītu NAV STERILI. Tikai plāstmas maisījums satur STERILIS.)

c) Sterilajā zonā uz līdzēnas virsmas uzmanīgi novietojiet balstu, atspāržējiet lenti, kas ir ap rokturi, un izņemiet saturu no aizsargapvalka.

d) Pārbaudiet, vai ievades katetrs nav savījies, sailekti vai citādi bojāts. Ierīces bojājumi var nelabvēlīgi ietekmēt tās darbību.

e) Piepildiet 3 ml ūjari ar heparīnu saturošu fizioloģisko šķidrumu, pievienojiet ūjari luer tipa savienojumam, kas piemērots skalošanai (1. attēls, 12. elements), un pieletiņot pozitīvu spiedienu. Turpiniet skalošanu, līdz fizioloģiskais šķidums izplūst no katetra distālā gala.

f) Pārbaudiet katetra distālo galu un pārliecīnieties, vai ļērējais apvalks pilnībā sedz stentu (1. attēls, 4. elements).

Ja stents ir daļēji izpleties vai jebkādā veidā bojāts, nelietojet ierīci.

Saderība ar piederošiem

Ar NiTiDES ierīci var izmantot ievadītāja apvalku ar diametru 6F (2,0 mm) vai lielāku.

Ar NiTiDES ierīcēm var izmantot 0,035 collu (0,89 mm) vai mazākas vadītājsīgas. Vadītājsīgas cietības un uzgaja konfigurācijas izvēle ir atkarīga no ārsta medicīniskās pieredzes.

Ja ir nepieciešams izmantot virzīšanas katetu, sistēmas ir saderīgas ar 8F (2,7 mm) vai lielāku diametra virzīšanas katetriem. Šāda gadījumā pirms izvēlētās sistēmas ievēlei pārliecīnieties, vai hemostāzes vārsti ir pilnībā atvērti.

Stenta ievadišana

a) Pārliecīnieties, vai roktura drošības atslēga (1. attēls, 10. elements) atrodas bloķētā pozīcijā (detalizēta attēls B).

b) Nomazgājiet vadītājsīgas atslēgu daļu ar heparīnu saturošu fizioloģisko šķidrumu, lai no tās notirītu asins un kontrastvielas paliekas.

c) Bidet sistēmu pa vadītājsīgu, līdz stents sasniedz novēršamā bojājuma vietu. Ja jebkār laikā ir jutāma neparausta pretestība, nebiedet sistēmu ar spēku; izvelciet ievadītāju, vadītājsīgu un ierīci kopā kā vienu vienību. Pārmērīga spēka ietekmēs asins un/vai nepareizes rīcības dēļ stents var tikt netīši ievietots vai var tikt bojāts ievadītāju.

Ierīces virzīšana

a) Virziet sistēmu, līdz stents atrodas aiz bojājuma.

b) Pavelciet sistēmu atpakaļ, līdz stents atrodas bojājuma vietā.

c) Pārbaudiet, vai ārpus pacienta ķermeņa esošā ievades sistēmas daļa ir brīvi izstiepta un novērēta taisni.

Uzmanību! Ja ievades sistēma nav pareizi izstiepta, stents var tikt netīši ievietots vai var tikt bojāts ievadītāju.

Stenta ievietošana un izplešana

a) Ar vienu roku ciēsi satveriet rokturi un pārbaudiet, vai starojuma necaurlaidīgie stenta markieri atrodas proksimāli un distāli no bojājuma.

b) Nodrošiniet, lai stenta ievietošanas laikā ievadītāja apvalks nekustētos. C) Piegriezt roktura drošības atslēgu (1. attēls, detalizēta attēls B) pretēji

- pulksteprādītājā kustības virzienam, lai to atbloķētu (1. DARĪBA), tad pilnībā būt izvēlēt (2. DARĪBA).
- d) Turiet rokturi fiksētā pozīcijā attiecībā pret pacientu, vēlreiz pārbaudiet, vai starojuma necaurlaidīgais markierji attiecībā pret bojājumu atrodas vēlamajā vietā, tad sācīt stenta ieviešanu, ar tākšķī pagriežot riteni (1. attēls, 9. elements) bultīnas norādītājā virzienā, kā redzams 1. attēla.
- e) Fluoroskopijas kontrole, kad stenta distālais gals ir labi nospiņājies pie asinsvada sieninām, turpiniet stenta ieviešanu, griežot riteni, līdz stenta gals ir atvērts un stents ir pilnībā implantēts asinsvada sieninā.
- f) Ja stents jāievieto strauji, rikojieties šādi: pārliecībēties, ka roktura aizmugurejā galā nav nosprostojumu (piem., aptverošais luer tipa savienotājs ir ieskrūvēts), ar otru roku satveriet ierīces aizmugurejo galu (pavelciet atpakaļ); 1. attēls, 11. elements) un velciet to, vienlaikus turrot roktura priekšējo galu attiecībā pret pacientu pilnīgi nekustiņu, kā parādīts 1. attēla.
- g) Ar fluoroskopijas palīdzību pārbaudiet, vai stents ir pilnībā izplests.
- h) Ja nepieciešams, stentu var izplest vēl vairāk, izmantojot PTA balonkatetru.
- Izvēloties balonkatetra diametru un veicot papildu izplešanu, nemiet vērā asinsvada diametru, kas ir apmeklēts, izmantojot angiogrāfiju. Jebkurā gadījumā ievērojet ipašu piesardzību, lai neizplestu stentu vairāk par uzlīmē norādotu nominālo diametru.
- i) Stenta beigu diametram ir jāatbilst asinsvada atsauces diametram.

15. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tālāk norādītas iespējamās blakusparādības, kas varētu būt saistītas ar perifērā stenta implantāciju, ietver riskus, kas saistīti ar perkutāno transluminālo angioplastiju un papildu riskus, kas saistīti ar stentu lietošanu.

- Infekcija pieklubes vietā, sāpes un hematoma
- Alerģiska vai nevēlāma reakcija uz kontrastvielu, procedūras laikā izmantojot medikamentiem, stentu veidojošajiem materiāliem
- Arteriju spazma
- Arteriālā vai stenta tromboze
- Femorālās arterijas aneirisma vai pseidoaneirisma
- Aterosklerotiskā distāla embolizācija
- Asipošana
- Nāve
- Tā asinsvada, kurā ir ievietots stents, plūsums, perforācija vai pārrāvums
- Embolija
- Nieru atteice
- Apakšējo ekstremitāšu išemija (ar nepieciešamu ķirurģisku iejaukšanos)
- Arterijas, kurā tika implantēts stents, restenoze
- Stenta embolizācija
- Asinsvada nosprostošanās vai neatrisināta stenoze

16. SAISTĪBAS UN GARANTIJA

Ražotājs apliecinā, ka šī ierīce ir iespējami rūpīgi izstrādāta, izgatavota un iepakota, izmantojot vispiemērotākās no pašreizējā tehnoloģijā attīstītās līmenī pieejamajām metodēm, un ka ierīces izstrāde un ražošanā ir piemēroti drošības integrācijas standarti, kas garantē drošu ierīces lietošanu, ja tā tiek lietota atbilstoši norādītajiem nosacījumiem un mērķiem, kā arī ievērojot iepriekšējās sadajās minētos piesardzības pasākumus, kas paredzēti, lai pēc iespējas samazinātu, lai arī ne pilnībā novērst ar ierīces lietošanu saistītos riskus.

Ierīci drīkst lietot tikai kvalificēti medicīniski speciālisti, nemot vērā visus atlikušos riskus vai iespējamās blakusparādības un komplikācijas, kas var rasties ierīces paredzētā lietojuma laikā, tostarp visu, kas minēts citās šī norādījumu bukleta sadās.

Nemot vērā ar ārstēšanu saistīto lēmumu, kā arī ierīces lietošanas metodes procedūras tehnisko sarežģītību un svarīgumu, ražotājs nevar būt ne tieši, ne netieši atbildīgs par sekmīgu rezultātu, gan kliniskajā zinā, gan arī attiecībā uz ierīces funkcionālitati un izmantošanas ilgumu, ietekmē vairāki citi faktori, ko ražotājs nespēj ietekmēt, tostarp tādi, kas ir norādīti tikai kā piemēri un nevar visaptveroši aprakstīt pacienta slāvokli, implantēšanai vai izmantošanas ķirurgisko procedūru un ierīces izmantošanas metodes pēc iepakojuma atvēršanas.

Nemot vērā šos apstākļus, ražotāja atbildība ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja ir pierādīts, ka ierīci ir ietekmējuši defekti, kas tai bija brīdi, kad ierīce tika palaista aprite. Tādā gadījumā klientam jānogādā ierīce ražotājam atbilstoši likumā noteiktajiem atgriešanas termiņiem un noteikumiem; ražotājs patur tiesības izpētīt ierīci, kas norādīta kā bojata, un pieņemt lēmumu par to, vai tai patiešām ir defekti, kas varētu ietekmēt izstrādājuma drošību. Ražotāja atbildību nav piemērojama, ja (i) bojājums, par kuru pieteikums, radies tāpēc, ka ierīce atbilst kādam obligātam noteikumiem vai saistīšo prasībai, un/vai (ii) defekts, kas izraisīja bojājumus, nepastāvēja brīdi, kad ražotājs izlaida ierīci, un/vai (iii) ja tehnisko un zinātnisko zināšanu līmenis laikā, kad ražotājs izlaida ierīci, nejāva uzskatīt ierīci par bojātu, un/vai (iv) jebkura citā gadījumā, arī tad, ja tas atšķiras no iepriekš norādītajiem, kad tiesību akti skaidri izslēdz vai ierobežo ražotāja atbildību par bojājumiem, ko izraisījuši izstrādājumi ar defektiem. Garantija attiecas tikai uz bojātās ierīces nomaiņai pret citu ražotāju nodrošinātu identisku vai līdzvērtīgu ierīci.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja ražotājam ierīce tiek nogādāta pareizā veidā un tai ir pievienoti dokumenti, kurā rakstiski ir sniegti detalizēti defektu apraksts, kā arī ir norādīts iemeslis ierīces izņemšanai no pacienta ķermena, ja ierīce ir tikusi implāntēta. Par norādītajiem defektiem ražotājam ir jāzīsto pareizā veidā, saskaņā ar atsavināšanas noteikumiem un likumā noteiktajām prasībām.

Pēc izstrādājuma nomaiņas ražotājs segs klientam visas izmakas, kas radušas saistībā ar atzītās bojātās ierīces atgriešanu.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par šajā norādījumu rokasgrāmatā norādīto lietošanas metožu un piesardzības pasākumu neievērošanu un ierīces lietošanu pēc derīguma termiņa beigām, kas ir norādīts uz iepakojuma.

Turklāt ražotājs neuzņemas nekādu gadījumā nav atbildīgs ne par kāda veida zaudējumiem (materiāliem, bioloģiskiem vai morāliem), kuru iemeslis ir ierīces lietošana un lietotāja izvēlētā implantēšanas metode.

Ražotāja aģenti un pārstāvji nav pilnvaroti mainīt kādus iepriekš norādītos šīs garantijas nosacījumus, uzņemties papildu saistības vai piedāvāt garantijas saistībā ar šo izstrādājumu, izņemot iepriekš minētās. Attiecībā uz šo garantiju noteicōšā ir ītājas likumdošana, izņemot gadījumus, ja tiek piemēroti citas valsts obligāti ievērojamie tiesību akti, ja ražotājs ir apstiprinājis izstrādājuma pieejamību vēl kādā citā valstī vai valstīs ārpus Ītālijas.

LIETUVIŲ KALBA

„NiTiDES“

„Carbofilm™“ padengta savaime išspiečianti „Amphilimus™“ (sirolimas+riebalinė rūgštis) išskirianti periferinio stento sistema

1. JTAISO APRAŠYMAS

„NiTiDES“ Seimos įtaisus sudaro savaime išspiečiantis stentas ir įterpimo sistema, skirta tinkamam jo įterpimui ir įvedimui.

Stentas – tai lankstus, savaime išspiečiantis implantuojamas įtaisas. Jis pagamintas iš nikelių ir titanio litinio (nitinolio) ir padengtas „Carbofilm™“ – plonu anglies sluoksniu su tankia tūrostatine struktūra, iš esmės tapačia pirolitinės anglies struktūrai.

Danga sutelkia substratui pirolitine angliai būdingo biologinio ir hematologinio suderinamumo, o paties substrato fizinės ir struktūrinės savybių nepakinta.

Ant stento yra šeši rentgeno spinduliams nepralaids tantalo žymekliai (iekviename gale po tris), pagal kuriuos stentas tinkamai įterpiamas į pažėdimo vietą.

Išorinis stento paviršius yra su specialiais visiskai „Carbofilm™“ padengtais grīoveliais, kuriuose yra farmacines formos „Amphilimus™“, sudarytasis iš vaisto sirolimo ir ilgos grandinės riebalių rūgštis mišinio.

Konkreči vaistų dozė, skirta gydomos kraujagyslės paviršiui, yra maždaug 0,9 µg/mm², atitinkanti minimalią 270 µg mažesnio stento (6,0 x 20 mm) išskiriamą dozę ir maksimalią 2420 µg didesnio stento (8,0 x 150 mm) išskiriamą dozę.

Įvedimo sistema – tai įkišmas su viela, todėl stentą galima saugiai įkišti ir įterpti prie žaidos. Jos brėžinių žr. 1 pav. Sistemą sudaro:

- kateterio korpusas (7), 6 F skersmens. Jį sudaro:

- ištraukiamą išorinę įmova, distalinę, kurios pusiau permato moje dalyje (3) yra stentas (4); netoli kateterio galučių ant įmovo yra rentgeno spinduliams nepralaids žiedas (13);
- vidinis spindis, kurį sudaro spirale (6) ir vidinis vamzdelis (2), sudeinamas su 0,035 col. kreipiamaja viela; vidinis spindis tėsiasi kateteriu nuo Luerio jungties (12), esančios proksimaliai rankenėlės atžvilgiu, iki distalinio rentgeno spinduliams nepralaids žiedas galučiu (11), taigi stebint vizualizavimo sistema nesunutylti stento vietą ir jį įterpti. Vidiniam spindynėjimtuotu stabdiklis (5) neleidžia stentui nukrypti nuo ašies traukiant išorinę įmovą;
- rankenėlė (8) su įvedimo sistema, kuri leidžia įvesti kateterį ir tinkamoje vietoje išplėsti stentą.

Rankenėlės yra ergonomiškas dizainas leidžia operatoriui ją suimti ir valdyti net viena ranka. Proksimalinės galė sumontuoti Luerio jungties (12), per kuria praplauumas kreipiamosios vielos spinidis, apsauginis užraktas (10), ratukas (9) ir atitraukimo juostelė (11). Gamindamas periferinio stento ir įterpimo kateterio sistemą gamintojas vykdė visos kokybės kontrolės procedūras tiek gaminant gaminių, tiek jų pagaminus, kaip numatyta geros gamybos praktikos gairėse.

2. JTAISO NAUDOJIMO PASKIRTIS

Savaime išspiečianti periferinio stento sistema naudojama gydinti periferinių arterijų ligą, kuri paveikia paviršinę šlaunių arteriją ir proksimalinę pakinklinę arteriją.

3. JTAISO NAUDOJIMO INDIKACIJOS

Įtaisas skirtas gydinti suaugusių simptominių [2–5 Ruterfordo kategorijos] pacientų šlaunių ir pakinklinių arterijų, esančių virš kelio, stenoze. Gydoma pažeista arterija, kuri yra ne ilgesnė kaip 14 centimetru, turi būti užsikimšusi arba jos stenoze, atsiradusi nauja arba pasikartojanti, turi viršyti 50 % ir būti anksčiau negydyta stentu.

4. KONTRAINDIKACIJOS

Tolialū išvardytais atvejais stento naudoti negalima.

- Jei pažėdima laikoma negydytinai PTA arba kita intervencine metodika.
- Jei pacientė yra nėščioji, žindanti.
- Jei pažėdima yra dviejose distaliniuose pakinklinės arterijos trečdaliuose arba prie kelių sąnario.
- Kai klinikinės sąlygos trukdo tinkamai taikyti antitrombocitinį ir (arba) antikoagulantinį gydymą.

5. JSPĖJIMAI

- Itaiso naudoti nerekomenduojama esant paciento padidėjusiam jauntrumui arba alergijai sirolimui, riebalų rūgštims (pvz., stearino, palmitino, beheno rūgštai) arba metalinėms stento dalims (pvz., nikeliui, titanui ir tantalui).
- Ši priemonė yra vienkartinė. Negalima kartotinai naudoti, apdirbtį arba sterilizuoti. Taip darant kyla įtaiso užteršimo ir (arba) paciento infekcijos, taip pat uždegimų ir paciento užkrėtimo kitų pacientų infekcinių ligomis pavojus.
- Įtaisas naudotinas kaip sistemas. Atskirai jo sudedamųjų dalių naudoti negalima.
- Jei įtaiso pakuočė atidaryta arba pažeista, įtaisas netinkamai laikomas arba yra praėjės jo galiojimo terminas, įtaiso naudoti negalima. Tokiais atvejais negarantuojamas gamino sterilumas.
- Įtaisa gali naudoti tik gydytojai, specialiai išmokyti atlikti perkutaninę transluminalinę angioplastiką (PTA) ir implantuoti periferinį stentą.
- Jei atlikdami procedūrą papjuoste pasiprišeiniama, neterpkite sistemos jéga: iš karto ištraukite stento sistemą ir visą įvedimo kateterį, taip pat kreipiamajai viela į įterpimo įtaisą kaip vientisą sistemą. Bandant terpti jéga ir (arba) netinkamai naudojant įtaisą, stentą galima įterpti atsitiktinai arba sugadinti įterpimo kateterį.
- Bet kuriuo operacijos metu netinkamai naudojant įtaisą galima prapjauti, pradurti arba iplėsti kraujagyslę.
- Nestumkite ir neatrakte stento sistemas ją įterpdami: tai gali smarkiai pažeisti kraujagyslių sienelės.
- Implantavus savaime išspiečiantį periferinį stentą gali ivykti kraujagyslės separacija distalinėje ir (arba) proksimalinėje dalyje stento atžvilgiu, taip pat

kraujagyslė gali staigiai užsikimšti, todėl gali tekti atlikti papildomą operaciją (chirurginį kraujagyslių keitimą, kartotinio išplėtimą, papildomu stentu įterpimu ar kt.).

• Pradėto terpti stento negalima ištraukti naudojant įvedimo sistemą.

6. ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Stentui pradėjus plėstis **niekada** nenaudokite greito įterpimo sistemos. Naudokite ją **iki būtina**, ierpter bent **puse** stento.
- Su įtaisu reikia elgtis atsargiai, stengtis išvengti bet kokių sąlyčio su metaliniais arba abrazyviniais instrumentais, galinčiais ją pažeisti arba lemti mechaninius pakitimus.
- Prieš paruošimą ir padėties nustatymą įtaisas neturi liestis su skyssčiais.
- Įtaiso įterpimo sistemos negalima naudoti su kontrastinėmis medžiagomis purkštuvais.
- Jei stentus reikia implantuoti vieną už kitą, turi persidengti atitinkami rentgeno spinduliams nepralaids žymekliai. Perdengti negalima daugiau nei dviem stentu.
- Jei stentai perdengiami, rekomenduojamas 20 mm perdengimo ilgis.
- Kad nesugadintumėte stento, itin atsargiai kiškite kreipiamają vielą arba balioninį kateterį ar kitą įtaisą pro ką įterptą stentą.

7. MRT SAUGOS INFORMACIJA

Neklinikiniai bandymai parodė, kad gamintojo nitinolio stentų gaminių liniją sanytkinai saugu naudoti MR aplinkoje. Pacientus su šiuo įtaisu galima saugiai skenuoti MR sistema, esant tokiomis sąlygomis:

- statinio magnetinio lauko stiprumas – nei 1,5 teslos (1,5T) arba 3 teslos (3T);
- 6 140 G/cm (61,40 T/m) maksimalus erdvinis lauko gradientas;
- maksimali MR sistemos registruota viso kūno vidutinė savitosios sugerties sparta (SAR) yra:
 - 1 W/kg (normaliu veikimo režimu) esant 1,5 teslos
 - 1 W/kg (normaliu veikimo režimu) esant 3 tesloms

| Išaiškinimas nuo radijo bangų

Esant pirmiui nurodytom skenavimo sąlygomis, numatomas, kad gamintojo nitinolio stentų gaminių linijų temperatūra maksimaliai pakils mažiau nei 6,8 °C per 15 minučių nepertraukiamu skenavimą, maksimaliai MR sistemų registruotai viso kūno vidutinė savitosios sugerties spartai (SAR) esant 1,0 W/kg.

1.5 T 3 T

Vieno stento konfiguracija	Didžiausias temperatūros pokytis	Perdengtų stentų konfiguracija	Didžiausias temperatūros pokytis
	≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C	≤ 6,8 °C

MRT nulemti artefaktai

Atliekant neklinikinius bandymus, įtaiso sukelto vaizdo artefaktas tėsiasi maždaug 0,7 cm nuo gamintojo nitinolio stentų, kai vaizdai gaunami 3 T MRT sistema nesudojant gradiento aido ir sukinio aido impulsų seką.

8. KAIP PRISTATOMA

„NiTiDES“ įtaisas pristatomas sterilus (steriliuojama etileno oksido ir CO₂ mišiniu), yra vienkartinis ir supakuotas dujaveose maišeliuose, kurių negalima nešti ir sterilių aplinka. **PASTABA:** vidinis maželis yra vienintelis sterilumo barjeras. Sterilumas ir cheminis stabilumas užtinkinamas, jei pakuočė nepažeista ir nerā praėjės ant pakuočės išspaustindintas galiojimo terminas („tinka naudoti iki“, angl. USE BEFORE DATE).

Pakuotės turinys: viena (1) „Carbofilm™“ padengta savaime išspiečianti „Amphilimus™“ (sirolimas+riebalinė rūgštis) išskirianti periferinio stento sistema

9. LAIKYMO SĄLYGOS

Gaminys turi būti laikomas, kai nurodyta ant pakuotės, vésioje ir sausoje vietoje, kurioje laikymo temperatūra ne didesnė kaip 25 °C.

10. MODELIAI

Kiekvienas „NiTiDES“ įtaisas turi modelio kodą ir partijos numerį; galimi gaminių kodai nurodyti 1 lentelėje.

11. VAISTŲ REŽIMAS

Klinikinėje literatūroje pateiktose tyrimų aprašuose nurodyta, kad prieš operaciją reikia skirti antitrombocitinį, per procedūrą – antikoagulantinį, o po operacijos – antitrombocitinį gydymą.

Po procedūros taikant antitrombocitinį gydymą reikia skirti:

- tienviopridinį (tilkoplidino, klopodigrelį arba prasugrelį) atitinkamuose informaciuniuose lapeliuose arba recepte nurodytomis dozėmis;
- aspirino bent 100 mg per dieną neribotą laiką.

Atsizvelgdamas į procedūros sudėtingumą ir daugybę veiksnių, turinčių įtakos paciento būklei, tinkamą gydymą savo nuožiūra turi skirti gydytojas.

12. SAVEIKA SU VAISTAMS

Nors jokių konkrečių klinikinių duomenų nepateikiama, kai kurie vaistai, pvz., takrolimas, veikiantis per tuos pačius rišamuosius baltymus (FKBP), gali turėti poveikio sirolimo veiksmingumui. Sirolimą metabolizuoją CYP3A4. Dėl stiprių CYP3A4 slopiųlių gali būti efektyviau pasisavinamas sirolimas, ypač jei implantuojami keli stentai. Jų sisteminio sirolimio poveikio tikimybę reikia atsižvelgti į tada, jei pacientas vartoją sisteminius imunosupresinius vaistus.

13. KLINIKINIS TYIMAS SU „NiTiDES“

Pagrindinis „NiTiDES“ stento saugumas ir veiksmingumas buvo nustatytai atlikus iki�rekybinį pagrindinį klinikinį tyrimą „ILLUMINA“.

Tyrimo modelis: Atliekant daugiacentriškai, vienos atšakos tyrimą, „NiTiDES“ stento buvo gydoma 100 pacientų, sergančių simptomine šlaunių ir pakinklinių arterijų ligą, kurių pažeidimo didžiausias ilgis yra 14 cm. Pirmine veiksmingumu (pirminio praeinamumo) ir pirmine saugos vertinamajai baigtis (ivairūs pagrindiniai nepageidaujami reiškiniai: mirtis, tikslinės galūnės amputacija, tikslinės galūnės

išėmija, kuriai reikalinga chirurginė intervencija arba tikslinės kraujagyslės chirurginė rekonstrukcija arba kliniškai pagrista tikslinio pažeidimo revaskularizacija, būklės pablogėjimas 2 kategorijos arba iki 5 ar 6 kategorijos pagal Ruterfordo klasifikaciją) buvo lyginamos su tikslinių veiksmingumo siekiu (angl. „Objective Performance Goal“, OPG) praejus 12 tyrimo mėnesių.

Rezultatai: Procedūros skėmė buvo pasiektą 100 %.

Dopplero ultragarsinio tyrimo rezultatai rodo, kad pirmasis prieinamumas yra 87 % (77/89, 95 % pasikliautinasis intervalas 80–94), atitinkantis OPG reikalavimui (73 %). 24 mėnesiu pirmasis prieinamumas buvo 81 % (63/78).

12 mėnesiu pirminė saugumo vertinamoji baigtais buvo 96,8 % (90/93) ir atitiko OPG reikalavimus (19,6 %). 2,2 % (2/93) pacientų buvo atlanka kliniškai pagrista tikslinio pažeidimo revaskularizacija, 1,1 % (1/93) pacientų numerė, 0 pacientų buvo atlanka tikslinės galūnės amputacija, 0 pacientų pasireikšė tikslinės galūnės išėmija, kuriai reikalinga chirurginė intervencija arba tikslinės kraujagyslės chirurginė rekonstrukcija ir 0 pacientų būklė pablogėjo 2 kategorijomis arba iki 5 ar 6 kategorijos pagal Ruterfordo klasifikaciją.

24 mėnesius saugumo vertinamoji baigtais buvo 87,8 % (79/90), 6,7 % (6/90) pacientų buvo atlanka kliniškai pagrista tikslinio pažeidimo revaskularizacija, 3,3 % (3/90) pacientų numerė, 0 pacientų buvo atlanka tikslinės galūnės amputacija, 1,1 % (1/90) pacientų pasireikšė tikslinės išėmija, kuriai reikalinga chirurginė intervencija arba tikslinės kraujagyslės chirurginė rekonstrukcija ir 1,1 % (1/90) pacientų būklė pablogėjo 2 kategorijomis arba iki 5 ar 6 kategorijos pagal Ruterfordo klasifikaciją.

14. NAUDOJIMO NURODYMAI

Įtaiso pasirinkimas

Norėdami nustatyti naudotino stento ilgi, atsižvelkite į ketinamo plėsti pažeidimo ilgi. Pažeidima siekiant tinkamai apdengti, įterpto stento ilgis turėtų būti bent 5 mm ilgesnis už patį pažeidimą iš abiejų pusės.

Norėdama nustatyti tinkamą stento dydį, atsižvelkite kraujagyslės skersmenį proksimalinėje ir distalinėje dalyse pažeidimo atžvilgiu. Kad stentą pavykту įterpti saugiai, tinkamą stento dydį rinkite pagal didesnį skersmenį. Pasirinkdami modelį, atsižvelkite į 1 lentelę pateiktą informaciją.

Įtaiso parengimas

Prieš įvestinus stentą skirtite heparinu ir patirkinkite, ar paciento aktyvuotas krešėjimo laikas (AKL) atitinka gydymo centro praktikos nuostatas.

Ruošiant sistemą reikia ypač stengtis išvengti stento salyčio su koku nors skyssčiu.

- Atidarykite dežutę ir išimkite maišelį, kuriamo yra sterilumo maišelis.
- Patirkinkite, ar pakuočė nepažeista, atidarykite išorinį nesterilių aliuminio folijos maišelį ir išimkite vidinio maišelio turinį. (Pastaba: aliuminio folijos maišelis ir išorinis vidinio plastikinio maišelio paviršius NERA STERILUS. Tik plastikinio maišelio turinys yra STERILUS.)
- Padėkė ant plokštio paviršiaus sterilioje aplinkoje atsekitė rankeną juosiančią juostą ir iš apsauginės spiralės išimkite kateterį.
- Patirkinkite, ar jivedimo kateteris nesusiraizegas, nesulinkęs arba kitaip nepažeista. Įtaisas su defektais gali netinkamai veikti.
- Pripildykite 3 mL švirkštą fiziologinį tirpalą, kuriamo yra heparinu, prijunkite prie praplaunant naudojančios Luerlo jungties (1 pav., 12 elementas) ir sudarykite teigiamą slėgią. Plaukite, kol fiziologinis tirpalas pasiekis distalinį kateterio galą.
- Patirkinkite distalinį kateterio galą ir ištitinkinkite, kad visas stentas (1 pav., 4 elementas) yra išorinėje įmovoje.

Jei įtaisas pažeista arba jei stentas iš dalies išplėstas, jo nenaudokite.

Suderinamumas su priedais

Su „NI-TIDES“ įtaisu galima naudoti 6 F (2,0 mm) (arba didesnio) skersmens įterpimo įmova.

Su „NI-TIDES“ įtaisais galima naudoti 0,035 col. (0,89 mm) (arba mažesnio) skersmens kreipiamasių vielas. Kreipiamosių vienos standumą ir galuuko konfigūraciją gydymoje parenka pagal savo klinikinę patirtį.

Jei būtinai naudoti kreipiamajį kateterį, sistemos yra sederinamos su 8 F (2,7 mm) arba didesnio skersmens kreipiamaisiai kateteriai. Tokiu atveju prieš įterpdami pasirinktį rinkinį ištitinkinkite, kad hemostatinis vožtuvas visiškai atidarytas.

Stento įterimas

- Ištitinkinkite, kad ant rankenos sumontuotas apsauginis užraktas (1 pav., 10 elementas) yra užrakintas (B detalė).
 - Nuplaukite naudotos kreipiamosių vienos dalį fiziologiniu tirpalu su heparinu, kad pašalinumėte kraujų ir kontrastinės medžiagos likučius.
 - Stumkite sistemą kreipiamajia viela, kol stentas pasiek gydymo vietą.
- Jei bet kuriuo metu pajuoste neįprastą pasipriešinimą, nebandykite sistemos terpi jėga: ištraukite įterpimo įtaisą, kreipiamają vielą ir visą įtaiso sistemą vienu metu. Bandant terpi jėga ir (arba) netinkamai naudojant įtaisą, stentą galima įterpti atsitiktinai arba sugadinti įterpimo kateterį.

Įtaiso terpimas

- Stumkite sistemą, kol stentas bus už pažeidimo.
- Tada traukite sistemą atgal, kol stentas susilygiuos su pažeidimu.
- Patirkinkite, ar į paciento organizmą neįvesta įvedimo sistemos dalis yra laisvai nusidriekusi ir tiesi.

Dėmesio: netinkamai nusidriekusi įvedimo sistema rodo, kad stentas gali būti įterptas už tikslinio pažeidimo.

Stento implantavimas ir išplėtimas

- Viena ranka tvirtai laikydam rankeną patirkinkite, ar ant stento esantys rentgeno spinduliams nepralaidūs žymekliai yra proksimalinėje ir distalinėje dalyse pažeidimo atžvilgiu.
- Ištitinkinkite, kad terpinant stentą įterpimo įmova yra stabili.
- Pasukite ant rankenos esančią apsauginį užraktą (1 pav., B detalė) prieš laikrodžio rodyklę, kad ji atrakintumėte (1 VEIKSMAS), o tada visiškai ji ištraukite (2 VEIKSMAS).
- Laikydam rankeną fiksuoja padėtyje paciento atžvilgiu dar kartą patirkinkite, ar rentgeno spinduliams nepralaidūs žymekliai yra reikiamoje padėtyje pažeidimo

atžvilgiu; pradékite terpi stentą nykšteliu sukdami ratuką (1 pav., 9 elementas) technikos kryptimi, kaip parodyta 1 paveikslėlyje.

e) Kai stebedami fluoroskopu matote, kad distalinis stento galas yra gerai prisitvirtintas prie kraujagyslių sienu, toliau terpkitė stentą sukdami ratuką, kol jis bus iki galio išplėstas ir visiškai implantuotas į kraujagyslės sieneles.

f) Jei įterpi reikia greitai, atlikite toliau nurodytus veiksmus: ištitinkinkite, kad galinėje rankenos dalyje nėra jokių klūčių (pvz., pritrintos lizdinės Luerlo jungties), kita ranka suimkite įtaisą už galio (attraukimo detalės, 1 pav., 11 elementas) ir, visiškai nejudindami į pacientą nukreiptos priekinės įtaiso dalies, traukite įtaiso už galio, kaip parodyta 1 paveikslėlyje.

g) Fluoroskopu patirkinkite, ar stentas visiškai išplėstė.

h) Jei reikia, naudojant PTA balloninį kateterį stenta galima dar labiau išplėsti. Pasirinkdami balloninį kateterio skersmenį ir atlikdami papildomą išplėtimą, atsižvelkite į angiografijos metodą įvertintą kraujagyslės skersmenį. Bet kuriuo atveju būkite itin atidus ir neišplėskite stento daugiau už etiketėje nurodytą nominalųjų skersmenų.

i) Galutinis stento skersmuo turi atitikti referencinį kraujagyslės skersmenį.

15. GALIMI NEPAGEIDAUJAMI REIŠKINIAI

Toliu išvardytos nepageidaujamos reakcijos, galinčios pasireikšti implantavus periferinį stentą, išskaitant riziką, susijusią su perkutanine transilumininėle angioplastika, taip pat kiti rizikai, susijusiai su stentų naudojimu.

- Infekcija priėjimo vietoje, skausmas ir hematomė
- Alerginė ar nepageidaujama reakcija kontrastinei medžiagai, per procedūrą skirtiems vaistams arba sudedamosioms stento medžiagoms
- Arteriniai spazmai
- Arterijos arba stento tromboze
- Šlauninės arterijos aneurizma arba pseudoaneurizma
- Aterosklerozinė distalinė embolizacija
- Kraujavimas
- Mirtis
- Kraujagyslės, kuriuoje jisodintas stentas, separacija, pradūrimas arba plyšimas
- Embolia
- Inkstu nepakankamumas
- Apatinių galūnų išėmija (dėl kurios būtina chirurginė intervencija)
- Arterijos, kurioje implantuotas stentas, restenozė
- Stento embolizacija
- Kraujagyslės okluzija arba nepagydyta stenozė

16. ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJÀ

Gamintojas užtinkrina, kad įtaisas buvo sukurtas, pagamintas ir supakuotas itin atsgairiai, naudojant technologijas, kurios laikomos tinkamiausiomis iš visų dabartinių technologijų, ir taikant saugumo integravimo į dizainą ir konstrukciją principus, kurie užtinkrina saugų naudojimą numatytomis sąlygomis ir nustatytais tikslais, laikantis ankstesniuose paragraufuose nurodytų atsargumo priemonių, ir kuriais bei koku atveju išskiriama kiek įmanoma sumažinti su įtaiso naudojimu susijusios rizikos (tačiau jos visiškai nepašalina).

Įtaisa turi naudoti tik tam tikra specializacija turintys medikai, atsižvelgdami į visą likutinę riziką arba galimą šalinutį poveikį bei gydymo, kuriam įtaisas numatytas, komplikacijas, išskaitant paminėtus kitose šios instrukcijų brošiūroje skyriuose.

Dėl techninio sudėtingumo, tinkamo gydymo pasirinkimą ir įtaiso naudojimo metodų svarbos, gamintojas neturi jokių aiškių ar numanomų garantijų, kad panaudojus įtaisą bus gauti veiksmingi rezultatai arba kad įtaisas veiksmingai išspręs negalią ar bet kokią kitą patologiją ar medicininę problemą, iš tiesų, tiek klininiu poziūriu, tiek įtaiso funkcionalumu ir naudojimo trukmės poziūriu rezultatai taip pat priklauso nuo daugybės veiksniių, kurių gamintojas negali valdyti, tarp kurių minimi (tik kaip pavyzdžiu), o ne baigtinių paciento būklės) chirurginės implantavimo procedūros ar naudojimos, gydymo įtaisu metodai po pakuočtes atidarymo.

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, gamintojo atsakomybė egzistuoja tik tuo atveju, jei buvo ištitinkink, kad tuo metu, kai įtaisas buvo išleistas į apyvarą, jis buvo pažeistas. Todėl klientas turi nedelsdamas pateikti įtaisą gamintojui pagal teisės aktuose nustatytas galiojimo pabaigos ar senaties sąlygas; gamintojas pasileikia teisę išsterti įtaisą, kuris yra laikomas sugedusiu, ir nustatyti, ar jis iš tikrujų pažeista ar turi defektų, galinčius turėti itakos gaminio saugai. Gamintojo atsakomybė netakoima, jei: i) nurodytas defektas atsirado dėl įtaiso atlikties privilomatų taišykeli arba privalomajai nuostatai, ir (arba) ii) defektas, dėl kurio buvo padaryta žala, neegzistavo, kai gamintojas išleido įtaisą, ir (arba) iii) jei techninės ir moksliškes žinios tuo metu, kai gamintojas išleido įtaisą, dar neleido laikyti įtaiso defektiniu, ir (arba) iv) bet kurioju kitu atveju, kuris taip pat skiriasi nuo pirmiau nurodytu, kai įstatymas aiškiai atmesta arba apriboja gamintoją atsakomybę už pažeidimą dėl gaminio defektinį. Garantija apima tik defektinių įtaiso pakeitimą tos pačios arba atitinkamos rūšies gamintoją gaminiui.

Garantija taikoma tik tuo atveju, jei įtaisas tinkamai gražinamas gamintojui kartu su išsamiu rašytiniu pranešimiu apie nustatytus trūkumus ir, jei įtaisas buvo implantuotas, nurodžius jo išėmimo į paciento organizmo priežastis. Apie nurodytus defektus reikia nedelsiant pranešti gamintojui, laikantis konfiskavimo sąlygų ir įstatymų nurodymų.

Kai pakeitimais bus atliktas, gamintojas gražins klientui išlaidas, patirtas už pripažintą sugedusiu įtaiso gražinimą.

Gamintojas atsiskaito bet kokios atsakomybės dėl pasirinkto gydymo ir įtaiso naudojimo arba taikymo metodų sukelty padarinį ir todėl jokioms aplinkybėmis nebūs patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už bet kokią materialinę, biologinę ar moralinę žalą, atsiradusią dėl įtaiso naudojimo ir chirurgo naudojamos implantavimo technikos pasirinkimo.

Gamintojo tarpininkai ir atstovai nėra įgalioti keisti nė vienos iš minėtų sąlygų, nei prisimti jokių papildomų įspareigojimų arba pateikti bet kokius su šiuo gaminiu susijusius garantijų, išskyrus tas, kurios nurodytos pirmiau. Ši garantija reglamentuojama Italijos teisės aktais, išskyrus atvejus, kai taikomi kitos valstybės privalomi įstatymai, jei gamintojas leido platinti produktą vienoje ar keliose užsienio valstybėse.

SLOVENČINA

NiTIDES

Samorozprináci periferny stentov systém vyučujúci Amphilius™ (sirolimus+mastrné kyseliny) s povlakom „Carbofilm™“

1. OPIS POMÓCKY

Skupinu pomôckov NiTiDES tvorí samorozprináci stent a systém na jeho správne umiestnenie a nasadenie.

Stent je ohynná, samorozprinacia implantovateľná pomôcka. Je vyrobený zo zlatiny niklu a titánu (nitinolu) s povlakom z materiálu „Carbofilm™“. Povlak je vlastne tenká uhličková vrstva s turbostratickou štruktúrou vysokej hustoty, prakticky zhodnou so štruktúrou pyrolytického uhlika.

Povlak substrátu dodáva pomôcku biokompatibilné a hemokompatibilné charakteristiky pyrolytickej uhlika bez vplyvu na fyzikálne a štrukturálne vlastnosti samotného podkladu.

Na stente je aplikovaných šesť röntgenkontrastných tantalových značiek (tri na každej strane), ktoré umožňujú správne umiestnenie presne na cieľovú ležiu.

Na vonkajšom povrchu stentu sú špeciálne drážky, plyn pokrytie povlakom „Carbofilm™“, ktoré obsahujú farmaceutický prípravok Amphilius™, zložený z liečiva Sirolimus a zmesi mastných kyselin s dlhým reťazcom.

Špecifická dávka liečiva na plochu liečenej cievky je približne 0,9 µg/mm², čo zodpovedá minimálnej dávke 270 µg u menších stentov (6,0 x 20 mm) a maximálnej dávke 2420 µg u väčších stentov (8,0 x 150 mm).

Použitý je **zavádzací systém „po drôte“**, zabezpečujúci, že stent možno bezpečne umiestniť a uvoľniť v mieste lieče. Schematicky je znázornený na obrázku 1 a skladá sa z nasledujúcich dielov:

- telo katétra (7) s priemerom 6F, ktoré tvorí:
 - všívateľné vonkajšie puzdro, distálna, polopriehľadná časť (3), ktorá obklopuje stent (4). Na puzdre je v blízkosti hrotu katétra röntgenkontrastný prstenec (13);
 - vnútorný lúmen s cievkou (6) a vnútorná hadička (2) kompatibilná s vodiaciom drôtom s priemerom 0,035 palca; vnútorný lúmen sa tiahne pozdĺž katétra od spojky luer (12), je zaistený proximálne na rukováti, a končí distálne na hrote (1) z röntgenkontrastného materiálu, aby sa uľahčilo umiestnenie a nasadzovanie stentu pri sledovaní zobrazovacím systémom. Zarážka (5) zabudovaná vo vnútornom lúmene bráni akémukolvek axiálnemu posunutiu stentu pri vťahovaní vonkajšieho puzdra;
 - rukoväť (8) so zavádzacím systémom, ktorý umožňuje umiestnenie katétra a uvoľnenie stentu na mieste.

Rukoväť má ergonomický dizajn umožňujúci jej uchopenie a používanie zo strany operátora, a to aj jednou rukou. Na proximálnom konci je port luer (12), ktorý sa používa na preplachovanie lúmennu pre vodiaci drôt, bezpečnostný kľúč (10), koliesko (9) a vytahovacie zadny koniec (11).

Výrobca vyrába systém periférneho stentu a nasadzovacieho katétra priamo a uplatňuje všetky postupy kontroly kvality pri výrobe a na hotových výrobkoch v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe.

2. URČENÉ POUŽITIE POMÓCKY

Systém samorozprináciého periférneho stentu je určený na liečbu ochorení periférnych arterií, ktoré postihujú predovšetkým povrchovú femorálnu tepnu a proximálnu podkolennú tepnu.

3. URČENIE POMÓCKY

Pomôcka je určená na liečbu stenózy femorálnych podkolenných arterií nad kolennom u dospelých symptomatických pacientov [Kategória podľa Rutherforda 2-5]. Osétrená ležia s maximálnou dĺžkou 14 centimetrov musí byť bud s okluziou, alebo musí sa stenózu prevyšujúcu 50 %, musí byť nová alebo opakovane stenotická, nesmie byť predtým liečená stentom.

4. KONTRAINDIKÁCIE

Použitie stentu je kontraindikované v nasledujúcich prípadoch:

- Lézie považované za neliečiteľné pomocou perkutálnej transluminálnej angioplastiky alebo iných intervenčných techník.
- Tehotné a dojčiace ženy.
- Lézie lokalizované vo dvoch distálnych tretinách podkolennej tepny alebo na kolennom klbe.
- Klinické stavby obmedzujúce použitie antitrombocytickej alebo antikoagulačnej terapie.

5. VAROVANIA

- Použitie pomôcky sa neodporúča u pacientov so známou precitlivenosťou alebo alergiou na Sirolimus, mastné kyseliny (napr. kyselinu stearovú, kyselinu palmitovú, kyselinu behenovú) alebo na kovové súčasti stentu (napr. nikel, titán alebo tantál).
- Táto pomôcka je určená len na jednorazové použitie. Nepoužívajte opakovane, neregeneruje ani opäťovne nesterilizujte. Mohlo by to spôsobiť riziko kontaminácie pomôcky alebo infekcií pacienta, zápalu a prenosu infekčných chorôb z pacienta na pacienta.
- Táto pomôcka je navrhnutá tak, aby sa používala ako ucelený systém. Jej komponenty nepoužívajte samostatne.
- Pomôcku nepoužívajte, ak jej balenie bolo otvorené alebo poškodené, alebo po uvedenom dátume expirácie. V takýchto prípadoch sterilita výrobku nie je zaručená.
- Pomôcku smú používať iba lekári špeciálne vyškolení na vykonávanie perkutálnej transluminálnej angioplastiky (PTA) a implantácie koronárneho stentu.
- Ak v ktorejkoľvek etape zákroku narazíte na odpor, nepoužívajte silu: vytiahnite systém stentu a celý zavádzací katéter, vodiaci drôt a zavádzací naraz ako jednu jednotku. Použitie neprimeranej sily alebo nesprávna manipulácia môže spôsobiť neúmyselné nasadenie stentu alebo poškodenie polohovacieho katétra.

- Takáto nesprávna manipulácia kedykoľvek počas operácie by mohla spôsobiť disieku, perforáciu alebo prasknutie cievky.
- Systém stentu nevysúvajte ani nevyťažujte počas jeho nasadzovania: mohlo by to spôsobiť väčšie poškodenie stien cievky.
- Implantácia samorozprináciého stentu môže spôsobiť disieku cievky distálne alebo proximálne k stentu a môže spôsobiť aj akútne upchatie cievky, čo si vyžiada ďalšiu operáciu (chirurgickú operáciu náhrady cievky, ďalšiu dilataciu, nasadenie ďalších stentov alebo iné postupy).
- Po čiastočnom nasadení sa stent už nebude dať vrátiť do pôvodného stavu pomocou zavádzacieho systému.

6. OCHRANNÉ OPATRENIA

- Nikdy nepoužívajte systém rýchleho uvoľnenia na začiatku rozprinácia stentu. Použite ho iba v prípade nevyhnutnosti, po uvoľnení aspoň polovice dĺžky stentu.
- Pomôcka si vyžaduje opatrné zaobchádzanie, s vylúčením akéhokoľvek kontaktu s kovovými alebo abrázivnými nástrojmi, ktoré by mohli poškodiť povrch alebo spôsobiť mechanické zmeny.
- Pred prípravou a umiestnením sa pomôcka nesmie dostať do styku s kvapalinami.
- Systém na umiestnenie pomôcky nie je určený na použitie s injektormi kontrastných látok.
- Pri tandemovom implantovaní stentov sa zodpovedajúce röntgenkontrastné značky musia prekrývať. Prekrytie by nealo zahŕňať viac než dva stenty.
- V prípade prekrycia stentov sa odporúča dĺžka prekrycia menej než 20 mm.
- Aby nedošlo k poškodeniu stentu, postupujte pri prechádzaní vodiacim drôtom alebo balónikovým katéterm, pripadne inou pomôckou, cez práve roztiahnutý stent mimoriadne opatne.

7. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE SÚVISIACE S MRI

Pri neklinickom skúšaní sa zistilo, že séria výrobkov od výrobcu stentov z Nitinolu sú za dodržania určitých podmienok pri MR zobrazovaní bezpečné. Pacient s uvedenou pomôckou sa môže bezpečne snímať v systéme MR za splnenia nasledujúcich podmienok:

- Statické magnetické pole s intenzitou 1,5-Tesla (1,5T) alebo 3-Tesla (3T)
- Maximálny priestorový gradient poľa 140 G/cm (61,40 T/m)
- Maximálna MR systému, priemerná špecifická miera absorpcie (SAR) celého tela:
 - 1 W/kg (bezrý prevádzkový režim) pri 1,5T
 - 1 W/kg (bezrý prevádzkový režim) pri 3T

RF ohrev

Pri vyššie uvedených podmienkach skenovania sa očakáva, že série produktov nitinolových stentov výrobcu po 15 minútach nepretržitého skenovania na uvedenom MR systéme vyprodukujú maximálny nárasť teploty nižší než 6,8 °C a priemernú špecifickú mieru absorpcie (SAR) celého tela 1,0 W/kg.

1.5 T	3 T
-------	-----

Konfigurácia s jedným stentom Najväčšia zmena teploty	≤ 6,3 °C ≤ 6,2 °C
Konfigurácia prekrytie stentu Najväčšia zmena teploty	≤ 6,8 °C ≤ 6,3 °C

MRI artefakt

Pri neklinickom skúšaní boli artefakty na obraze, spôsobené pomôckou, rozšírené na približne 0,7 cm od nitinolových stentov, pokiaľ sa zobrazovanie robilo sekvenciou impulzov gradient-echo v systéme 3T MRI.

8. SPÔSOB DODANIA

Pomôcka NiTiDES sa dodáva sterilná (sterilizovaná zmesou etylénoxidu a CO₂), na jedno použitie, a balená v dvoch vreckách, ktoré sa nesmú umiestniť do sterilného prostredia. **POZNÁMKA: jedinou sterilnou bariérou je vnútorné vrecko.**

Sterilita a chemická stabilita sú zaručené, pokiaľ je balenie neporušené a pokiaľ neuplynula doba expirácie vytlačená na obale (USE BEFORE DATE – DÁTUM SPOTREBY).

Obsah: jeden (1) samorozprináci periferny stentov systém vyučujúci Amphilius™ (sirolimus+mastrné kyseliny) s povlakom „Carbofilm™“

9. SKLADOVANIE

Výrobok by sa mal skladovať podľa pokynov na obale, na chladnom a suchom mieste, s teplotou skladovania max. 25 °C.

10. MODELY

Pomôcka NiTiDES je identifikovaná kódom modelu a číslom výrobnej šarže. Dostupné modely sú uvedené v tabuľke 1.

11. LIEKOVÝ REŽIM

Štúdie v klinickej literatúre naznačujú, že pred operáciu je potrebná antitrombotická terapia, počas operácie antikoagulačná terapia a po operácii antitrombotická terapia.

Antitrombotická liečba v období po zákroku spočíva v podaní:

- tienopyridínu (tiklopidinu, klopidoľeru alebo prasugrelu v dávkach uvedených v príslušných písomných informáciach pre používateľov alebo podľa lekárskeho predpisu)
- aspirínu v minimálnej dávke 100 mg/deň po neobmedzený čas

Vzhľadom na náročnosť postupu a množstvo faktorov ovplyvňujúcich stav pacienta sa určenie vhodnej terapie ponecháva na uváženie lekára.

12. LIEKOVÉ INTERAKCIE

Hoci v dispozícii nie sú žiadne konkrétné klinické údaje, niektoré lieky, ako je Takrolimus, ktoré pôsobia prostredníctvom rovnakého väzobového proteínu (FKBP), môžu ovplyvňovať účinnosť Sirolimusu. Modafinil je metabolizovaný CYP3A4. Silné inhibitory CYP3A4 môžu spôsobiť zvýšenú expozíciu Sirolimusu, najmä

v prípade viacerých implantátov. Ak pacient súčasne užíva imunosupresívnu, potrebuje je príhľadať aj na systémovú expozíciu na Sirolimus.

13. KLINICKÉ ŠTÚDIE S NITIDES

Hlavná bezpečnosť a účinnosť stentu Nitides bola stanovená pivotnou klinickou štúdiou ILLUMINA este pred uvedením na trh.

Projekt štúdie: V rámci štúdia s jedným rámennom vo viacerých centrách bolo stentom Nitides liečených 100 pacientov so symptomatickým ochorením femorálnej podkolennej tepny s maximálnou dĺžkou lezie 14 cm. Primárna účinnosť (primárna prichodnosť) a primárny cieľový ukazovateľ bezpečnosti (zložený z hlavných nežiaducích udalostí: smrť, amputácia cieľovej končatiny, ischemia cieľovej končatiny vyzádjujúca chirurgický zárok alebo chirurgickú nápravu revaskularizáciu cieľovej cieví, prípadne klinicky riadená cieľová lezia, zhoršenie Rutherfordovo skóre o 2 triedy alebo na triedu 5 alebo 6) sa porovnali s cieľom účinosti (OPG) na 12 mesiacov.

Výsledky: Úspešnosť postupu bola dosiahnutá na 100 %.

Výsledky vykonané dopplerovým ultrazvukom ukazujú primárnu prichodnosť 87 % (77/89, 95 % interval spoľahlivosti 80-94), čo splňa požiadavky OPG (73 %). 24-mesačná primárna prichodnosť bola 81 % (63/78).

12-mesačný ukazovateľ primárnej končovej bezpečnosti bola 96,8 % (90/93), čo splňa požiadavky OPG (19,6 %). U 2,2 % (2/93) pacientov bola klinicky vykonaná revaskularizácia cieľovej lezie, 1,1 % (1/93) pacientov umrel, u 0 pacientov sa robila amputácia cieľovej končatiny, u 0 sa vyžadoval chirurgický zárok pre ischemiu cieľovej končatiny alebo chirurgická náprava cieľovej cieví a u 0 pacientov sa zhoršilo skóre Rutherford o dve triedy, alebo trieda 5 a 6.

24-mesačný ukazovateľ končovej bezpečnosti bola 87,8 % (79/90). U 6,7 % (6/90) pacientov bola klinicky vykonaná revaskularizácia cieľovej lezie, 3,3 % (3/90) pacientov umrel, u 0 pacientov sa robila amputácia cieľovej končatiny, u 1,1 % (1/90) sa vyžadoval chirurgický zárok pre ischemiu cieľovej končatiny alebo chirurgická náprava cieľovej cieví a u 1,1 % (1/90) pacientov sa zhoršilo skóre Rutherford o dve triedy, alebo trieda 5 a 6.

14. POKYNY NA POUŽITIE

Výber pomôcky

Požadovanú dĺžku stentu vyberte podľa dĺžky cieľovej lezie. Aby bolo možné vhodne pokryť leziu, dĺžka rozvinutého stentu by mala byť na oboch stranách minimálne o 5 mm dlhšia ako samotná lezia.

Vhodný model stentu určte podľa priemeru cieví proximálne a distálne voči lezii. Na zaistenie bezpečného umiestnenia stentu použite ako základ pri výbere vhodnej veľkosti stentu väčší priemer. Pri výbere modelu sa riadte informáciami uvedenými v tabuľke 1.

Príprava pomôcky

Pred zavádzaním stentu podajte heparín a skontrolujte, či je aktivovaný koagulačný čas (ACT) pacienta v súlade s praxou daného strediska.

Pri príprave systému venujte osobitnú pozornosť tomu, aby sa žiadna kvapalina nemohla dostať do styku so stentom.

- Otvorte balenie a vyberte vrecko so sterilne zabaleným obsahom.
- Po kontrole obalu, či nie je poškodený, otvorte vonkajšie nestierilné vrecko z hliníkovej fólie a potom vyberte obsah z vnútorného vrecka. (Poznámka: Globálové vrecko a vonkajšiu povrch vnútorného plastového vrecka **NIE SU STERILNÉ. STERILNÝ** je iba obsah plastového vrecka).
- Opatrte položte podstavec na rovný povrch v sterilnom priestore, uvoľnite pások okolo rukoväte a vyberte katéter z ochrannej cievky.
- Skontrolujte, či na zavádzacom katétri nie sú zlomy, ohaby ani iné poškodenia. Poškodenie pomôcky môže zhoršiť jej funkčnosť.
- Naprieč 3 mil injekčný striekačku fyziologickým roztokom obsahujúcim heparín, pripojte ju na spojku Luer určenú pre preplachovanie (obr. 1, ozn. 12) a aplikujte tlak. Pokračujte v preplachovaní až kým sa na distálnom konci katétra neobjaví fyziologický roztok.
- Skontrolujte distálny koniec katétra. Presvedčte sa, že stent (obr. 1, ozn. 4) je úplne zakrytý vonkajším pudzrom.

Ak je stent čiastočne roztahnutý, pomôcku nepoužívajte.

Kompatibilita s príslušenstvom

S pomôckami Nitides sa môžu používať zavádzacie pudzdrá s priemerom 6F (ID 2,0 mm) alebo väčšie.

S pomôckami Nitides sa môžu používať vodiace drôty s priemerom 0,035 palca (0,89 mm) alebo menšie. Výber tuhosti vodiaceho drôtu a konfigurácie hrotu bude závisieť od klinických skúseností lekára.

Pokiaľ by bolo potrebné použiť vodiaci katéter, systémy sú kompatibilné s vodiacimi katétramí s priemerom 8 F (2,7 mm) alebo väčším. V tomto prípade sa pred zavedením vybranej zostavy presvedčte, že hemostatický ventil je úplne otvorený.

Zavedenie stentu

- Skontrolujte, či je bezpečnostný kľúč (obr. 1, ozn. 10) na rukováti je v zaistenej polohе (bod B).
- Premrite exponovanú časť vodiaceho drôtu fyziologickým roztokom s obsahom heparínu, aby ste odstránili stopy krvi a kontrastnú látku.
- Zavádzajte systém po vodiacom drôte, až kým stent nedosiahne liečené miesto.

Ak by ste pocitili nejaký nevyčíjaný odpor, nevyvijajte veľkú silu: zavádzací, vodiaci drôt a pomôcku vytiahnite ako jeden celok. Použitie neprimeranej sily alebo nesprávna manipulácia môže spôsobiť neúmyselné nasadenie stentu alebo poškodenie polohovacieho katétra.

Posúvanie pomôcky

- Posuňte systém do bodu, v ktorom bude stent za leziu.
- Potiahnite systém dozadu, kým stent nebude zarovno s leziou.
- Skontrolujte, či je voľne vytiahnutá a rovná časť zavádzacieho systému, nachádzajúca sa mimo telo pacienta.

Upozornenie: ak zavádzací systém nie je správne vytiahnutý, stent môže byť nasadený za cieľovú leziu.

Implantácia a roztahnutie stentu

- Rukováti držte pevne jednou rukou, skontrolujte, či sú röntgenkontrastné značky na stente umiestnené proximálne a distálne vzhľadom na leziu.
- Uistite sa, že zavádzacie pudzdro pôcas nasadzovania stentu nepohybuje.
- Pootočte bezpečnostný kľúč na rukováti proti smeru hodinových ručičiek (obr. 1, ozn. B), aby sa odistil (KROK 1) a úplne ho vytiahnite von (KROK 2).
- Uchopte rukováti v pevnej polohе vzhľadom na pacienta a znova skontrolujte, či sú röntgenkontrastné značky v požadovanej polohе vzhľadom na leziu. Začnite zavádzanie stentu otáčaním kolieska (obr. 1, ozn. 9) palcom v smere šípky, ako je znázornené na obrázku 1.
- Pomocou skiaskopie, keď je distálny koniec stentu dobре prichytený ku stenám cievky, pokračujte v nasadzovaní otáčaním kolieska, až kým sa neotvorí koniec stentu a kým nebude úplne implantiovaný do cievnych stien.
- Ak sa vyžaduje rýchle rozpínanie, dodržte nasledujúci postup: uistite sa, že v zadnej časti rukoväte nie sú žiadne prekážky (napr. poškodená zásuvková spojka Luer), uchopte zadnú časť pomôcky (vytiahnutie, obr. 1, ozn. 11) druhou rukou a potiahnite ju, držiac prednú časť rukoväte vzhľadom na pacienta dokonale nehybne, ako je znázornené na obrázku 1.
- Skiaskopicky skontrolujte, či je stent úplne roztahnutý.
- V prípade potreby možno stent roztahnúť ďalej pomocou balónikového katétra PTA. Pri výbere priemeru balónika katétra a pri vykonávaní následného roztahu musí sa riadiť priemerom cievky, vyhodnotený pomocou angiografie. V každom prípade veľmi starostivo dbajte, aby sa stent neroztahol viac ako na stanovený nominálny priemer, uvedený na etikete.
- Konečný priemer stentu musí byť vhodný pre referenčný priemer cievky.

15. POTENCIÁLNE NEŽIADUCE UDALOSTI

Možné nežiaduce účinky, ktoré môžu súvisieť s implantáciou periférneho stentu, zahŕňajú rizík spojené s perkutánou transluminálnou angioplastikou a ďalšie rizík spojené s použitím stentov, ako sa uvádzajú nižšie.

- Infekcia v mieste vstupu, bolest a hematom
- Alergická alebo nežiaduca reakcia na kontrastnú látku, lieky používané pri zároku alebo materiály konštrukcie stentu
- Kŕč teplny
- Arteriálna alebo stentová trombóza
- Aneuryzma alebo pseudoaneuryzma femorálnej tepny
- Aterosklerotická distálna embolizácia
- Krvácanie
- Smrť
- Rozrezanie, perforácia alebo prasknutie cievky so stentom
- Embolia
- Zlyhanie obličiek
- Ischémia dolnej končatiny (vyzadujúca si chirurgický zárok)
- Restenóza tepny, v ktorej stent implantovaný
- Stentová embolizácia
- Oklúzia cievky alebo nevyriešená stenóza

16. ZODPOVEDNOSŤ A ZÁRUKA

Výrobca zaistuje, že pomôcka bola navrhnutá, vyrobená a zabalená s maximálnou pozorosťou, technikou považovanou za najvhodnejšiu z dostupných, za súčasného stavu technológie, a za uplatňovania zásad integrovania bezpečnosti do návrhu s cieľom zaistiť bezpečné používanie za predpísaných podmienok a na zámyšľané účely, za dodržania ochranných opatrení uvedených v predchádzajúcich odsekcích, v každom prípade so zameraním na čo najväčšie zniženie, ale nemôže úplne vylúčiť rizík súvisiace s používaním pomôcky. Táto pomôcka sa musí používať iba v rámci zodpovednosti specializovaných zdravotníkov a so zreteľom na zvyškové rizíká a možné nežiaduce účinky a komplikácie liečby, pre ktoré je určená, vrátane uvedených na iných miestach v tomto návode.

Technická zložitosť a kritická povaha lekárskych volieb a spôsobov aplikácie pomôcky využíva akúkoľvek záruku výrobcu, výslovne alebo implicitnú, na účinnosť výsledku po použíti pomôcky alebo na jej účinnosť pri riešení stavu postihnutia alebo akýkoľvek iný patologický alebo zdravotný problém. Výsledky v skutočnosti závisia od mnohých klinických hľadisk, až k hľadisku funkčnosti a životnosti pomôcky, ktoré sú mimo kontrolu výrobcu, medzi ktoré patria napríklad stav pacienta, chirurgický zárok pri implantácii alebo použití, spôsoby manipulácie s pomôckou po otvorení obalu.

Vzhľadom na tieto faktory sa zodpovednosť výrobcu vzťahuje iba na prípady, ak sa chyby vyskytli v čase jej uvedenia do prevádzky. V takom prípade musí zákazník pomôcku bezodkladne odvzdať výrobcovi, v súlade s podmienkami exspirácie a predpismi vyžadovanými zákonom. Výrobca si vyhradzuje právo preskúmať pomôcku považovanú za chybnú a zistíť, či sú na nej materiálové chyby ovplyvňujúce bezpečnosť. Zodpovednosť výrobcu je vylúčená, ak (i) reklamovaná chyba dôsledkom nesúladu pomôcky s povinným predpisom alebo záväzným ustanovením (a/alebo ii) chyba, ktorá spôsobila škodu, neexistovala v čase, keď výrobca pomôcku expedoval (a/alebo iii) pokiaľ stav technických a vedeckých poznatkov v čase, keď výrobca pomôcku expedoval, neumožňoval považovať ju za chybnú, a/alebo (iv) v každom inom prípade odlišnom od výsile uvedených, keď zákon výslove vylúčuje alebo obmedzuje zodpovednosť výrobcu za škodu spôsobenú chybnými výrobkami. Záruka za hľadisku výhradne výmenu chybej pomôcky za pomôcku rovnakého typu alebo jeho ekvivalentu vyrábanú výrobcom. Záruka je platná, iba ak bude pomôcka vrátená výrobcovi spolu s podrobnej písomnou správou o údajných chybách a nedostatkoch a, v prípade implantovanej pomôcky, dôvodov na jej vybratie z tela pacienta. Reklamované chyby sa musia okamžite hlásiť výrobcovi v súlade s podmienkami záruky a zákonnými predpismi. Po výmene pomôcky užinajte ako chybej výrobca uhradiť záklazníkovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vrátením pomôcky.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nedodržania spôsobov použitia a ochranných opatrení uvedených v tomto návode na obsluhu a v prípade použitia po dátume exspirácie.

Výrobca okrem toho odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s dôsledkami vyplývajúcimi z výberu alternatív liečby a spôsobov použitia alebo aplikácie pomôcky. Výrobca preto nemôže zodpovedať za žiadne škody akéhokoľvek

druhu, materiálne, biologické či morálne, po použíti pomôcky, ani za výber techniky implantácie použítej operatérom.

Zástupcovia a ani predstaviteľia výrobcu nie sú oprávnení zmeniť ktorokolvek z výšie uvedených podmienok, ani prijať žiadne ďalšie záväzky alebo poskytovať akékoľvek záruk'y v súvislosti s týmto výrobkom nad rámec podmienok uvedených výšie. Táto záruka podlieha talianskej legislatíve, pokiaľ nie sú povinne uplatňeny zákony inej krajiny, v prípade, že výrobca povolí pohyb pomôcky v jednom alebo viacerých štátov okrem Talianska.

SLOVENŠČINA

NITIDES

Sistem samorazširljive elucijske periferne žilne opornice Amphilimus™ (sirolim + maščobna kislina), prevlečen z materiálom „Carbofilm™“

1. OPIS PRIPOMOČKA

Družina priromočkov ENITiDES je sestavljena iz samorazširljive žilne opornice in uvajalhega sistema za njeno pravilno namestitev in uvedbo.

Žilna opornica je prožen, samorazširľiv priromoček za vsaditev. Izdelana je iz zlitine niklja in titana (nitinola) ter prevlečena s tanko ogljikovo plastjo „Carbofilm™“, katere turbostratna struktura z veliko gostoto je skoraj popolnoma enaka struktuře pirolitskego ogljika.

Prevleka na substratu zagotavlja, da je substrat zdržljiv z biološkimi in krvními lastnostmi pirolitskega ogljika, pri čemer ne spremeni njegovih fizičkih in strukturnih značilnosti.

Na žilni opornici je šest radioneoprepustnih označevalcev iz tantalita (po trije na vsakem koncu), ki omogočajo pravilno namestitev na mesto ciljne ležije. Žilna opornica ima po zunanjji površini namenske vdolbine, ki so v celoti prevlečene s plastjo „Carbofilm™“, v katerih je farmacevtski izdelek Amphilimus™, ki je sestavljen iz zdravilne učinkovine sirolimus in mešanice dolgovzržnih maščobnih kislin.

Specifični odmerek zdravilna na zdravljeno površino žile je približno 0,9 µg/mm², kar ustreza najmanjemu odmerku 270 µg za manjšo opornico (6,0 x 20 mm) in največjemu odmerku 2420 µg za večjo opornico (8,0 x 150 mm).

Uporabljeni **sistem za namestitev** je namenjen uvajanju po žici ter omogoča varno namestitev in razprtje žilne opornice na mestu ležije. Sistem je shematsko prikazan na Sliki 1 in je sestavljen iz:

- ohaja katetra (7) s premerom 6F iz:
 - uvažljivega zunanjega kanala, distalnega, polprozornega dela (3), ki vsebuje žilno opornico (4). Kanal ima radioneoprepusten obroc (13) blizu konice katetra;
 - notranje svetline, ki jo sestavlja navitje (6) in notranja cev (2), skozi katero lahko preide 0,035-palčna vodilna žica. Notranja svetlina sega po dolžini katetra od priključka luer (12), ki je nameščen proksimalno na ročaju, in se zaključi distalno na konici (1) v radioneoprepustnem materialu, tako da olajša postavljanje in namestitev žilne opornice v sistemu za slikanje. Omejevalnik (5), ki je vgrajen v notranjo svetlino, preprečuje aksialni premik žilne opornice med uvaženjem zunanjega kanala;

- ročaja (8) s sistemom za namestitev, ki omogoča postavljanje katetra in uvedbo žilne opornice in situ.

Ročaj ima ergonomsko obliko, zato ga operater zlahkoto uporablja celo z eno roko. Ima priključek luer (12) na proksimalnem koncu, ki se uporablja za izpiranje svetline vodilne žice, varnostni gumb (10), kolo (9) in rep za izvlačenje (11). Proizvajalec neposredno izdeluje sistem periferne žilne opornice in katetra za vstavitev ter skladno s standardi dobre proizvodne prakse izvaja vse kontrole kakovosti med postopkom izdelave in tudi na končnih izdelkih.

2. PREDVIDENA UPORABA PRIPOMOČKA

Sistem samorazširljive periferne žilne opornice je namenjen zdravljenju periferne arterijske bolezni, ki prizadene superficialno femoralno arterijo in proksimalno poplitealno arterijo.

3. INDIKACIJE PRIPOMOČKA

Priromoček je indiciran za zdravljenie stenoze femoropopliteálnih arterij nad kolenom pri odraslih sимptomatskih [kategorija po Rutherfordu 2-5] bolnikih. Zdravljena ležja dolzine največ 14 centimetrov, mora biti neprehodna ali s stenozo več kot 50%, nova ali restenozna in ki predhodno ni bila zdravljena z žilno opornico.

4. KONTRAINDIKACIJE

Uporaba žilne opornice je kontraindicirana v naslednjih primerih:

- ležje, ki jih ni mogoče zdraviti s postopkom PTA ali drugimi intervencijskimi tehnikami;
- nosečnice ali doječe matere;
- ležje v dveh distalnih tretjinah poplitealne arterije ali v kolenskem skelepu;
- klinično stanje, ki omejuje uporabo antiagregacijske in/ali antikoagulacijske terapije.

5. OPOZORILA

• Uporaba priromočka ni priporočljiva pri bolnikih z znano preobčutljivostjo ali alergiami na sirolimus, maščobne kisline (kot so stearinska kislina, palmitinska kislina in behenska kislina) ali kovinske komponente žilne opornice (kot so nikelj, titan in tantal).

• Priromoček je namenjen samo za enkratno uporabo. Priromočka ne smete ponovno uporabiti, obdelati ali sterilizirati. To lahko povzroči kontaminacijo priromočka in/ali okužbo bolnika, vnetje in prenos kužnih bolezni z bolnika na bolnika.

• Priromoček je zasnovan tako, da deluje kot sistem. Njegovih sestavnih delov ne smete nikoli uporabljati ločeno.

• Priromočka ne uporabljajte, če je bila ovojnina odprta ali poškodovana, če je bil nepravilno shranjen ali če je potekel navedeni rok uporabnosti. V teh primerih sterilitos' izdelka ni zagotovljena.

• Priromoček lahko uporabljajo le zdravnik, ki so ustrezno usposobljeni za izvajanje perkutane transluminálne angioplastike (PTA) in vsaditev perifernih žilnih opornic.

• Če med katerim kolikorakom postopka pride do neobičajnega upora, sistema ne uvajajte na silo: izvlecite sistem žilne opornice in celotni kateter za uvajanje, vodilno žico in uvajalnik kot celoto. Pretirana uporaba sile in/ali nepravilna uporaba sistema lahko povzroči nenamerno razprtje žilne opornice ali poškodujeta kateter za namestitev žilne opornice.

- Nepravilna uporaba kadar koli med posegom lahko povzroči disekcijo, perforacijo ali rupturo žile.
- Med nameščanjem ne uvedite ali izvlecite sistema žilne opornice, saj lahko hujše poškodujete žilne stene.
- Vsadite periferne samorazširljive žilne opornice lahko povzroči disekcijo žile distalno in/ali proksimalno na mesto žilne opornice ter akutno zaporo žile, ki zahteva dodaten poseg (kirurško zamenjavo žil, nadaljnjo dilatacijo, namestitev dodatnih žilnih opornic ali druge postopke).
- Delno razprte žilne opornice ni mogoče izvleči s sistemom za namestitev.

6. PREVIDNOSTNI UKREPI

- Nikoli ne uporabite sistema za hitri izpust na začetku razpiranja žilne opornice. Uporabite ga samo po potrebi, potem ko izpustite vsaj polovico dolžine žilne opornice.
- S pripomočkom je treba ravnati previdno, pri čemer se je treba izogibati stiku s kovinskiimi ali abrazivnimi instrumenti, ki ga lahko poškodujejo ali povzročijo mehanske spremembe.
- Pripomoček pred pripravo in nameščanjem ne sme priti v stik s tekočinami.
- Sistem za postavitev pripomočka ni namenjen za uporabo z injektorji s kontrastnim sredstvom.
- Pri vsaditvi žilnih opornic v paru se morajo ustrezni radioneprerepustni označevalci prekrivati. Prekrivata se lahko največ dve žilni opornici.
- Če se žilne opornice prekrivajo, se priporoča dolžina prekrivanja manj kot 20 mm.
- Pri uvajjanju vodilne žice ali balonskega katetra ali drugega pripomočka skozi nameščeno žilno oporno bodite izjemno previdni, da ne poškodujete žilne opornice.

7. INFORMACIJE O VARNOSTI PRI SLIKANJU Z MRI

Neklinična preizkušanja so pokazala, da so proizvajalčeve proizvodne linije žilne opornice iz nitinola pogojno združljive s slikanjem z magnetno resonanco. Bolnik s tem pripomočkom se lahko varno slika s sistemom MR pod naslednjimi pogoji:

- Statično magnetno polje 1,5 tesle (1,5 T) ali 3 tesle (3 T)
- Največji prostorski gradnji polje 6,140 G/cm (61,40 T/m)
- Največja stopnja specifične absorpcije (SAR) celotnega telesa v povprečju, poročana pri sistemu MR:
 - 1 W/kg (normalno delovanje) pri 1,5 T
 - 1 W/kg (normalno delovanje) pri 3 T

Radiofrekvenčno segrevanje

Pri zgoraj navedenih pogojih slikanja se pričakuje, da proizvajalčeve proizvodne linije žilne opornice iz nitinola proizvedejo največji dvig temperature manj kot 6,8 °C po 15 minutah neprekinitnega slikanja pri stopnji specifične absorpcije (SAR) celotnega telesa v povprečju 1,0 W/kg, poročane pri sistemu MR.

1,5 T 3 T

Konfiguracija z eno žilno oporno

Največja sprememb temperature ≤ 6,3 °C ≤ 6,2 °C

Konfiguracija s prekrivajočimi se žilnimi opornicami

Največja sprememb temperature ≤ 6,8 °C ≤ 6,3 °C

Artefakt pri slikanju z magnetno resonanco

Pri nekliničnem preskušanju se artefakt slike, ki ga povzroči pripomoček, razteza približno 0,7 cm od proizvajalčevih žilnih opornic iz nitinola pri slikanju s pulznim zaporejem, ki uporablja spinski odmev, in pulznim zaporejem, ki uporablja gradientni odmev, v sistemu za slikanje z magnetno resonanco 3 T.

8. DOBAVA

Pripomoček NiTiDES je dobavljen sterilen (z uporabo mešanice etilenoksida in CO₂) za enkratno uporabo in ovit v dve vrečki, ki ju ne smete prinesi v sterilno območje. **OPOMBA: Notranja vrečka je edina sterilna pregrada.**

Sterilnost in kemična stabilnost sta zagotovljeni, dokler je ovojnina nepoškodovana in do datuma izteka roka uporabnosti, natisnjenega na ovojnini (USE BEFORE DATE – ROK UPORABNOSTI).

Vsebina: en (1) sistem samorazširljive elucijske periferne žilne opornice Amphilimus™ (sirolim + maščobna kislina), prevlečen z materialom eCarbofilm™

9. SHRANJEVANJE

Izdelek je treba shranjevati, kot je navedeno na ovojnini, v hladnem in suhem prostoru pri temperaturi shranjevanja največ 25 °C.

10. MODELI

Pripomoček NiTiDES je označen s kodo modela in serijsko številko. Razpoložljive kode izdelkov so navedene v preglednici 1.

11. UPORABA ZDRAVLJIV

Študije iz klinične literaturre kažejo potrebo po antiagregacijskem zdravljenju pred kirurškim posegom, antikoagulacijskem zdravljenju med postopkom in antiagregacijskem zdravljenju po kirurškem posegu.

Antiagregacijsko zdravljenje v obdobju po postopku vključuje dajanje naslednjih zdravil:

- tienopiridini (tiklopidin ali klopiprodol ali prasugrel v odmerkah, ki so označeni v ustreznih navodilih, ali skladno z zdravnikovim receptom);
- aspirin v minimalni količini 100 mg/dan za nedoločen čas.

Glede na zahtevnost postopka in številne dejavnike, ki vplivajo na zdravstveno stanje bolnika, je odločitev o ustrezni obliki terapije prepričena zdravniku.

12. MEDSEBOJNO DELOVANJE ZDRAVIL

Čeprav specifični klinični podatki niso na voljo, lahko določena zdravila, ki delujejo prek istega vezavnega proteina (FKBP), (npr. takrolim) vplivajo na učinkovitost sirolimusa. Sirolimus se presnavlja s CYP3A4. Močni zaviralcii CYP3A4 lahko povzročijo večjo izpostavljenost sirolimusu, posebej v primeru, ko se uporablja več vsadkov. Upoštevati je treba tudi sistemsko izpostavljenost sirolimusu, če bolnik sočasno jemlje sistemsko imunosupresivna zdravila.

13. KLINIČNO PRESKUŠANJE S PРИПОМОЧКОМ NITIDES

Osnovna varnost in učinkovitost žilne opornice NiTiDES sta bili dokazani v ključnem kliničnem preskušanju ILLUMINA pred dajanjem na trg.

Zasnova študije: V multacentrični neprimerjalni študiji je bilo z žilno oporno NiTiDES zdravljenih 100 bolnikov s simptomatsko femoropoplitealno boleznjijo z ležijo dolžine največ 14 cm. Primarna učinkovitost (primarna prehodnost) in primarna končna točka varnosti (skupok hudič in neželenih dogodkov: smrt, amputacija uda, ishemija uda, ki zahteva operativno posredovanje ali operativno zdravljenje ciljne žile ali klinično revaskularizacijo ciljne ležije, poslabšanje ocene po Rutherfordu za dva razreda ali v razred 5 oz. 6) sta se primerjali s cilj objektivne izvedbe (ang. Objective Performance Goal, OPG) pri 12 mesecih.

Rezultati: Uspešnost postopka je bila dosežena v 100 %.

Rezultati za Dopplerjev ultrazvok kažejo 87-odstotno primarno prehodnost (77/89, 95-odstotni interval zaupanja 80–94), kar izpoljuje zahteve za OPG (73 %). Primarna prehodnost v obdobju 24 mesecev je bila 81-odstotna (63/78).

Primarna končna točka varnosti v obdobju 12 mesecev je bila 96,8-odstotna, kar izpoljuje zahteve za OPG (19,6 %), 2,2 % (2/93) bolnikov je imelo klinično revaskularizacijo ciljne ležije, 1,1 % (1/93) jih je umrlo, nobeden ni imel amputacije ciljnega uda, nobeden ni imel ishemije uda, ki zahteva operativno posredovanje ali operativno zdravljenje ciljne žile, in pri 1,1 % (1/90) je prišlo do poslabšanja ocene po Rutherfordu za dva razreda ali v razred 5 oz. 6.

Končna točka varnosti v obdobju 24 mesecev je bila 87-odstotna (79/90), 6,7 % (6/90) bolnikov je imelo klinično revaskularizacijo ciljne ležije, 3,3 % (3/90) jih je umrlo, nobeden ni imel amputacije ciljnega uda, 1,1 % (1/90) jih je imelo ishemijo uda, ki zahteva operativno posredovanje ali operativno zdravljenje ciljne žile, in pri 1,1 % (1/90) je prišlo do poslabšanja ocene po Rutherfordu za dva razreda ali v razred 5 oz. 6.

14. NAVODILA ZA UPORABO

Izbira pripomočka

Upoštevajte dolžino ciljne ležije, da določite ustrezno dolžino žilne opornice. Za ustrezno prekrivanje ležije mora biti dolžina nameščene žilne opornice na obeh straneh vsaj 5 mm daljša od same ležije.

Upoštevajte premer žile proksimalno in distalno na ležijo, da tako določite ustrezno velikost žilne opornice. Za varno namestitev žilne opornice kot osnovno za izbiro ustrezne velikosti žilne opornice uporabite večji premer. Pri izbiro modela upoštevajte informacije, navedene v preglednici 1.

Priprava pripomočka

Pred namestitevijo žilne opornice dajte bolniku heparin in se prepričajte, da je bolnikov aktivirani čas strejanja krvi (ang. Activated Clotting Time, ACT) zadosten glede na prakso vaše ustanove.

Med pripravo žilne opornice pazite, da ne pride v stik s tekočino.

- Odprite škatlo ter iz nje vzemite vrečo s sterilno vrečko.
- Ko preverite, ali je ovojnina poškodovana, odprite zunanjost nesterilno vrečko iz aluminijeve folije in nato odstranite vsebine iz notranje vrečke. (Opomba: Vrečka iz aluminijeve folije in zunanjost površina notranje plastične vrečke **NISTA STERILNI. STERILNA** je samo vsebina v plastični vrečki.)
- Nosilec postavite na ravno površino v sterilnem okolju, sprostite trak okrog ročaja in odstranite kateter iz začasnega navitja.
- Preverite, ali so na kateru volziči, pregi oziroma kakrsne kolik druge poškodbe. Poškodbe pripomočka lahko poslabšajo njegovo delovanje.
- Brizgo s prostornino 3 ml napolnite s heparinizirano fiziološko raztopino, jo priključite na priključek luer za izpiranje (slika 1, element 12) in vzpostavite nadtlak. Nadaljuje izpiranje, dokler fiziološka raztopina ne začne iztekat iz distalnega konca katete.
- Preglejte distalni konec katete in se prepričajte, da zunanj ki kanal prekriva celotno žilno oporno (slika 1, element 4).

Ne uporabljajte pripomočka, če je poškodovan, ali če je žilna opornica delno razprtta.

Združljivost z dodatno opremo

S pripomočkom NiTiDES se lahko uporabljajo uvajalni kanali s premerom 2,0 mm (6F) ali več.

S pripomočkom NiTiDES se lahko uporabljajo vodilne žice s premerom 0,89 mm (0,035 palca) ali manj. Togost vodilne žice in konfiguracijo konice izbere zdravnik glede na svoje klinične izkušnje.

Če je treba uporabiti vodilni kateter, so sistemi združljivi z vodilnimi katetri s premerom 2,7 mm (8F) ali več. V tem primeru poskrbite, da je pred začetkom uvajanja izbranega sestava hemostatska zaklopka popolnoma odprta.

Vstavljanje žilne opornice

a) Preverite, ali je varnostni gumb (slika 1, element 10) na držalu v zaklenjenem položaju (B).

b) Izpostavljeni del vodilne žice izperite s heparinizirano fiziološko raztopino, da odstranite sledi krvi in kontrastnega sredstva.

c) Uvajajte sistem po vodilni žici, dokler žilna opornica ne doseže mesta zdravljenja.

Če pride do neobičajnega upora, sistema ne uvajajte na silo: izvlecite uvajalnik, vodilno žico in pripomoček kot celoto. Pretirana uporaba sile in/ali nepravilna uporaba sistema lahko povzročita nenamerno razprtje žilne opornice ali poškodujeta kateter za namestitev žilne opornice.

Uvajanje pripomočka

a) Uvajajte sistem, dokler žilna opornica ne preide mesta ležije.

b) Povlecite sistem nazaj in poravnajte žilno oporno z ležijo.

c) Poskrbite, da je del sistema za namestitev, ki je zunaj bolnikovega telesa, prosto raztegnjen in raven.

Pozor: Nepravilno raztegnjen sistem za namestitev lahko povzroči razprtje žilne opornice naprej od mesta ciljne ležije.

Vsaditev in razprtje žilne opornice

- Ročaj čvrsto primite z eno roko in preverite, ali so radioneprerepustni označevalci

- na žilni opornici postavljeni proksimalno in distalno glede na lezijo.
- Poskrbite, da se uvajalni kanal med nameščanjem žilne opornice ne premika.
 - Zavritje varnostni gumb na ročaju v nasprotni smeri urnega kazalca (slika 1, B) da ga odklenete (KORAK 1), nato pa ga v celoti izvlecite (KORAK 2).
 - Ročaj držite fiksno glede na bolnika, nato pa znova preverite, ali so radioneoprepustni označevalci v želenem položaju glede na lezijo. Začnite nameščati žilno opornico tako, da vrite kolo (slika 1, element 9) s palcem v smeri puščice, kot je prikazano na sliki 1.
 - Pod fluoroskopijo, ko je distalni konec žilne opornice dobro pritrjen na žilne stene, nadaljujte nameščanje tako, da vrite kolo, dokler se konec žilne opornice ne odpre in ni popolnoma vsajen v žilne stene.
 - Če je potrebna hitra namestitev, izvedite naslednji postopek: prepričajte se, da ni ovir (na primer uvit ženski priključek luer) na zadnjem delu ročaja, primite zadnji del pripomočka (povlecite nazaj, slika 1, element 11) z drugo roko in ga potegnite, tako da držite sprednji del ročaja glede na bolnika popolnoma na miru, kot je prikazano na sliki 1.
 - Fluoroskopsko preverite, ali je žilna opornica popolnoma razprta.
 - Po potrebi lahko žilno opornico dodatno razprete z balonskim katetrom za PTA. Ko izbirate premer balonskega katetra in izvajate naknadno razpiranje, upoštevajte angiografsko ocenjeni premer žile. Žilne opornice nikoli ne razprite na premer, ki je večji od njenega nazivnega premera, navedenega na naleplki.
 - Končni premer žilne opornice mora ustrezati referenčnemu premeru žile.

15. MOŽNI NEŽELENI DOGODKI

Možni neželeni dogodki, ki so lahko povezani z vsaditvo periferne žilne opornice, vključujejo tveganja, povezana z perkutano transluminalno angioplastijo, in dodatna tveganja, povezana z uporabo žilnih opornic, kot je navedeno spodaj.

- Vnetje, bolečina in hemato na mestu dostopa
- Alergična ali neželena reakcija na kontrastno sredstvo, zdravila, ki se uporabljajo med postopkom, ali materiale, iz katerih je sestavljena žilna opornica
- Arterijski spazem
- Arterijska tromboza ali tromboza žilne opornice
- Anevrizma femoralne arterije ali pseudoanevrizma
- Arterosklerotična distalna embolizacija
- Krvavenje
- Smrt
- Disekcija, perforacija ali ruptura žile z nameščeno žilno opornico
- Embolija
- Ledvična odpoved
- Ishemija spodnjih udov (ki zahteva kirurški poseg)
- Restenoza arterije, v katero je bila vsajena žilna opornica
- Embolizacija žilne opornice
- Zapora žile ali preostala stenoza

16. ODGOVORNOST IN GARANCIJA

Proizvajalec zagotavlja, da je bil ta pripomoček zasnovan, izdelan in zapakiran z največjo skrbnostjo, ob uporabi tehnik, ki se smatrajo za najbolj primerne izmed tistih, ki so na voljo v trenutni tehnologiji, in ob uporabi načel vključevanja varnosti v zasnovu in izdelavo za zagotavljanje varne uporabe pod določenimi pogoji in za določene namene, ob upoštevanju predvidnostnih ukrepov, navedenih v prejšnjih odstavkih, ki bodo v največji možni meri zmanjšali, a ne popolnoma odpravili, tveganji, povezanih z uporabo pripomočka.

Pripomoček selahko uporablja le v okviru odgovornosti specializiranega zdravniškega osebja in ob upoštevanju tveganj ali možnih stranskih učinkov in zapletov pri terapiji, za katere je namenjen, vključno s tistimi, ki so omenjeni v drugih razdelkih te knjižice z navodili.

Tehnična zapletenosť, kritična narava zdravniških odločitev in metode uporabe pripomočka, vključujujoč jamstvo proizvajalca, bodisi izrecno ali posredno, za uspešen rezultat po uporabi pripomočka, ali za njegovo učinkovitost pri odpravljanju invalidnosti ali drugih patoloških ali zdravstvenih težav. Pravzaprav so rezultati, s kliničnega vidika in glede delovanja in trajanja pripomočka, odvisni tudi od številnih dejavnikov, na katere proizvajalec ne more vplivati, na primer kirurškega posega za vsaditev ali uporabe ter načinov ravnanja s pripomočkom po odpiranju ovojnje. Ti dejavniki so navedeni zgolj kot primeri in ne kot izčeren seznam bolnikovih stanj.

Ob upoštevanju teh dejavnikov je proizvajalec odgovoren le v primeru, ko je ugotovljeno, da so na pripomoček vplivale napake v času, ko je bil dan v promet. V takem primeru mora kupec takoj vrniti pripomoček proizvajalcu v skladu s pogoji poteka roka veljavnosti in zakonsko podlago; proizvajalec si pridržuje pravico, da pregleda pripomoček z domnevimi napakami in ugotovi, ali gre dejansko za napake, ki lahko vplivajo na varnost pripomočka. Odgovornost proizvajalca je izključena (i) če je do napake, ki se uveljavlja, prišlo zaradi skladnosti pripomočka z obvezujočim pravilom ali zavezujočo določbo in/ali (ii) če napaka, ki je povzročila škodo, ni obstajala, ko je proizvajalec dal pripomoček v promet in/ali (iii) če zaradi tehničnega in znanstvenega znanja v trenutku, ko je proizvajalec dal pripomoček v promet, pripomočka ni bilo mogoče določiti kot neutreznega in/ali (iv) v vseh drugih primerih, tudi če niso navedeni zgoraj, v katerih zakonodaja izrecno izključuje ali omrejuje odgovornost proizvajalca za škodo zaradi izdelkov z napako. Garancija obsegajo izključno zamjeno pripomočka z napako s pripomočkom proizvajalca enake ali enakovredne izdelave.

Garancija velja le, če je pripomoček pravilno vrnjen proizvajalcu skupaj s podrobnim pisnim poročilom o napakah, ki se uveljavlja, in razlogih za njegovo odstranitev iz bolnika, če je bil pripomoček vsajen. Napake, ki se uveljavljajo, je treba takoj prijaviti proizvajalcu v skladu s pogoj vračila in zakonsko podlago.

Po zamenjavi bo proizvajalec kupcu povrnil stroške, ki jih je utrel zaradi vračila pripomočka, za katerega je potrjeno, da ima napako.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za noben primer neupoštevanja metod uporabe in predvidnostnih ukrepov, navedenih v teh navodilih za uporabo, ter za primer uporabe pripomočka po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnji.

Poleg tega proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za posledice zaradi medicinskih odločitev in metod uporabe ali aplikacije pripomočka in zato

v nobenem primeru ne bo kazensko preganjан за nobeno materialno, biološko ali moralno škodo, ki je posledica aplikacije pripomočka ali izbire tehnike vsaditev, ki jo uporabi operater.

Zastopniki in predstavniki proizvajalca niso pooblaščeni za spreminjanje katerega koli prej omenjenega pogoja ali za prevzemanje kakršnih koli nadaljnji obveznosti ali za dajanje kakršnih koli garancij v zvezi s tem izdelkom, razen kot je navedeno zgoraj. To garancijo ureja italijanska zakonodaja, razen če velja obvezna zakonodaja druge države, če je proizvajalec pooblastil dajanje izdelka v promet tudi v drugih državah, ne samo v Italiji.

NORSK

NiTIDES

«Carbofilm™-belagt selvtvidende Amphilimus™ (sirolimus + fettsyre) eluerende perifert stentsystem

1. ENHETSBEKRIVELSE

NiTIDES-enhetssamlingen består av en selvtvidende stent og et leveringssystem for riktig plassering og distribusjon.

Stenten er en fleksibel, selvtvidende implanterbar enhet. Den er laget av nikkel og titanlegering (Nitinol) og belagt med «Carbofilm™», et tynt lag av karbon med en turbosfatisk struktur med høy tetthet, i det vesentlige identisk med det for det pyrolytiske karbonet.

Belegg av substratet gir det de biokompatible og hemokompatible egenskapene til pyrolytisk karbon, uten å påvirke de fysiske og strukturelle egenskapene til selve substratet.

Seks røntgentette tallmarkører påføres stenten (tre i hver ende) for å muliggjøre riktig plassering på stedet for målesjøen.

Den ytre overflaten på stenten har dedikerte spor, fullt belagt med «Carbofilm™», for å inneholde den farmasøytske formuleringen Amphilimus™, som består av legemidlet Sirolimus og en blanding av langkjedede fettsyre.

Den spesifikke medikamentdosen for den behandlede beholderoverflaten er ca. 0,9 µg/mm², noe som tilsvarende en minimumsdose på 270 µg på den mindre stenten (6,0 x 20 mm) og en maksimal dose på 2420 µg på den større stenten (8,0 x 150 mm).

Leveringssystemet som brukes, er en overvailerstype, som sikrer at stenten kan plasseres og frigjøres trygt ved lesjonen. Det er vist skjematiskt i figur 1 og består av:

- et katetherus (7) 6F i diameter sammensatt av:
 - en uttrekkbar ytre hylse, den distale, halvgjennomsiktige seksjonen (3) som inneholder stenten (4); hylsen har en røntgentett krage (13) nær tuppen av kateteret;
 - et indre lumen bestående av en spole (6) og et indre rør (2) som er kompatibelt med en 0,035 tommers ledevaier; det indre lumenet strekker seg langs kateteret fra et luerfeste (12) festet nær håndtaket og ender distalt ved spissen (1) i røntgentett materiale, for å forenkle stedet og plasseringen av stenten når den sees på et avbildningssystem. En stopper (5) integrert med det indre lumenet forhindrer aksial forskyvning av stenten under tilbaketrekkning av den ytre hylsen;
- et håndtak (8) med et leveringssystem som tillater posisjonering av kateteret og utplassering av stenten *in situ*.

Håndtaket har en ergonomisk utforming som gjør at operatøren kan gripe det og bruke det med én hånd. Det har en luerport (12) ved den proximale enden; som bruktes til å skylle ledevaierens lumen, en sikkerhetsnøkkel (10), et hjul (9) og en halekrok (11).

Produsenten produserer det perifere stent + utpasseingskatetersystemet direkte og implementerer alle kvalitetstrollprosedyrer både under produksjon og på de ferdige produktene i samsvar med retningslinjene for god produksjonspraksis.

2. TILTENKT BRUK AV ENHETEN

Det selvtvidende perifere stentsystemet er ment for behandling av perifer arteriesydom som påvirker den overfladiske lårarterien og den proximale popliteale arterien.

3. INDIKASJON AV ENHETEN

Enheten er indikert for behandling av stenose av femoropopliteale arterier over kneet hos voksne symptomaticke [Rutherford category 2-5] pasienter. Den behandlede lesjonen, med en maksimal lengde på 14 centimeter, må enten være okkludert eller med stenose høyere enn 50 %, de-novo eller restenotisk, ikke tidligere behandlet med en stent.

4. KONTRAINDIKASJONER

Bruk av stenten er kontraindusert i følgende situasjoner:

- Lesjoner ansett som ubehandlingsbare med PTA eller andre intervensjons teknikker.
- Kvinner som er gravide, ammer.
- Lesjoner lokalisert i de to distale tredjedeler av popliteal arterie eller ved kneleddet.
- Kliniske tilstander som forhindrer bruken av blodplate- og/eller antikoagulasjonsbehandling.

5. ADVARSEL

- Bruk av enheten anbefales ikke hos pasienter med kjent overfølsomhet eller allergi mot Sirolimus, fettsyrer (som stearin, palmitinsyre, behensyre) eller metallkomponentene i stenten (som nikkel, titan og tantal).
- Enheten er kun beregnet til engangsbruk. Må ikke gjenbrukes, resirkuleres eller resteriliseres. Dette kan føre til foreurensningsrisiko på enheten og/eller infeksjoner hos pasienten, betennelse og overføring av smittsomme sykdommer fra pasient til pasient.
- Enheten er konstruert til å fungere som et system. Ikke bruk komponentene separat.
- Ikke bruk enheten hvis emballasjen er åpnet eller skadet, feil lagret, eller hvis den oppgitte utløpsdatoen er passert. I slike tilfeller er ikke produktsterilitet garantert.
- Enheten skal bare brukes av leger som er oppplært spesielt til å utføre perkutan transluminal angioplastikk (PTA) og perifer stentimplantasjon.
- Hvis det oppstår motstand på et hvilket som helst trinn i prosedyren, må du ikke tvinge systemet: trekk ut stentsystemet og hele leveringskateteret, ledevaier og innføringsenheten som en enkelt enhet. Bruk av overdreven kraft og/eller feil håndtering kan føre til at stenten blir utplassert ved et uehell eller i skade på plasseringskateret.

- Når som helst under drift, kan feil håndtering forårsake dissekjon, perforering eller brudd på blodkaret.
- Ikke før frem eller trekk ut stentsystemet under utplasseringen: det kan forårsake alvorlig skade på blodkaretets vegger.
- Implantasjonen av en selvtvidende perifert stent kan forårsake dissekjon av blodkaret distalt og/eller proksimalt av stenten og kan også forårsake akutt blokering av blodkaret, noe som gjør en ytterligere operasjon nødvendig (kirurgisk vaskulær erstattningsoperasjon, ytterligere utvidelse, utplassering av ekstra stenter eller andre prosedyrer).
- Når stenten er delvis distribuert, kan den ikke hentes inn ved hjelp av leveringssystemet.

6. FORHOLDSREGLER

- **Bruk aldri hurtigutørsystemet i begynnelsen av stentutvidelsen.** Bruk det bare hvis nødvendig, etter å ha sluppet løs minst halvparten av lengden av stenten.
- Enheten skal håndteres forsiktig slik at du unngår kontakt med metalliske eller slipende instrumenter som kan skade den eller medføre mekaniske endringer.
- Enheten skal ikke komme i kontakt med væsker før klargjøring og posisjonering.
- Enheten sin plasseringssystem er ikke ment for bruk med kontrastmediuminjektorer.
- Der stenter implantes i tandem, skal de relative røntgentette markørene overlappe hverandre. Overlapping skal ikke involvere mer enn to stenter.
- Ved overlappende stenter anbefales mindre enn 20 mm overlappende lengde.
- For å unngå å skade stenten, må du være ekstremt forsiktig når du fører en ledevaier eller et ballongkatereter eller en annen enhet gjennom stenten som er utplassert.

7. MR-SIKKERHETSINFORMASJON

Ikke-klinisk testing har vist at produsentens Nitinol-stentproduktlinjer er MR-betingede. En pasient med denne enheten kan trygt skannes i et MR-system som oppfyller følgende betingelser:

- Statisk magnetfelt på 1,5 Tesla (1,5 T) eller 3 Tesla (3 T)
- Maksimal romlig feltgradient på 6,140 G / cm (61,40 T / m)
- Maksimalt rapportert MR-system, gjennomsnittlig spesifikk absorpsjons-hastighet (SAR) for hele kroppen på:
 - 1 W/kg (normal driftsmodus) ved 1,5 T
 - 1 W/kg (normal driftsmodus) ved 3 T

RF-oppvarming

Under skanneforholdene som er definert ovenfor, forventes produsentens Nitinol-stentproduktlinjer å produsere en maksimal temperaturøkning på mindre enn 6,8 °C etter 15 minutter med kontinuerlig skanning ved et rapportert MR-system, gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonshastighet (SAR) på hele kroppen på 1,0 W/kg.

Konfigurasjon av enkeltstent

Høyeste temperaturøkning

Overlappende konfigurasjon av stent

Høyeste temperaturøkning

1,5 T	3 T
≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C

MR-artefakt

I ikke-klinisk testing strekker bildeartefakten forårsaket av enheten ca. 0,7 cm fra produsentens Nitinol-stenter når den er avbildet med gradient-ekko og spinnoppleggsseksjoner i et 3 T MR-system.

8. SLIK LEVERES ENHETEN

NiTIDES-enheten leveres steril (ved bruk av etylenoksyd og CO₂-blanding), for engangsbruk, pakket i to poser som ikke må føres inn i et sterilt område. **OBS: innerposen er den eneste sterile barrieren.**

Sterilitet og kjemisk stabilitet er garantert mens pakken forblir intakt og til utløpsdatoen som er trykt på emballasjen (UTLØPSDATO).

Innhold: ett (1) «Carbofilm™-belagt selvtvidende Amphilimus™ (sirolimus + fettsyre) eluerende perifert stentsystem

9. OPPBEVARING

Produktet skal oppbevares som angitt på emballasjen, på et kjølig og tørt sted med oppbevaringstemperatur på maks 25 °C.

10. MODELLER

NiTIDES-enheten er identifisert av en modellkode og et partinummer. Tilgjengelige produktkoder er oppført i tabell 1.

11. MEDIKAMENTREGIME

Studier i klinisk litteratur indikerer behovet for å administrere antiblodplate-behandling før operasjon, antikoagulantbehandling under prosedyren og antiblodplatebehandling etter operasjon.

Blodplatebehandling i perioden etter prosedyren innebærer administrering av:

- Ticlopyridiner (tiklopidin eller klopidogrel eller Prasugrel) i dosene angitt i de respektive instruksjonsheftene eller i henhold til resept
- Aspirin til minst 100 mg/dag på ubestemt tid

Gitt kompleksiteten i prosedyren og de mange faktorene som påvirker pasientens tilstand, overslates definisjonen av riktig behandling til legen.

12. INTERAKSJONER MED MEDIKAMENTER

Selv om ingen spesifikke kliniske data er tilgjengelige, kan enkelte medikamenter, f.eks. takrolimus, som virker gjennom det samme bindingsproteinet (FKBP), forstryre effekten av Sirolimus. Sirolimus metaboliseres av CYP3A4. Sterke CYP3A4-hemmere kan forårsake økt eksponering for Sirolimus, spesielt når det gjelder flere implantater. Systemisk eksponering for Sirolimus hvis pasienten tar samtidig systemiske immunsuppressive legemidler, må også vurderes.

13. KLINISK FORSØK MED NITIDER

Hovedsikkerhet og effektivitet av NITIDES-stenten er etablert fra det viktigste kliniske forsøket ILLUMINA for markedet.

Design av studien: I en multisenterstudie med enkeltarm, ble 100 pasienter med symptomatisk femoropopliteal sykdom med en maksimal lesjonslengde på 14 cm behandlet med NITIDES-stenten. Den primære effekten (primær patency) og det primære sikkerhetsendepunktet (en sammensettning av de største bivirkningene: død, amputasjon av málbenet, iskemi av málbenet som krever kirurgisk inngrep eller kirurgisk reparasjon av málkar eller klinisk drevet revaskularisering av mállesjonen, forverring av Rutherford-poengsummen med 2 klasser, eller til klasse 5 eller 6) ble sammenlignet med et Objective Performance Goal (OPG) etter 12 måneder.

Resultater: Prosedyresuksess ble oppnådd i 100 %.

Resultatene for Doppler-ultradlyd viser primær patency på 87 % (77/89, 95 % konfidensintervall 80–94), som oppfyller kravene i OPG (73 %). 24 måneders primær patency var 81 % (63/78).

Det 12 måneders primære sikkerhetsendepunktet var 96,8 % (90/93), som oppfyller kravene i OPG (19,6 %), 2,2 % (2/93) av pasientene hadde klinisk drevet revaskularisering av mállesjonen, 1,1 % (1/93) døde, 0 hadde amputasjon av málbenet, 0 hadde iskemi av málbenet som krever kirurgisk inngrep eller kirurgisk reparasjon av málkar og 0 hadde forverring av Rutherford-poengsummen med to klasser, eller klasse 5 og 6.

Sikkerhetsendepunktet på 24 måneder var 87,8 % (79/90), 6,7 % (6/90) av pasientene hadde klinisk drevet revaskularisering av mállesjon, 3,3 % (3/90) døde, 0 hadde amputasjon av málbenet, 1,1 % (1/90) hadde iskemi av málbenet som krever kirurgisk inngrep eller kirurgisk reparasjon av málkar og 1,1 % (1/90) hadde forverring av Rutherford-poengsummen med to klasser, eller klasse 5 og 6.

14. BRUKSANVISNING

Valg av enhet

Se lengden på mállesjonen for å fastslå lengden på stenten som kreves. For å dekke lesjonen på riktig måte, må den distribuerte stentlengden være minst 5 mm lengre enn selve lesjonen på hver side.

Se diametertren på karet nærmest og distalt av lesjonen for å fastslå passende stentstørrelse. For å sikre en sikker plassering av stenten, bruk større diameter som grunnlag for å velge riktig stentstørrelse. Når du velger modellen, se informasjonen i tabell 1.

Klargjøring av enheten

Før stentlevering skal du administrere heparin og kontrollere at pasientens aktiverete koaguleringstid (ACT) er tilstrekkelig i samsvar med praksisen ved sentret.

Vær spesielt forsiktig så du ikke lar væske komme i kontakt med stenten under klargjøring av systemet.

- Apne esken og ta ut posen som inneholder den sterile posen.
- Etter a ha undersøkt pakken for eventuelle skader, apner du den eksterne ikke-sterile folieposen og fjerner innholdet fra den indre posen. (Merk: Aluminiumsfolieposen og den ytre overflaten av den indre plastposen **ER IKKE STERIL**. Bare innholdet i plastposen er STERILT).
- Pass på å plassere støtten på en flat overflate i et steril område, løsne båndet rundt håndtaket og ta kateretet ut av beskyttelsesspolen.
- Kontroller at leveringskataretet ikke utsættes for knekk, bøyninger eller andre skader. Skader på enheten kan svekke ytelsen.
- Fyll en 3 ml sprøyte med en fysiologisk løsning som inneholder heparin, koble til luerfestet for spyling (figur 1, punkt 12) og påfør positiv trykk. Fortsett å skylle til den fysiologiske løsningen kommer ut fra den distale enden av kateretet.
- Undersøk den distale enden av kateretet, og pass på at stenten (figur 1, element 4) er dekket helt av den ytre hylsen.

Ikke bruk enheten hvis den er skadet eller hvis stenten er delvis utvitet.

Kompatibilitet med tilbehør

Introduksjonsnål med diameter 6F (2,0 mm) eller større kan brukes med NITIDES-enheten.

Ledevåp på 0,035 tommer (0,89 mm) eller mindre kan brukes med NITIDES-enheten. Valg av stivhet i ledevaierne og konfigurasjon av spissen vil avhenge av legens kliniske erfaring.

Skulle det være nødvendig å bruke et ledekataret, er systemene kompatible med ledekataret med diameter 8F (2,7 mm) eller større. I dette tilfellet må du forsikre deg om at den hemostatiske ventilen er helt åpen før du fører inn den valgte enheten.

Stentinnføring

- Forsikre deg om at sikkerhetsnøkkelen (figur 1, element 10) på håndtaket er i låst posisjon (detalj B).
- Vask den eksponerte delen av ledavaierne med en fysiologisk løsning som inneholder heparin, for å fjerne spor av blod og kontrastmidel.
- Før systemet over ledavaierne til stenten når behandlingsstedet.

Hvis du når som helst opplever uvanlig motstand, må du ikke tvinge systemet: trekk inn innføringsenheten, ledevåleren og enheten som en enkelt enhet. Bruk av overredven kraft og/eller feil håndtering kan føre til at stenten blir utplassert ved et uhell eller i skade på plasseringskataretet.

Føre frem enheten

- Før systemet til det punktet hvor stenten er utenfor lesjonen.
- Trekk systemet tilbake til stenten er på linje med lesjonen.
- Kontroller at delen av leveringssystemet utenfor pasientens kropp er fritt utvitet og rett.

Forsiktig: hvis leveringssystemet ikke forlenges ordentlig, kan stenten distribueres utover mállesjonen.

Stentimplantasjon og ekspansjon

- Ta godt tak i håndtaket med den ene hånden, og kontroller at de røntgentette markørene på stenten er plassert nært og distalt i forhold til lesjonen.

b) Forsikre deg om at innføringsenhethylsen ikke beveger seg under utplasseringen av stenten.

c) Drei sikkerhetsnøkkelen på håndtaket mot klokken (figur 1, detalj B) for å løse den opp (TRINN 1), og trekk den deretter helt ut (TRINN 2).

d) Hold håndtaket i en fast stilling i forhold til pasienten, og kontroller igjen at de røntgentette markørene er i ønsket posisjon i forhold til lesjonen; begynn å distribuere stenten ved å vri hjulet (figur 1, element 9) med tommelen i pilens retning, som vist på figur 1.

e) Under fluoroskop, når den distale enden av stenten er godt festet til karvegogene, fortsetter du distribusjonen ved å vri på hjulet til enden av stenten åpnes og den er helt implantert i karvegogene.

f) Hvis rask utplassering er nødvendig, gjør du slik: sorg for at det ikke er noen hindringer (f.eks. hunn-luerfeste fastskrudd) i bakenden av håndtaket, ta tak i den bakre enden av enheten (trekk tilbake, figur 1, element 11) med den andre hånden og trekk den, og hold den fremre delen av håndtaket i forhold til pasienten helt rolig, som vist på figur 1.

g) Kontroller fluoroskopisk at stenten har utvitet seg fullstendig.

h) Stenten kan utvides ytterligere, om nødvendig, ved hjelp av et PTA-balloonkataret. Når du velger diametern på ballongkataretet og når du utfører postutvidelsen, kan du se diametern på karet som er evaluert ved hjelp av angiografi. Vær under alle omstendigheter forsiktig så du ikke utvider stenten utover den nominelle diametern, angitt på etiketten.

i) Den endelige diametern på stenten må være egnet for referansekartets diameter.

15. POTENSIELLE BIVIRKNINGER

De mulige bivirkningene som kan være forbundet med implantasjon av en perifer stent inkluderer risiko knyttet til perkutan transluminal angioplastikk og ytterligere risiko forbundet med bruk av stenter, er som angitt nedenfor.

- Tilgang til infeksjon, smerte og hematom på stedet
- Allergisk eller bivirkning mot kontrastmiddelet, medikamenter som brukes under prosedyren eller materialer stenten består av
- Arteriell krampe
- Arteriell eller stentrombose
- Femoral arterieaneurisme eller pseudoaneurisme
- Aterosklerotisk distal embolisering
- Blødning
- Død
- Disseksjon, perforering eller brudd på det stentede karet
- Emboli
- Nyresvikt
- Ischemi i underekstremitet (krever kirurgisk inngrep)
- Restenosie av arterien der stenten ble implantert
- Stentembolisering
- Blokkarokklusjon eller uløst stenose

16. ANSVAR OG GARANTI

Produsenten sørger for at enheten er designet, produsert og pakket med stor forsiktighet ved hjelp av teknikkene som anses som mest passende blant de som er tilgjengelige i dagens teknologiske tilstand og anvender prinsipper for integrering av sikkerhet i design og konstruksjon for å sikre sikker bruk når den brukes under de vilkår og for de tiltenkte formål som respekterer forholdsreglene angitt i de foregående avsnittene, og i alle fall rettet mot å redusere risikoen knyttet til bruken av enheten så langt som mulig, men ikke å helt eliminere denne. Enheten må brukes utelukkende under ansvar av spesialisert medisinsk personell og under hensynsgang til gjenværende risiko og mulige bivirkninger og komplikasjoner av behandlingen som den var ment for, inkludert de som er nevnt i de andre delene av dette instruksjonsheftet.

Den tekniske kompleksiteten og den kritiske arten av medisinske valg og bruksmåter for enheten utelukker enhver garanti fra produsenten, eksplisitt eller implisitt, om effektiviteten av resultatet etter bruk av enheten, eller for dets effektivitet i å løse en tilstand av funksjonshemming eller annen patologi eller medisinsk problem. Resultatene, både fra at klinisk synspunkt og med tanke på funksjonalitet og varighet av enheten, avhenger også av mange faktorer som er utenfor produsentens kontroll, blant annet er de bare nevnt som eksempler og ikke uttømmende forhold for pasienten, den kirurgiske prosedyren for implantering eller bruk, metoden for manipulering av enheten etter åpning av pakken.

I lys av disse faktorene eksisterer produsentens ansvar bare hvis det er konstatert at enheten ble påvirket av feil da den ble satt i omlopp. For dette formålet må kunden umiddelbart stille enheten til disposisjon for produsenten, i samsvar med vilkårene for utløp og resept som kreves i henhold til lov; produsenten forbeholder seg retten til å undersøke enheten som anses å være feil, og å fastslå om den faktisk er påvirket av mangler som kan påvirke produkts sikkerhet. Produsentens erstatningsansvar er ekskludert hvis (i) den påståtte mangelen skyldes overholdelse av enheten med en obligatorisk regel eller en bindende bestemmelse, og/eller (ii) mangelen som forårsaket skaden ikke eksisterer da produsenten slapp enheten og/eller (iii) hvis tilstanden til teknisk og vitenskapelig kunnskap på det tidspunktet produsenten utgir enheten, ennå ikke tilslater at enheten blir ansett som defekt, og/eller (iv) i noe annet tilfelle, også forsiktig fra de angitt ovenfor, der loven eksplisitt ekskluderer eller begrenser produsentens ansvar for skade på grunn av defekte produkter. Garantien består utelukkende i å erstatte den defekte enheten med en annen av samme eller tilsvarende produsenttype.

Garantien gjelder bare hvis enheten returneres riktig til produsenten sammen med en skriftlig og detaljert rapport om de påståtte feilene, og i tilfelle en implantert enhet, om årsaken til fjerning fra pasienten. De påståtte feilene må rapporteres umiddelbart til produsenten i samsvar med vilkårene for fortapelse og lovpålagt resept.

Når erstatningen er utført, vil produsenten refundere kunden de utgiftene han har pådratt seg for retur av den anerkjente defekte enheten.

Produsenten fraskriver seg alt ansvar i tilfelle manglende overholdelse av bruksmetodene og forholdsreglene angitt i denne bruksanvisningen, og i tilfelle bruk etter utløpsdatoen som er angitt på pakken.

Videre fraskriver produsenten seg alt ansvar for konsekvensene av medisinske valg og metodene for bruk eller anvendelse av enheten, og vil derfor under ingen omstendigheter bli tiltalt for materiell, biologisk eller moralisk skade av noe slag som følge av anvendelsen av enheten og valg av implantatteknikk som brukes av operatøren.

Produsentens agenter og representanter er ikke autorisert til å endre noen av de ovennevnte forholdene, heller ikke å forplikte seg eller å gjøre noen garanti i forhold til dette produktet, annet enn det som er angitt ovenfor. Denne garantien er underlagt italiensk lov, med mindre de obligatoriske lovene i en annen stat anvendes, i tilfelle produsenten har godkjent sirkulasjonen av produktet i én eller flere andre stater enn Italia.

МАКЕДОНСКИ

NITIDES самопротиривачки Amphilimus™ (сиролим + масни киселини) екстракриарички периферен стент систем обложен со „Carbofilm™“

1. ОПИС НА УРЕДОТ

Семејството уреди NiTiDES се состои од самоширечки стент и систем за негово правилно позиционирање и поставување.

Стентот е флексибилен самоширечки уред кој може да се имплантира. Направен е од легура од никел и титаниум (Нитинол) и обложен е со „Carbofilm™“, тенок слој јаглерод со турбостратска структура со висока густина, во суштина идентична со онаа на пиролитскиот јаглерод. Обложувањето на супстратот му дава биокомпабилни и хемокомпабилни карактеристики на пиролитскиот јаглерод, без притоа да влијае врз физичките или структурните карактеристики на самият супстрат.

На стентот се поставени шест радио-непропусни маркери (по три на секој крај) за да се овозможи точно поставување на местото на целината лезија. На надворешната површина на стентот има наменски жлебови, целосно обложени со „Carbofilm™“, во кои е сместена фармацевтската формулација Amphilimus™, која е составена од некот Сиролимус и од мешавина на масни киселини со долги низи.

Конкретната доза на лекот за третирања површина на садот е околу 0,9 µg/mm², што одговара на минимална доза од 270 µg за поголем стент (6,0x20 mm) и максимална доза од 2420 µg за поголем стент (8,0x150 mm).

Системот за доставување кој се користи е од типот "преку жица", со што се осигурува дека стентот може да биде позициониран и безбедно објоден на местото на повредата. Тој е шематски прикажан на Слика 1 и се состои од:

- тело на катетерот (7) со дијаметар од 6F, составен од:
 - надворешна навлака која се вовлекува, дистален полупропусрен дел (3) кој содржи стентот (4); навлаката има радионепропусен прстен (13) близу до врвот на катетерот;
 - внатрешен лumen кој содржи спирала (6) и внатрешна цевка (2) компатибилна со водечка жица со пречник од 0,035 инчи; внатрешниот лumen се протега долж катетерот од луер приклучокот (12) проксимално прицврстен на раката и завршува на врвот (1) на радионепропусниот материјал, за да се оплесни локацијата и поставувањето на стентот кога се гледа преку радиографската опрема. Границник (5) интегриран со внатрешниот лumen спречува аксијално поместување на стентот за време на вовлекувањето на навлаката;
- рака (8) со систем за доставување, кој овозможува позиционирање на катетерот и поставување на стентот на местото.

Раката има ергономски дизајн кој му овозможува на операторот да го држи и користи дури и со една рака. Таа има луер влез (12) на проксималниот крај, што се користи за плакирање на луменот на водечката жица, безбедносен клуч (10), тркало (9) и заден дел што може да се влоче (11).

Производителот самојот го произведува системот периферен стент + катетерот за поставување и го применува сите постапки за контрола на квалитетот, како за време на производството, така и на крајниот производ, во согласност со упатствата за добра производна практика.

2. НАМЕНЕТА УПОТРЕБА НА УРЕДОТ

Системот на самоширечки периферен стент е наменет за третирање на болест на периферните артерии која влијае на површинската феморална артерија и проксималната поплитеална артерија.

3. ИНДИКАЦИЈА НА УРЕДОТ

Уредот е индициран за третман на стеноза на феморопоплитеални артерии над коленото кај возрасни симптоматски пациенти [категорија Ратерфорд 2-5]. Третирањата лезија, со максимална должина од 14 сантиметри, мора да биде оклузирана или со стеноза поголема од 50 %, де-ново или рестенотична, претходно нетретирана со стент.

4. КОНТРАИНДИКАЦИИ

Употребата на стентот е контраиндицирана во следниве ситуации:

- Лезии кои се сметаат невозможни за лекување со РТА или други интервенциски техники.
- Бремени жени, доилки.
- Лезии кои се наоѓаат во двете дистални третини на поплитеалната артерија или кај зглобот на коленото.
- Клинички состојби кои ја ограничуваат употребата на анти-агрегатна и/или антикоагулантна терапија.

5. ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- Употребата на уредот не се препорачува кај пациенти со хиперсензитивност или алергија на сиролимус, масни киселини (како стеаринска киселина, пальмитинска киселина, бехенична киселина) или на металните компоненти на стентот (како никел, титаниум и тантал).
- Уредот е наменет за еднократна употреба. Не смее повторно да се користи, да се процесира или стерилизира. Тоа може да предизвика опасност од загадување за уредот и/или инфекции на пациентот, воспалување и пренос на инфективни болести од пациент на пациент.
- Уредот е дизајниран да функционира како систем. Неговите делови не смеат да се користат одделно.
- Уредот не смее да се користи доколку неговото пакување е отворено или оштетено, доколку е неправилно складиран или е изминат рокот за употреба. Во таков случај стерилината не е загарантирана.
- Уредот треба да го користат само лекари специјално обучени за изведување на перкутана транслуминална ангиопластика (РТА) и вградување периферни стентови.
- Доколку се почувствува отпор во која било фаза од процедурата, не

форсирајте го системот: извлечете го системот на стентот и целиот катетер за поставување, водечката жица и воведувачот како една единица. Примената на прекумерна сила и/или неправилно ракување може да доведат до случајно поставување на стентот или оштетување на катетерот за поставување.

- Во која било фаза од постапката, неправилното ракување може да предизвика дисекции, перфорации или прокање на садот.
- Не го туркајте или повлекувајте стент системот за време на поставувањето: може да предизвика сериозно оштетување на сидовите на садовите.
- Вградувањето на самоширечкиот периферен стент може да предизвика дисекција на садот дистално и/или проксимално од стентот и исто така може да предизвика акутна блокада на садот, предизвикувајќи потреба од дополнителна операција (операција за хируршка замена на садови, натамошна дилатација, поставување на дополнителни стентови или други процедури).
- Откако стентот е делумно поставен, не може да биде извлечен со користење на системот за поставување.

6. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

- **Никогаш не смее да се користи** системот за брзо ослободување на почетокот на ширењето на стентот. Користете го **само доколку е неопходно**, по ослободувањето на најмалку половина од должината на стентот.
- Со уредот треба внимателно да се ракува за да се избегне допир со метален или абривзен прибор кој може да го оштети или да предизвика механички промени.
- Уредот не смее да дојде во допир со течности пред подготовката и поставувањето.
- Системот за поставување на уредот не е предвиден да се користи со инжектори на контрастни средства.
- На оние места каде стентовите се имплантирани во двојки, соодветните радио-непропустни маркери треба да се преклопуваат. Преклопувањето не треба да вклучува повеќе од два стента.
- Во случај на стентови кои се преклопуваат, се препорачува помалку од 20 mm должина на преклопување.
- За да се избегне оштетување на стентот, видете исклучително внимателни кога проравите водечка жица или балонски катетер или друг уред низ стент кој штотку бил поставен.

7. ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА MRI

Неклиничките тестирања покажаа дека линиите производи на Nitinol стентови на производителот се MR Conditional. Пациент што го има овој уред може безбедно да се скенира со MR-систем доколку се исполнети следниве услови:

- Статично магнетно поле од 1,5-Tesla (1,5T) или 3-Tesla (3T)
- Максимален просторен градиент на поле од 6.140 G/cm (61,40 T/m)
- Максимална пријавена MR на систем, просечна специфична стапка на апкорција (SAR) на целото тело од:
 - 1 W/kg (Нормален режим на работа) на 1,5T
 - 1 W/kg (Нормален режим на работа) на 3T

Загревање при RF

Според условите за скенирање утврдени погоре, линиите производи на Nitinol стентови на производителот се очекува да произведат максимално зголемување на температурата од помалку од 6,8 °C со 15 минути континуирано скенирање на пријавен MR систем, просечна специфична стапка на апкорција (SAR) на целото тело од 1,0 W/kg.

	1,5 T	3T
--	-------	----

Конфигурација на единичен стент

Промена на највисоката температура	≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
------------------------------------	----------	----------

Конфигурација на преклопувачки стентови

Промена на највисоката температура	≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C
------------------------------------	----------	----------

Артефакт од MR

Во неклиничките тестирања, артефактот на скената што го предизвика уредот се издолжува приближно 0,7 см од Nitinol стентовите на производителот кога се снима со пулсна секвенца на градиент-ехо и спин echo во MRI-систем од 3T.

8. КАКО СЕ ИСПОРАЧУВА

Уредот NiTiDES се испорачува стерилен (со користење на мешавина од етилен оксид и CO₂), за една употреба, спакуван во две обвивки, така што нема потреба да се чува на стерилен место. **ЗАБЕЛЕШКА: внатрешната обвивка е единственствената стерилина заштита.**

Доколку пакувањето биде нештетено, стерилноста и хемиската стабилност се загарантани до крајот на рокот на траење отпечатен на пакувањето (УПОРЕДЕЛБИО ДО).

Содржина: еден (1) самопроширувачки Amphilimus™ (сиролим + машински киселин) екстракиранки периферен стент систем обложен со eCarbofilm™

9. СКЛАДИРАЊЕ

Производот треба да се чува како што е означено на пакувањето, на ладно и суво место, на максимална температура на складирање од 25 °C.

10. МОДЕЛИ

Уредот NiTiDES се идентификува со код на моделот и број на серијата; достапните кодови на производите се наведени во tabela 1.

11. РЕЖИМ НА ЛЕКАРСТВА

Испитувањата во клиничката литература укажуваат на потребата од давање анти-агрегантна терапија предоперативно, анти-коагулантна терапија за време на процедурата и анти-агрегантна терапија постоперативно.

Антиагрегантната терапија во периодот по постапката вклучува давање на:

- тиенопиридини (тиколипидин или клопидогрел или прасугрел во дози

назначени во соодветните упатства или со лекарскиот рецепт)

- аспирин во минимална доза од 100 mg/ден, неодредено

Поради сложеноста на процедурата и многуте фактори кои влијаат на состојбата на пациентот, одредувањето на соодветна терапија е оставено на изборот на лекарот.

12. ИНТЕРАКЦИИ СО ЛЕКОВИ

Иако нема конкретни клинички податоци, одредени лекови, како што е таクロнимус, кој дејствуваат преку истиот врзувачки протеин (FKBP), можат да влијаат на ефикасноста на сиролимус. Сиролимусот се метаболизира преку CYP3A4. Силните CYP3A4 инхибитори можат да предизвикаат поголемо изложување на сиролимус, особено во случај на повеќи имплантанти. Исто така, мора да се земе предвид и системскиот изложување на сиролимус, доколку пациентот прима придружни системски имуносупресивни лекови.

13. КЛИНИЧКО ИСПИТУВАЊЕ СО NITIDES

Основан на безбедност и ефикасност на стентот NiTiDES се утврдени од клучното клиничко испитување пред пуштање на пазарот, ILLUMINA.

Дизајн на студијата: Во рамки на повеќекентрична единечна (single arm) студија, 100 пациенти со симптоматска фемороплитеална болест со максимална должина на лезијата од 14 см беа третирани со стент NiTiDES. Примарната ефикасност (примарна проодност) и крајната точка на примарната безбедност (композит од поголеми несакани ефекти: смрт, ампутација на целини екстремитети, исхемија на целини екстремитети што бара хируршка интервенција или хируршка санација на целиниот сад или клинички насочена реваскуларизација на лезијата, влошување на резултатот на Радерфорд од 2 класи, или до класа 5 или 6) беа споредувани со Објективна цел на неформарнис (OPG) на 12 месеци.

Резултати: Процедурален успех е постигнат во 100 %.

Резултатите за Долгор ултразвук покажуваат примарна проодност од 87 % (77/89, 95 % интервал на доверба 80-94), исполнувајќи ги барањата на OPG (73 %). Примарната проодност на 24 месеци беше 81 % (63/78).

Крајната точка на примарната безбедност на 12 месеци беше 96,8 % (90/93), исполнувајќи ги барањата на OPG (19,6 %), 2,2 % (2/93) од пациентите имаа клинички насочена реваскуларизација на лезијата, 1,1 % (1/93) починаа, 0 имаа ампутација на целини екстремитети, 0 имаа исхемија на целини екстремитети што бара хируршка интервенција или хируршка санација на целиниот сад и кај 0 имаше влошување на резултатот од Радерфорд за две класи, или класа 5 и 6.

Крајната точка на примарната безбедност на 24 месеци беше 87,8 % (79/90).

6,7 % (6/90) од пациентите имаа клинички насочени реваскуларизација на лезијата, 3,3 % (3/90) починаа, 0 имаа ампутација на целини екстремитети, 1,1 % (1/90) имаа исхемија на целини екстремитети што бара хируршка интервенција или хируршка санација на целиниот сад и кај 1,1 % (1/90) имаше влошување на резултатот од Радерфорд за две класи, или класа 5 и 6.

14. УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

Избор на уредот

Измерете ја должината на целината лезија за да ја одредите должината на потребниот стент. За соодветно да се покрие лезијата, употребената должина на стентот треба да биде најмалку 5 mm подолга од самата лезија од двете страни.

Измерете го дијаметарот на садот проксимално и дистално од лезијата за да ја изберете соодветната големина на стент. За да се обезбеди безбедно поставување на стентот, користете го поголемиот дијаметар како основа за избор на соодветна големина на стент. При изборот на модел консултирајте ја информацијата прикажана во табела 1.

Подготовка на уредот

Пред внесувањето на стентот, дайте хепарин и проверете дали активираното време на засишување (Activated Clotting Time, ACT) на пациентот е адекватно на праксата во центарот.

За време на подготовката на системот, посветете посебно внимание на не да дозволите какво било течнощ да дојде во допир со стентот.

а) Отворете ја кутијата и извадете ја кесата која ја содржи стерилината обвивка.

б) Откако ќе го прегледате пакувањето дали има некакво оштетување, отворете ја надворешната нестерилна обвивка од алиминумска фолија, а потоа од странете ја содржината од внатрешната обвивка. (Забелешка: Обвивката од алиминумска фолија и надворешната површина на внатрешната пластична обвивка е СТЕРИЛНА). Само содржината на пластичната обвивка е СТЕРИЛНА).

в) Внимателно поставете го носачот на рамна површина на стерилен место, одврзете ја лентата околу ракчата и извадете го катетерот од заштитната обвивка.

г) Проверете дали на катетерот за поставување има неправилности, извиткувања или некакви други оштетувања. Оштетувањето на уредот може да ги намали неговите перформанси.

д) Наполнете шприц од 3 ml со физиолшки раствор кој содржи хепарин, приклучете го на луер вентилот за плакнење (слика 1, точка 12) и применете позитивен притисок. Продолжете со плакнењето сè додека физиолшкиот раствор не се појави од дисталниот крај на катетерот.

ѓ) Испитајте го дисталниот крај на катетерот, за да се осигури дека стентот (слика 1, точка 4) е целосно покриен со надворешната навлака.

Не го користете уредот доколку го влошува или ако стентот е делумно раширен.

Компатибилност со помошниот прибор

Со уредот NiTiDES може да се користат навлаки за воведување со дијаметар 6F (2,0 mm) или поголеми.

Со уредот NiTiDES може да се користат водечки жици од 0,035 инчи (0,89 mm) или помали. Враќа основа на своето клиничко искуство, лекарите ќе ги изберат крутоста на водечката жица и обликот на врвот.

Доколку е потребно да се користи катетер-водич, системите Flype се компатибилни со водечката жица со дијаметар 8F (2,7 mm) или поголеми. Во таков случај, осигурете се дека хемостаскиот вентил е целосно отворен пред да го внесете избраниот скоп.

Вметнување на стентот

- Проверете дали безбедносниот клуч (слика 1, точка 10) на ракчата е во заклучена положба (детаљ B).
- Измийте го изложениот дел од водечката жица со физиолошки раствор со хепарин за да ги отстраните трагите од крв и контрастното средство.
- Движете го системот преку водечката жица сè додека стентот не дојде до местото за третман.

Доколку се почувствува отпор во кој било момент, не форсирате го системот: извлечете ги воведувачот, водечката жица и уредот заедно како една целина. Примената на прекумерна сила и/или неправилно ражување може да доведат до случајно поставување на стентот или оштетување на катетерот за поставување.

Движење на уредот

- Движете го системот до точка во која стентот ја поминал лезијата.
- Повлечете го системот назад сè додека стентот не се израмни со лезијата.
- Проверете дали делот од системот за поставување кој е надвор од телото на пациентот е сподобно истегнат и прав.

Внимание: доколку системот за поставување не е правилно истегнат, стентот може да биде поставен зад целната лезија.

Поставување на стентот и ширење

- Цврсто држеки ја ракчата со една рака, проверете дали радионепропусните маркери на стентот се позиционирани проксимално и дистално во однос на лезијата.
- Осигурете се дека навлаката за воведување не се поместува за време на поставувањето на стентот.
- Завртете го безбедносниот клуч на ракчата во насока обратно од стрелките на часовниковот (слика 1, детаљ B) за да ја отклучите (ЧЕКОР 1), потоа целосно извлечете го (ЧЕКОР 2).
- Држеки ја ракчата во фиксна положба во однос на пациентот, уште еднаш проверете дали радионепропусните маркери се во саканата положба во однос на лезијата; почнете со поставување на стентот со вртење на тркалото (слика 1, точка 9) со вашиот палец во насока на стрелката, како што е покажано на слика 1.
- Со флуороскопија, кога дисталниот крај на стентот е добро поврзан со сидовите на садот, продолжете со поставувањето со вртење на тркалото сè додека крајот на стентот не се отвори и комплетно постави на сидот на садот.
- Доколку е потребно брзо поставување, продолжете на следниот начин: проверете дали има пречки (на пр., зашрафен е женскиот луер присукач) на задниот крај на ракчата, фатете го задниот крај на уредот (повлекување, слика 1, точка 11) со другата рака и повлечете го, држеки го предниот дел на ракчата совершено неподвижен во однос на пациентот, како што е покажано на слика 1.
- Флуороскопски проверете дали стентот е целосно раширен.
- Стентот може дополнително да се разшири доколку е потребно, користејќи РТА балон-катетер. При изборот на дијаметарот на балон-катетерот и при извршувањето на дополнителното ширење, користете го дијаметарот на садот пресметанangiографски. Во секој случај, обрнете посебно внимание да не го раширувате стентот повеќе од неговиот номинален дијаметар, означен на етикетата.
- Конечниот дијаметар на стентот мора да биде соодветен со референтниот дијаметар на садот.

15.МОЖНИ НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ

Можните несакани ефекти кои можат да ја придржуваат имплантацијата на периферниот стент ги вклучуваат ризиците поврзани со перкутана трансплуминална ангиопластика и дополнителните ризици поврзани со користењето на стентови, како што е наведено подолу.

- Инфекција на пристапното место, болка и хематом
- Алергиска или несакана реакција на контрастното средство, лековите што се користат за време на процедурата или материјалите од кои е направен стентот
- Артериска спазма
- Артериска тромбоза или тромбоза на стент
- Аневризам на феморалната артерија или псевдоаневризам
- Артеросклеротична дистална емболизација
- Крварење
- Смрт
- Дисекција, перфорација или прскање на садот со стентот
- Емболизам
- Откажување на бубрезите
- Ихемија на долните екстремитети (бара хируршка интервенција)
- Рестеноза на артеријата во која е имплантiran стентот
- Емболизација на стентот
- Оклузија на крвен сад или нерешена стеноза

16.ОДГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИЈА

Производителот се осигурува дека овој уред е дизајниран, произведен и спакован со најголемо внимание, користејќи ги техниките што се сметаат за најсоодветни меѓу оние што се достапни во моменталната состојба на технологија и применувајќи интегрирани безбедносни принципи во дизајнот и производството што ќе обезбеди негово безбедно користење под условите и за предвидените цели, почтувајќи ги мерките на претпазливост описаните во пасусите погоре, и во секој случај насочено кон намалување, колку што е можно, но не целосно елиминирање на ризиците поврзани со користењето на уредот.

Производот смее да се користи само под надзор на специјализиран медицински персонал и земајќи ги предвид сите преостанати ризици или можни несакани ефекти и компликации од третманот за кој е наменет, вклучувајќи ги оние описаните во другите делови од оваа брошура со упатства. Техничката сложеност и критичната природа на изборот на терапијата и методите што се користат за применета на уредот исклучуваат каква било гаранција од производителот, експлицитна или имплицитна, за ефективноста на резултатот по употребата на уредот или, пак, за неговата ефективност во однос на решавањето на состојбата на пациентот или каква било друга патологија или медицински проблем. Всушност, резултатите, и од клиничка гледна точка и од аспект на функционалноста и траењето на уредот, исто така зависат и од други фактори кои се надвор од контролата на производителот, меѓу кои се наведени само како примери, а не и исцрпни услови на пациентот, хируриската постапка на имплантација или употреба, методите за манипулација на уредот по отворањето на пакетот.

Во однос на овие фактори, одговорноста на производителот постои само доколку се утврди дека уредот имал дефекти во времето кога бил пуштен во оптек. За таа цел, клиентот мора веднаш да го стави уредот на расположување на производителот, во согласност со условите за истекот на рокот и пропишаниот рецепт потребен законски производителот го задржува правото да го испита уредот за кој се смета дека е неисправен и да утврди дали навистина има дефекти што можат да влијаат на безбедноста на производот. Одговорноста на производителот е исклучена ако (i) дефектот се должи на усогласеноста на уредот со задолжително правило или обзувачка одредба и / или (ii) дефектот што ја предизвикал штетата не постоеа кога производителот го пуштил уредот во промет и / или (iii) ако состојбата на техничкото и научното знаење во моментот кога производителот го пуштил уредот во промет сè уште не дозволувала уредот да се смета за неисправен и / или (iv) во кој било друг случај, истиот така различен од наведено погоре, во кое законот изречно ја исклучува или ограничува одговорноста на производителот за штета од неисправни производи. Гаранцијата се состои исклучиво во замена на дефектниот уред со друг од истот или еквивалентен тип на уред од производителот.

Гаранцијата ќе се применува само доколку уредот е уредно вратен до производителот, заедно со детален писмен извештај за утврдените дефекти и, во случај на имплантiran уред, причините за отстранување од пациентот. За утврдените дефекти мора веднаш да се извести производителот во согласност со условите за одземање и законските прописи.

Отака ќе се изврши замена, производителот ќе му ги надомести на клиентот трошоците на негова сметка за вракање на признаеното неисправен уред.

Производителот одбива секаква одговорност во случај на непочитување на методите на користење и мерките на претпазливост наведени во ова упатство и во случај на користење на уредот по рокот за употреба наведен на пакувањето.

Освен тоа, производителот одбива секаква одговорност поврзана со последиците од медицинските избори и методите на користење или примена на уредот, и затоа, под никакви услови, нема да биде гонет за каква било материјална, биопшанска или морална штета од било кој вид, како резултат од примената на уредот и изборот на техниката за имплант што ја користел операторот.

Дистрибутерите и претставниците на производителот не се овластени да менуваат ниден од горенаведените услови, ниту да преземаат дополнителни обврски или да нудат каква било гаранција за овој производ надвор од горенаведеното. Оваа гаранција е регулирана според италијанското законодавство, освен ако не се применуваат задолжителните закони на друга држава, во случај производителот да одобри промет на производот во една или повеќе други држави освен Италија.

NiTiDES

sistem perifernog samoširećeg stenta koji je obložen „Carbofilm™-om i oslobađa Amphilius™ (sirolimus + masna kiselina)

1. OPIS UREĐAJA

Porodica uređaja NiTiDES se sastoji iz samoširećeg stenta i sistema za plasiranje pomoću kog se on pravilno postavlja i širi.

Ovaj stent je fleksibilni, samošireći implantabilni uređaj. Napravljen je od legure nikla i titanijuma (nitinol) i obložen sa „Carbofilm-om™“, tankim slojem ugljenika sa turbotrašićnom strukturom visoke gustine, koja je sušinski ista kao i struktura pirolitičkog ugljenika.

Oblaganje supstrata obezbeđuje mu karakteristike biokompatibilnosti i hemokompatibilnosti pirolitičkog ugljenika, bez uticaja na fizičke i strukturalne osobine samog supstrata.

Šest radioneopropusnih markera od tantala stavljeni je na stent (po tri na svakom kraju) kako bi se omogućilo pravilno postavljanje na mestu ciljne lezije.

Spoljašnja površina stenta ima naročite žljebove u potpunosti prekrivene „Carbofilm™-om, za smeštaj farmaceutske formule Amphilius™, koja se sastoji iz leka sirolimus i mešavine masnih kiselina dugih lanaca.

Specifična doza leka za površinu tretiranog krvnog suda je približno 0,9 µg/mm², što odgovara minimalnoj dozi od 270 µg na manjemu stentu (6,0x20 mm) i maksimalnoj dozi od 2420 µg na većem stantu (8,0x150 mm).

Sistem za plasiranje koji se koristi je tip "preko žice", a omogućuje da se stent sigurno postavi i otpusti na mestu lezije. On je shematski prikazan na slici 1 i sastoji se iz:

- tela katetera (7) 6F u prečniku koji se sastoji iz:
 - spoljašnjeg omotača koji se povlači, distalnog poluprovidnog odeljka (3) koji sadrži stent (4); omotač ima radioneopropusnu kragu (13) blizu vrha katetera;
 - unutrašnjeg lumena koji sadrži oprugu (6) i unutrašnji cev (2) unutar koje može preći vodilicu od 0,035 inča (0,89 mm); unutrašnji lumen se proteže duž katetera od luer spoja (12) koji je pričvršćen proksimalno ka ručici i završava se distalno na vrhu (1) u radioneopropusnom materijalu čime se olakšava lociranje i postavljanje stenta kada se posmatra na sistemu za radiografsku vizuelizaciju. Zatvarač (5) integrisan s unutrašnjim lumenom sprečava aksijalno dislociranje stenta tokom izvlačenja iz spoljašnjeg omotača;
 - ručica (8) sa sistemom za uvođenje koji omogućuje pozicioniranje katetera i širenje stenta in situ.
- Ručica ima ergonomski dizajn koji omogućuje operatoru da je uhvati i koristi čak i jednom rukom. Ona ima luer port (12) na proksimalnom kraju koji se koristi radi ispiranja lumena vodilice, sigurnosni taster (10), točkic (9) i nastavak za povlačenje unazad (11).
- Proizvođač direktno proizvodi periferni stent i kateterski sistem za širenje i implementira sve procedure za kontrolu kvaliteta tokom proizvodnje i na sam finalni proizvod u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse.

2. NAMENA UREĐAJA

Sistem samoširećeg perifernog stenta je namenjen za tretiranje periferne arterijske bolesti koja pogleda površnu femoralnu arteriju i proksimalnu poplitealnu arteriju.

3. INDIKACIJE ZA UPOTREBU UREĐAJA

Uređaj je indikovan za lečenje stenoze femoropoplitealnih arterija natkolenice kod odraslih simptomatskih [Raderford kategorija 2-5] pacijenata. Tretirana lezija, maksimalne dužine 14 centimetara, mora biti ili okludirana ili sa stenozom većom od 50%, de-novo ili restenotična, ali ne prethodno tretirana stentom.

4. KONTRAINDIKACIJE

Upotreba stenta kontraindikovana je u sledećim situacijama:

- Ležje za koje se smatra da se ne mogu rešiti pomoću PTA ili drugih interventnih tehnika.
- Trudnice ili dojilje.
- Ležje lokalizovane u dve distalne trećine poplitealne arterije ili kod zgloba kolena.
- Klinička stanja koja onemogućavaju upotrebu antiagregacione i/ili antikoagulantne terapije.

5. UPOZORENJA

- Korišćenje uređaja se ne preporučuje kod pacijenata sa poznatom hiperseptivnošću ili alergijama na sirolimus, masne kiseline (kao što su stearinška kiselina, palmitinska kiselina, behenska kiselina) ili metalne komponente stenta (kao što su nikl, titanijum i tantal).
- Uređaj je namenjen samo za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovo koristiti, ponovo obraditi niti ponovo sterilisati. Ovi postupci mogu da uzrokuju rizik od kontaminacije uređaja i/ili infekcije kod pacijenta, zapaljenja i prenos infektivnih bolesti sa jednog pacijenta na drugog pacijenta.
- Uređaj je osmisljen da funkcioniše kao sistem. Ne koristite njegove komponente zasebno.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko mu je pakovanje otvoreno ili oštećeno, ukoliko je bio nepravilno skladišten, ili ukoliko mu je istekao rok trajanja. U takvim slučajevima ne garantuje se sterilnost proizvoda.
- Uređaj treba da koriste isključivo lekarji koji su posebno obučeni za obavljanje perkutane transluminale angioplastike (PTA) i ugradnje perifernih stentova.
- Ako nađete na otvoru bilo kom studiju procedure, ne primenjujte silu na sistem, izvucite sistem stenta i čitav kateter za uvođenje, vodilicu i uvdornik kao jednu jedinicu. Primena prekomerne sile i/ili nepravilno rukovanje može da doveđe do toga da se stent slučajno raširi ili da se ošteći kateter za plasiranje.
- U bilo kom trenutku tokom operacije, nepravilno rukovanje može da izazove disekciju, perforaciju ili rupturu krvnog suda.

- Nemojte pomerati napred niti izvlačiti sistem stenta tokom širenja: to može dovesti do ozbiljnog oštećenja zidova krvnog suda.
- Implantacija samoširećeg perifernog stenta može da izazove disekciju krvnog suda distalno i/ili proksimalno u odnosu na stent i može da izazove akutnu okluziju suda što može dovesti do toga da je neophodna dodatna operacija (hirurška vaskularna operacija zamene, dodatna dilatacija, stavljanje dodatnih stentova ili druge procedure).
- Jednom kada je delimično raširen, stent ne može da se izvuče pomoću sistema za plasiranje.

6. MERE OPREZA

- **Nikada nemojte** koristiti sistem za brzo otpuštanje na početku ekspanzije stenta. Upotrebite ga samo ako je neophodno, nakon otpuštanja najmanje polovine dužine stenta.
- Uređaj treba pažljivo da se rukuje kako bi se izbegao bilo kakav kontakt sa metalnim ili abrazivnim instrumentima koji mogu da oštete ili da dovedu do mehaničkih izmena.
- Uređaj ne smađe da dode u kontakt sa tečnostima pre pripreme i postavljanja.
- Sistem za postavljanje uređaja nije namenjen za upotrebu s injektorima kontrastnog sredstva.
- Kada se stentovi implantiraju u tandemu, odgovarajući radioneopropusni markeri treba da se preklapaju. Preklapanje ne treba da obuhvata više od dva stenta.
- U slučaju preklapanja stentova, preporučuje se da dužina preklapanja bude manja od 20 mm.
- Kako biste izbegli oštećenje stenta, budite izuzetno pažljivi uvek kada provlačite vodilicu ili balon kateter ili neki drugi uređaj kroz stent koji je raširen.

7. BEZBEDNOSNE INFORMACIJE O SNIMANJU MAGNETNOM REZONANCOM

Neklinička testiranja su pokazala da je linija proizvoda Nitinol stentova uslovno bezbedna za snimanje MR-om (MR Conditional). Pacijent koji ima ovaj uređaj može bezbedno da se skenira u sistemu MR pod sledećim uslovima:

- Statičko magnetno polje od 1,5 Tesla (1,5T) ili 3 Tesla (3T)
- Maksimalni prostorni gradijent polja od 6 140 G/cm (61,40 T/m)
- Maksimalna prosečna specifična stopa apsorpcije (SAR) celog tela prijavljena za MR sistem:
 - 1 W/kg (ubucičeni režim rada) za 1,5T
 - 1 W/kg (ubucičeni režim rada) za 3T

RF zagrevanje

Pod prethodno definisanim uslovima skeniranja, očekuje se da linija proizvoda Nitinol stentova proizvede maksimalni temperaturni porast manji od 6,8 °C nakon 15 minuta kontinuiranog skeniranja sa prosečnom specifičnom stopom apsorpcije (SAR) od 1,0 W/kg prijavljenom za MR sistem.

1,5 T	3 T
Konfiguracija sa jednim stentom Maksimalna promena temperature	≤ 6,3 °C ≤ 6,2 °C
Konfiguracija sa preklapanjem stenta Maksimalna promena temperature	≤ 6,8 °C ≤ 6,3 °C

MR artefakt

U okviru nekliničkih testiranja, artefakt slike izazvan uređajem doseže približno 0,7 cm od Nitinol stentova pri snimanju sa gradijentnom eho i spin eho pulsnom sekvencom na MRI sistemu od 3T.

8. NACIN ISPORUKE

NiTiDES uređaj se isporučuje sterilisan (upotrebom mešavine etilen oksida i CO₂), za jednokratnu je upotrebu i pakovan u dve vrećice koje se ne smiju uneti u sterilno područje. **NAPOMENA: unutrašnja vrećica je jedina sterilna barijera.** Sterilnost i hemijska stabilitet sa garantuju sve dok je pakovanje neštočećeno i dok ne istekne datum roka trajanja koji je odstampa na pakovanju (USE BEFORE DATE - UPOTREBITI DO).

Sadržaj: jedan (1) sistem perifernog samoširećeg stenta koji je obložen „Carbofilm™-om i oslobađa Amphilius™ (sirolimus+masna kiselina)

9. ČUVANJE

Proizvod treba čuvati kao što je navedeno na njegovom pakovanju, na hladnom i suvom mestu, sa maksimalnom temperaturom skladištenja do 25°C.

10. MODELI

NiTiDES uređaj se identificuje pomoću šifre modela i serijskog broja; dostupne šifre modela navedene su u tabeli 1.

11. PRIMENA LEKOVA

Studije iz kliničke literature ukazuju da je potrebljeno da se administrira preoperativna antiagregaciona terapija, antikoagulaciona terapija tokom procedure i postoperativna antiagregaciona terapija.

Antiagregaciona terapija tokom perioda nakon procedure obuhvata primenu:

- Tienvopiridina (tiklopidina, klopidogrela ili prasugrela u dozama indikovanim u odgovarajućim uputstvima ili u skladu s medicinskim receptom)
- Aspirina u minimalnoj količini od 100 mg/dan doživotno

Imajući u vidu kompleksnost procedure i mnoge faktore koji utiču na stanje pacijenata, definicija odgovarajuće terapije ostavlja se na procenu lekaru.

12. INTERAKCIJE S LEKOVIMA

Iako specifični klinički podaci nisu dostupni, određeni lekovi, kao što je takrolimus, koji deluju preko istog vezujućeg proteina (FKBP), mogu interferirati s efikasnošću sirolimusa. Sirolimus se metabolije preko CYP3A4. Snažni inhibitori CYP3A4 mogu dovesti do povećane ekspozicije sirolimusu, pogotovo u slučajevima višestrukih implantata. Sistematska izloženost sirolimusu kod pacijenata koji uzimaju istovremeno sistemske imunosupresivne lekove takođe se mora uzeti u obzir.

13. KLINIČKO ISPITIVANJE SA NITIDES PROIZVODIMA

Prijava bezbednosti i efikasnosti Nitides stenta potvrđena je pre stavljanja u promet putem kliničke studije ILLUMINA. Metodologija istraživanja: U okviru multicentrične studije sa jednom grupom ispitnika, 100 pacijenata sa simptomatskom femoropoplitealnom bolešću i maksimalnom dužinom lezije od 14 cm bili su lečeni pomoći Nitides stenta. Primarna efikasnost (prijava prohodnosti) i primarni kriterijum bezbednosti (skup ozbiljnih neželjenih događaja: smrt, amputacija tretiranog ekstremiteta, ishemija tretiranog ekstremiteta koja zahteva hiruršku intervenciju ili hirurško lečenje tretiranog krvnog suda ili klinički vodenu revaskularizaciju tretirane lezije, pogoršanje Raderfordovog nalaza za 2 klase ili na klasu 5 ili 6) uporedivani su sa objektivnim ciljem učinka (OPG) tokom 12 mjeseci.

Rezultati: Uspeh postupka je bio zabeležen u 100% slučajeva.

Rezultati za dopler ultrazvuk pokazuju primarnu prohodnost od 87% (77/89), 95% interval pouzdanošći 80-94%, ispunjavajući uslove OPG-a (73%). Primarna prohodnost tokom 24 mjeseca bila je 81% (63/78).

Primarni kriterijum bezbednosti tokom 12 mjeseci bio je 96,8% (90/93), ispunjavajući uslove OPG-a (19,6%), 2,2% (2/93) pacijenata imalo je klinički vodenu revaskularizaciju tretirane lezije, 1,1% (1/93) je preminuo. O je imalo amputaciju tretiranog ekstremiteta, a on je imao ishemiju tretiranog ekstremiteta koja zahteva hiruršku intervenciju ili hirurško lečenje tretiranog krvnog suda i o je imalo pogoršanje Raderfordovog nalaza za dve klase, ili klasu 5 i 6.

Primarni kriterijum bezbednosti tokom 24 mjeseca bio je 87,8% (79/90), 6,7% (6/90) pacijenata imalo je klinički vodenu revaskularizaciju tretirane lezije, 3,3% (3/90) je preminulo. O je imalo amputaciju tretiranog ekstremiteta, 1,1% (1/90) je imao ishemiju tretiranog ekstremiteta koja zahteva hiruršku intervenciju ili hirurško lečenje tretiranog krvnog suda i 1,1% (1/90) je imao pogoršanje Raderfordovog nalaza za dve klase, ili klasu 5 i 6.

14. UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Odarib uređaja

Uzmite u obzir dužinu ciljne lezije kako biste odredili dužinu potrebnog stenta. Da biste odgovarajuće obuhvatili leziju, neophodno je da dužina raširenog stenta bude barem 5 mm veća od lezije na svakoj strani.

Uzmite u obzir prečnik krvnog suda proksimalno i distalno od lezije kako biste odredili odgovarajuću veličinu stenta. Da biste osigurali bezbedno postavljanje stenta, njegovu odgovarajuću veličinu izaberite na osnovu većeg prečnika. Kada birate model, pogledajte informacije u tabeli 1.

Priprema uređaja

Pre plasiranja stenta, administrirajte heparin i proverite da li je aktivisano vreme koagulacije (ACT) pacijenta u skladu s praksom ustanove.

Tokom pripreme sistema, obratite posebnu pažnju da ne dozvolite kontakt bilo koje tečnosti sa stentom.

- Otvorte kutiju i izvadite kesu u kojoj se nalazi sterilna vrećica.
- Nakon što se uverite da na pakovanju nema oštećenja, otvorite spoljašnju nesterilnu vrećicu od aluminijumske folije a zatim uklonite sadržaj iz unutrašnje vrećice. (Napomena: Vrećica od aluminijumske folije i spoljašnja površina unutrašnje plastične vrećice **NISU STERILNE**. Samo je sadržaj plastične vrećice **STERILAN**).
- Pazite da postavite podupiraju na ravnu površinu na sterilnom području, odvezite traku oko ručice i uklonite kateter iz zaštитnog kotura.
- Proverite da li kateter za plasiranje nije negde savijen, uvijen ili na neki drugi način oštećen. Oštećenje uređaja može narušiti njegov rad.
- Napunite špricu od 3 ml fiziološkim rastvorom koji sadrži heparin, spojite ga na luer spoj za ispiranje (slika 1, predmet 12) i pritisnite. Nastavite ispiranje sve dok se fiziološki rastvor ne pojavi na distalnom kraju katetera.
- Pregledajte distalni kraj katetera kako biste se uverili da je stent (slika 1, predmet 4) u potpunosti prekriven spoljašnjom omotačem.

Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili ako je stent delimično raširen.

Kompatibilnost s pomoćnom opremom

Za Nitides uređaje mogu se koristiti omotači uvodnika prečnika 6F (2,0 mm) ili veći od toga.

Za Nitides uređaje mogu se koristiti vodilice prečnika 0,035 inča (0,89 mm) ili manje od toga. Izbor čvrstine vodilice i konfiguracije vrha zavisće od kliničkog iskustva lekara.

Ako bude neophodno da se koristi vodeći kateter, sistemi su kompatibilni sa vodećim kateterima prečnika 8F (2,7 mm) ili većim od toga. U tom slučaju, pobrinite se da je ventil za hemostazu u potpunosti otvoren pre nego što plasirate izabrani sklop.

Insercija stenta

- Postarajte se da je bezbednosni taster (slika 1, predmet 10) na ručici u zaključanom položaju (deo B).
- Isperite izloženi deo vodilice fiziološkim rastvorom koji sadrži heparin, kako biste uklonili tragove krvi i kontrasta.
- Pomerajte napred sistem preko vodilice sve dok stent ne dođe do mesta za tretiranje.

Ako bilo kada nađete na neobičan otpor, ne primenjujte silu na sistem: izvucite uvodnik, vodilicu i uređaj zajedno kao jednu jedinicu. Primena prekomerne sile i/ili nepravilno rukovanje može da dovede do toga da se stent slučajno raširi ili da se ošteći kateter za plasiranje.

Pomeranje uređaja napred

- Pomerajte napred sistem do tačke na kojoj se distalni markeri stenta nalaze iza lezije.
- Povlačite sistem unazad sve dok stent ne bude u ravni sa lezijom.
- Proverite da li je deo sistema za plasiranje, koji je van tela pacijenta, slobodno ispružen i ispravljen.

Oprez: ako sistem za plasiranje nije dobro ispružen, stent se može raširiti iza ciljne lezije.

Postavljanje i ekspanzija stenta

- Cvrsto držeći ručicu jednom rukom, proverite da li su radioneopropusni markeri stenta pozicionirani proksimalno i distalno u odnosu na ležiju.
- Pobrinite se da se omotač uvodnika ne pomera tokom širenja stenta.
- Okrenite bezbednosni taster na ručici suprotno od kazaljke na časovniku (slika 1, deo B) kako biste ga odblokirali (KORAK 1) a potom ga potpuno izvucite (KORAK 2).
- Držeći ručicu u fiksiranom položaju u odnosu na pacijenta, proverite još jedanput da li su radioneopropusni markeri na željenom mestu u odnosu na ležiju; započnite sa širenjem stenta tako što ćete okretati točkić (slika 1, predmet 9) vašim palcem u smeru strelice, kako je prikazano na slici 1.
- Pod fluoroskopijom, kada je distalni kraj stenta dobro pričvršćen za zidove krvnog suda, nastavite sa širenjem tako što ćete okretati točkić sve dok se kraj stenta ne otvori i ne bude u potpunosti implantiran na zidovima krvnog suda.
- U slučaju da je potrebno brzo širenje, postupite na sledeći način: postarajte se da nema opstrukciju (npr. zašraffeni ženski luer spoj) na zadnjoj strani ručice, uhvatite zadnji kraj uređaja (povlačenje unazad, slika 1, predmet 11) drugom rukom i povucite ga držeći prednji deo ručice savršeno mirno u odnosu na pacijenta, kako je prikazano na slici 1.
- Fluoroskopski proverite da li je stent u potpunosti raširen.
- Stent se može dodatno još raširiti, ako je neophodno, pomoću PTA balon katetera. Za odabir prečnika balon katetera i pri izvođenju naknadne ekspanzije, pogledajte prečnik krvnog suda koji je procenjen na osnovu angiografije. U svakom slučaju, vodite posebnu računa da ne raširete stent iznad njegovog nominalnog prečnika naznačenog na oznaci.
- Završni prečnik stenta mora odgovarati prečniku referentnog krvnog suda.

15. MOGUĆI NEŽELJENI DOGAĐAJI

- Mogući neželjeni događaji koji mogu biti povezani s ugradnjom perifernog stenta obuhvataju rizike povezane s perkutanom transluminalnom angioplastikom i dodatne rizike povezane s upotrebotem stentova, kako je prikazano u daljem tekstu.
- Infekcija, bol i hematoma na mestu zahvata
 - Alergija ili neželjena reakcija na kontrastno sredstvo, lekove korišćene tokom procedure ili na materijale od kojih je stent napravljen
 - Arterijski spazam
 - Arterijska tromboza ili tromboza stenta
 - Aneurizma ili pseudoaneurizma femoralne arterije
 - Aterosklerotska distalna embolizacija
 - Krvarenje
 - Smrt
 - Disksekcija, perforacija ili ruptura krvnog suda u koji je postavljen stent
 - Embolija
 - Insuficijenci bubrega
 - Ishemija donjeg ekstremiteta (koja zahteva hiruršku intervenciju)
 - Restenozija arterije u kojoj je implantiran stent
 - Embolizacija stentom
 - Okluzija krvnog suda ili nerešena stenoza

16. ODGOVORNOST I GARANCIA

Proizvođač jamči da je uređaj dizajniran, proizведен i zapakovan krajnje pažljivo uz primenu procedura koje se smatraju najprikladnijima u okviru trenutnog nivoa razvoja tehnologije i uz primenu principa integracije bezbednosti u dizajn i konstrukciju radi osiguranja bezbedne upotrebe kada se on koristi u skladu sa uslovima i namenama u povezanosti sa merama predestrožnosti opisanim u prethodnim odlomcima, i u svakom slučaju usmerenom na smanjivanje koliko je to moguće, ali ne i potpuno eliminisanje, rizika povezanih sa upotrebotem uređaja. Proizvod sme da se koristi isključivo pod odgovornošću specijalizovanog medicinskog osoblja i uzimajući u obzir rezidualne rizike i moguća neželjena dejstva i komplikacije terapije za koju je namenjen, uključujući one koje su spomenute u drugim delovima ove brošure sa uputstvima.

Tehnička kompleksnost i kritična priroda medicinskih odluka i metoda u primeni ovog uređaja isključuju svaku garantiju proizvođača, bilo eksplicitnu bilo implicitnu, što se tiče efikasnosti rezultata nastalih upotrebom ovog uređaja ili što se tiče njegove efikasnosti u otklanjanju određene invalidnosti ili bilo koje druge patologije ili zdravstvenog problema. U stvari, gledano ne samo iz kliničkog ugla već i na osnovu funkcionalnosti i trajanja uređaja, rezultati takođe zavise od brojnih faktora koji su van kontrole proizvođača, među kojima su i stanje pacijenta, hirurški postupak implantacije ili korišćenje i metode rukovanja uređajem nakon otvaranja pakovanja.

Imaјућi u vidu ove faktoare, odgovornost proizvođača postoji samo ako je dokazano da je uređaj imao defekt u trenutku plasiranja na tržište. U tu svrhu, korisnik mora odmah dostaviti uređaj proizvođaču, u skladu sa uslovima isteka i zastarelosti propisanih zakonom; proizvođač zadržava pravo da pregleda uređaj za koji se tvrdi da je pokvaren i utvrdi da li zaista postoje defekti koji mogu uticati na bezbednost proizvoda. Proizvođač je oslobođen odgovornosti ako je (i) navedeni defekt nastao zbog usklađenosnosti uređaja sa obaveznim propisom ili obavezujućim odredbom, i / ili (ii) defekt koji je uzrokovao štetu nije postojao kada je proizvođač plasirao uređaj i / ili (iii) ako u okviru tehnoloških i naučnih saznanja u vreme kada je proizvođač plasirao proizvod, uređaj nije mogao biti smatrani neispravnim, i / ili (iv) u svakom drugom slučaju, takođe različitom od prethodno navedenih, u kom zakon izričito isključuje, ili ograničava, odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Garancija se isključivo odnosi na zamenu neispravnog uređaja drugim uređajem iste ili ekvivalentne izrade proizvođača. Garancija će važiti samo ako je uređaj pravilno vraćen proizvođaču zajedno sa detaljnim pisanim izveštajem o navodnom defektu i, u slučaju implantiranog uređaja, o razlozima zašto je uređaj izvađen iz pacijenta. Navodni defekti moraju odmah biti prijavljeni proizvođaču u skladu sa uslovima odricanja od prava i zakonske zastarelosti.

Nakon zamene uređaja, proizvođač će nadoknadi troškove korisnika što se tiče vraćanja dokazano neispravnog uređaja.

Proizvođač se održice bilo kakve odgovornost za slučajevе kada se ne poštuju metode upotrebe i mere oprezu koje se navode u ovom priručniku i u slučaju

upotrebe nakon što je istekao datum roka upotrebe odštampan na pakovanju. Nadalje, proizvođač se održice bilo kakve odgovornosti u vezi sa posledicama izbora lečenja i metoda korišćenja ili primene uređaja i stoga pod bilo kakvim okolnostima neće biti krivično gonjen za bilo kakvu materijalnu, biološku ili moralnu štetu, proisteklu iz primene uređaja i izbora tehnike implantacije koju je koristio operator.

Agenti i predstavnici proizvođača nisu ovlašćeni da menjuju bilo koje od prethodno navedenih uslova niti da preuzimaju bilo koje dalje obaveze ili sastavljaju bilo kakve garancije u vezi sa ovim proizvodom, koje se razlikuju od gore navedenih uslova. Ova garancija je regulisana zakonima Italije, osim ako se ne primenjuju obvezni zakoni druge države, u slučaju da je proizvođač odobrio plasiranje proizvoda van Italije, u jednu ili više drugih država.

Hrvatski

NITIDES sustav perifernog stenta koji se sam proširuje i obložen je slojem „Carbofilm™ te ispušta Amphilius™ (sirolimus + masna kiselina)

1. OPIS PROIZVODA

Linija proizvoda NITIDES sastoje se od stenta koji se sam proširuje i sustava za isporuku, za ispravno postavljanje i implementaciju stenta.

Stent je fleksibilan proizvod za kiruršku ugradnju koji se sam proširuje. Stent je izrađen od legure nikla i titanija (nitinol) i obložen je tankim uglenjanim slojem „Carbofilm™“ turbostratične strukture velike gustoće koja je u značajnoj mjeri jednaka strukturi pirolitičkog ugljika.

Oblaganjem supstrata ovim slojem stentu se dodaju biokompatibilna i hemokompatibilna svojstva pirolitičkog ugljika, a da se time ne utječe na fizička i strukturna svojstva samog supstrata.

Na stent se postavlja šest radiokontrastnih markera od tantala (tri na svakom kraju) kako bi se omogućilo ispravno postavljanje na mjestu liječenja lezije.

Vanjska površina stenta ima namjenski utore koji su u potpunosti prekriveni slojem „Carbofilm™“ u svrhu zadražavanja farmaceutske formulacije lijeka Amphilius™ koji se sastoji od lijeka sirolimus i mješavine dugolanđančnih masnih kiselina.

Specifična doza lijeka za površinu krvne žile koja se liječi iznosi otprilike 0,9 µg/mm², što odgovara minimalnoj dozi od 270 µg na manjem stentu (6,0 x 20 mm) i maksimalnoj dozi od 2420 µg na većem stentu (8,0 x 150 mm).

Sustav za isporuku koji se upotrebljava uvodi se žicom, čime se osigurava sigurno postavljanje i otpuštanje stenta na području lezije. Shematski se prikazuje na slici 1 i sadrži:

- tijela katetera (7) promjera 6F koje se sastoje od:
 - vanjskog omotača koji se uvlači, distalnoga, poluprovidnog dijela (3) koji sadrži stent (4); omotač ima radiokontrastnu obujmicu (13) blizu vrha katetera;
 - unutrašnjeg lumena koji sadrži namot (6) i unutrašnju cijev (2) koji odgovaraju žici vodilice od 0,035 in; unutrašnji lumen širi se duž katetera iz prćvrsnog elementa luer (12), koji je proksimalno pričvršćen za ručku i završava distalno na vrhu (1) radiokontrastnim materijalom, a kako bi se olakšalo smještanje i postavljanje stenta kada se promatra sustavom za slikovnu dijagnostiku. Zatvaračem (5) ugrađenim u unutrašnji lumen sprječava se aksijalni pomak stenta tijekom izvlačenja vanjskog omotača;
- ručka (8) koja sadrži sustav za isporuku, kojom se omogućuje namještanje katetera i implementacija stenta in situ.

Ručka ima ergonomski dizajn te se njome rukovatelju omogućuje hvat i upotreba čak i jednom rukom. Sadrži priključak za luer (12) na proksimalnom kraju, koji se upotrebljava za ispiranje lumena, sigurnosni ključ (10), kotačić (9) i stražnji dio za povlačenje (11).

Proizvođač izravno izrađuje sustav perifernog stenta i katetera za implementaciju te primjenjuje cijelovite postupke kontrole kvalitete kako tijekom proizvodnje, tako i na gotovim proizvodima, u skladu sa smjernicama za dobru proizvođačku praksu.

2. NAMJENA PROIZVODA

Sustav perifernog stenta koji se sam proširuje namijenjen je liječenju periferne arterijske bolesti koja zahvaća površinsku femoralnu arteriju i proksimalnu poplitealnu arteriju.

3. INDIKACIJA PROIZVODA

Proizvod je indiciran za liječenje stenoze femoropoplitealnih arterija iznad koljena u odraslim simptomatskim bolesniku [kategorija prema Rutherfordu 2 – 5]. Liječenja lezija, maksimalne dužine 14 centimetara, mora biti okludirana ili sadržavati stenu veću od 50 %, de novo ili iznova stenotičnu, a koja se nije prethodno liječila stentom.

4. KONTRAINDIKACIJE

Upotreba stenta kontraindikirana je ako je riječ o sljedećim okolnostima:

- Lezije koje se smatraju nelječivima primjenom postupka PTA ili upotrebom drugih tehniki intervencije.
- Trudnice, dojilje.
- Lezije smještene u dyjema distalnim trećinama poplitealne arterije ili pri zglobu koljena.
- Klinička stanja kojima se sprječava primjena antitrombocitnog i/ili antikoagulacijskog liječenja.

5. UPOZORENJA

• Upotreba proizvoda ne preporučuje se na bolesnicima u kojih je poznata preosjetljivost ili sklonost alergijama na sirolimus, masne kiseline (kao što su stearinška, palmitinska i behenska kiselina) ili na metalne komponente stenta (poput nikla, titanija ili tantalata).

• Proizvod je namijenjen samo jednodoktrinarnoj upotrebi. Nemojte ga ponovo upotrebljavati, obradavati ni sterilizirati. Tako se mogu izazvati rizici od kontaminacije proizvoda i/ili infekcije bolesnika, upale te prijenosa zaraznih bolesti s bolesnika na bolesnika.

• Proizvod je osmišljen tako da radi kao sustav. Ne upotrebljavajte njegove dijelove zasebno.

• Nemojte upotrebljavati proizvod ako mu je pakiranje otvoreno ili oštećeno, neispravno pohranjeno ili ako mu je istekao navedeni rok valjanosti upotrebe. U takvim slučajevima ne jamči se sterilnost proizvoda.

• Proizvod trebaju upotrebljavati samo liječnici koji su posebno osposobljeni za perkutanu transluminalnu angioplastiku (PTA) i ugradnju perifernog stenta.

• Ako u bilo kojem trenutku dođe do otpora, nemojte silom uvoditi sustav: izvucite sustav stenta i vodeći kateter u cijelosti te žicu vodilice i uvodnicu kao zasebnu cjelinu. Primjenom prekomjerne sile i/ili nepravilnim rukovanjem može se dovesti do slučajne implementacije stenta ili do oštećenja uvodnog katetera.

• U bilo kojem trenutku tijekom operacije, nepravilnim rukovanjem može se

- prouzrokovati disekcija, perforacija ili pušnica krvne žile.
- Nemojte pogurivati ni izvlačiti sustav stenta tijekom implementacije: time se može prouzrokovati ozbiljno oštećenje stjenki krvne žile.
- Ugradnjom perifernog stenta koji se sam proširuje može se prouzrokovati disekcija krvne žile distalno i/ili proksimalno od stenta, kao i akutna blokada krvne žile, čime se stvara potreba za dodatnom operacijom (kirurški zahvat zamjene na krvnim žilama, dodatna dilatacija, implementacija dodatnih stentova ili drugi zahvati).
- Kada se stent djelomično implementira, ne može se izvući upotrebom sustava za isporuku.

6. MJERE OPREZA

- Nikada ne upotrebljavajte** sustav za brzo otpuštanje na početku proširivanja stenta. Upotrijebite ga **samo ako je nužno**, a nakon otpuštanja najmanje **pola dužine** stenta.
- Proizvod treba pažljivo rukovati da bi se izbjegao svaki kontakt s metalnim ili abrazivnim instrumentima koji ga mogu štetiti ili mu prouzrokovati mehaničke promjene.
- Proizvod ne smije doći u kontakt s tekućinama prije pripreme i postavljanja.
- Sustav za postavljanje proizvoda namjena nije upotreba uz brizgaljke kontrastnog sredstva.
- Na mjestima gdje se stentovi postavljaju usporedno, radiokontrastni markeri svakoga od njih trebali bi se preklapati. Preklapanje ne smije uključivati više od dva stenta.
- A u slučaju stentova koji se preklapaju, preporučuje se dužina preklapanja manja od 20 mm.
- Da biste izbjegli oštećenje stenta, budite iznimno oprezni svaki put kada povlačite žicu vodilicu, balonski kateter ili neki drugi proizvod kroz stent koji se neposredno prije implementirao.

7. SIGURNOSNE INFORMACIJE ZA SNIMANJE MAGNETSKOM REZONANCIJOM (MR)

Nekliničko ispitivanje pokazalo je da su proizvodi ovog proizvođača, stentovi od nitinola, sigurni za snimanje MR-om. Bolesnik kojemu je ugrađen ovaj proizvod može se sigurno podvrgnuti snimanju u sustavu za MR koji je u skladu sa sljedećim uvjetima:

- Statično magnetsko polje od 1,5 tesli (1,5 T) ili 3 tesle (3 T)
- Maksimalni gradijent magnetskog polja od 6,140 G/cm (61,40 T/m)
- Maksimalna dopuštena vrijednost za izloženost cijelog tijela prema sustavu za MR navodi se u vrijednosti vremenskog prosjeka specifične stope apsorpcije (SAR) od:
 - 1 W/kg (normalni način rada) pri 1,5 T
 - 1 W/kg (normalni način rada) pri 3 T

Zagrijavanje u sustavu za RF

Pod prethodno definiranim uvjetima skeniranja, očekuje se da proizvodi, stentovi od nitinola, prouzrokuju podvrgnuti snimanju u sustavu za MR koji je u skladu sa sljedećim uvjetima:

	1,5 T	3 T
Konfiguracija uz pojedinačni stent Najviša promjena temperature	$\leq 6,3^{\circ}\text{C}$	$\leq 6,2^{\circ}\text{C}$
Konfiguracija uz preklapanje stentova Najviša promjena temperature	$\leq 6,8^{\circ}\text{C}$	$\leq 6,3^{\circ}\text{C}$

Artefakt na snimci MR-a

U nekliničkom ispitivanju, artefakt snimke koji je prouzrokovao proizvod širi se otprilike 0,7 cm od stentova od nitinola ovog proizvođača prilikom snimanja sekvenscijama impulsa gradijenta jeke i impulsa vrtnje u sustavu za MR od 3 T.

8. KAKO SE PROIZVOD ISPORUČUJE

Proizvod NITIDES isporučuje se sterilan (upotrebom mješavine etilen oksida i CO_2), namijenjen je jednokratnoj upotrebi i zapakiran je u dvjema vrećicama koje se ne smiju unositi u sterilno područje. **NAPOMENA: unutrašnja vrećica od folije jedina je sterilna barijera.**

Sterilnost i kemijska stabilnost zajamčene su sve dok je pakiranje netaknuto i upotrijebljeno do datuma isteka roka valjanosti upotrebe koji je otključan na pakiranju (DATUM ROKA UPOTREBE).

Sadržaj: jedan (1) sustav perifernog stenta koji se sam proširuje i obložen je slojem *Carbofilm™* te ispušta Amphilimus™ (sirolimus + masna kiselina)

9. ČUVANJE

Proizvod treba čuvati kako se navodi na njegovu pakiranju, na hladnom i suhom mjestu, uz maksimalnu temperaturu skladištenja od 25°C .

10. MODELI

Proizvod NITIDES identificira se uz pomoć šifre modela i broja serije; dostupne šifre proizvoda navode se u Tablici 1.

11. TERAPIJA LIJEKOVIMA

Istraživanja u kliničkoj literaturi ukazuju na potrebu primjene predoperativnog antitrombocitnog liječenja, antikoagulacijskog liječenja tijekom zahvata i postoperativnog antitrombocitnog liječenja.

Antitrombocitno liječenje tijekom razdoblja nakon zahvata uključuje primjenu sljedećeg:

- Tienopiridina (tiklopindina ili klopindogrela ili prasugrela u dozama navedenima u uputama za primjenu lijeka ili u skladu s liječničkim receptom)
 - Aspirina u minimalnoj dnevnoj količini od 100 mg, bez vremenskog ograničenja
- S obzirom na složnost postupka i mnoge čimbenike kojima se utječe na stanje bolesnika, liječnik treba odrediti prikladnu terapiju prema svojem nahođenju.

12. MEĐUDJELOVANJE LIJEKOVA

Iako specifični klinički podatci nisu dostupni, određenim lijekovima, poput lijeka

takrolimus, koji djeluju putem istog vezujućeg proteina (FKBP), može se utjecati na učinkovitost lijeka sirolimus. Lijek sirolimus metabolizira se enzimom CYP3A4. Jaki inhibitorki enzima CYP3A4 može se prouzrokovati povećana izloženost lijeku sirolimus, posebice u slučaju višestrukog usatka. U slučaju kada bolesnik uzima popratne sustavne imunosupresivne lijekove, sustavna se izloženost lijeku sirolimus također mora uzeti u obzir.

13. KLINIČKO ISPITIVANJE U VEZI S PROIZVODOM NITIDES

U kliničnom kliničkom ispitivanju prije stavljanja na tržište, ILLUMINA, utvrđene su osnovna sigurnost i osnovna djelotvornost stenta NITIDES.

Ustroj ispitivanja: U sklopu multicentričnog ispitivanja jedne skupine, stentom NITIDES liječilo se u 100 osobu oboljelih od simptomatske femoropoplitealne bolesti popraćene lezijom maksimalne dužine od 14 cm. Primarna učinkovitost (primarna probodnost) i primarni ishod sigurnosti (skup ozbiljnih štetnih događaja: smrt, amputacija liječenog ekstremiteta, ishemija liječenog ekstremiteta za koju je potrebna kirurška intervencija ili kirurški popravak liječene krvne žile ili klinički provođena revaskularizacija liječene lezije, pogoršanje nalaza prema Rutherfordovoj kategorizaciji za 2 stupnja ili na stupanj 5 ili 6) uspoređivali su se s objektivnim ciljem učinka (engl. Objective Performance Goal; OPG) tijekom 12 mjeseci.

Rezultati: Uspjeh postupka zabilježio se u 100 % slučajeva.

Rezultati za ultrazvučni color doppler pokazuju primarnu probodnost od 87 % (77/89, 95 % interval pouzdano 80 – 94), udovoljavajući zahtjevima OPG-a (73 %). Primarna probodnost tijekom 24 mjeseca bila je 81 % (63/78).

Primarni ishod sigurnosti tijekom 12 mjeseci bio je 96,8 % (90/93), udovoljavajući zahtjevima OPG-a (19,6%). U 2,2 % (2/93) bolesnika provedla se klinički vođena revaskularizacija liječene lezije, u 1,1 % (1/93) bolesnika došlo je do smrtnog ishoda, nad 0 bolesnika provedla se amputacija liječenog ekstremiteta, u 0 bolesnika došlo je do ishemije liječenog ekstremiteta koja zahtijeva kiruršku intervenciju ili kirurški popravak liječene krvne žile i u 0 bolesnika pogoršao se nalaz prema Rutherfordovoj kategorizaciji za dva stupnja ili na stupanj 5 ili 6.

Primarni ishod sigurnosti tijekom 24 mjeseca bio je 87,8 % (79/90). U 6,7 % (6/90) bolesnika provedla se klinički vođena revaskularizacija liječene lezije, u 3,3 % (3/90) bolesnika došlo je do smrtnog ishoda, nad 0 bolesnika provedla se amputacija liječenog ekstremiteta, u 1,1 % (1/90) bolesnika došlo je do ishemije liječenog ekstremiteta koja zahtijeva kiruršku intervenciju ili kirurški popravak liječene krvne žile i u 1,1 % (1/90) bolesnika pogoršao se nalaz prema Rutherfordovoj kategorizaciji za dva stupnja ili na stupanj 5 ili 6.

14. UPUTE ZA UPOTREBU

Odarib prvozvoda

Kako bi se utvrdile potreba dužina stenta potrebno je uzeti u obzir dužinu liječene lezije. Kako bi se lezija prikladno preklijala, implementirani stent trebao bi na svakoj strani lezije od nje biti duži barem 5 mm. Potrebno je uzeti u obzir promjer krvne žile proksimalno i distalno od lezije kako bi se odredila odgovarajuća veličina stenta. Kako bi se stent sigurno postavio, kao osnovu za odabir njegove odgovarajuće veličine potrebno je uzeti veći promjer. Pri odabiru modela potrebno je pogledati informacije navedene u tablici 1.

Priprema proizvoda

Prije isporuke stenta potrebno je bolesniku dati heparin i provjeriti je li njegovo aktivirano vrijeme zgružavanja (ACT) na prikladan način u skladu s praksom centra.

Tijekom pripreme sustava posebnu pažnju treba posvetiti tomu da nikakva tekućina ne dođe u kontakt sa stentom.

- Otvorite kutiju i izvadite spremnik koji sadrži sterilnu vrećicu.
- Nakon provjeravanja postoje li ikakva oštećenja na pakiranju, otvorite vanjsku nesterilnu vrećicu od aluminijске folije i izvadite sadržaj iz unutrašnje vrećice. (Napomena: Vrećica od aluminijске folije i vanjska površina unutrašnje plastične vrećice **NISU STERILNE**. STERILAN je samo sadržaj plastične vrećice).
- Pažljivo postavljajući podlošku na ravnu površinu na sterilnom području, odvezite traku oko ručke i izvadite kateret iz zaštitnog namota.
- Provjerite postoje li na uvnitru katereta vidljivi nagibi te da nije savijen ni na drugi način oštećen. Oštećenjem proizvoda može se narušiti njegova funkcionalnost.
- Fiziološkom otopinom koja sadrži heparin napunite štrcaljku zapremine 3 ml, spojite na pričvršćeni element luer za ispiranje (slika 1, stavka 12) i primijenite pozitivan tlak. Ispirite dok se fiziološka otopina ne pojavi na distalnom kraju katereta.
- Provjerite distalni kraj katereta te se pobrinite da je stent (slika 1, stavka 4) u potpunosti prekriven vanjskim omotačem.

Ne upotrebljavajte proizvod ako je oštećen ili ako je stent djelomično proširen.

Kompatibilnost s dodatcima

Uz proizvod NITIDES mogu se upotrebljavati omotači uvdodnice promjera 6F (2,0 mm) ili oni većeg promjera.

Uz proizvod NITIDES mogu se upotrebljavati žice vodilice dužine 0,035 in (0,89 mm) ili one manje dužine. Izbor krutosti žice vodilice i konfiguracije vrha ovisi će o kliničkom iskustvu liječnika.

Ako je nužno upotrijebiti vodeći kateret, sustavi su kompatibilni s vodećim kateriterima promjera 8F (2,7 mm) ili s onima većeg promjera. U ovom slučaju, uverite se da je hemostatski ventil u cijelosti otvoren prije uvođenja odabranog sklopa.

Uvođenje stenta

- Pobrinite se da sigurnosni ključ (slika 1, stavka 10) ručke bude u zaključanom položaju (dio označen slovom B).
- Oprite izloženi dio žice vodilice fiziološkom otopinom koja sadrži heparin kako biste uklonili tragove krvni i kontrastnog sredstva.
- Pogurajte sustav preko žice vodilice dok stent ne dođe do mesta liječenja. Ako u bilo kojem trenutku dođe do neobična otpora, nemojte silom uvođiti sustav: izvucite uvdodnicu, žicu vodilice i proizvod kao jedinstvenu cjelinu. Primjenom

prekomjerne sile i/ili nepravilnim rukovanjem može se dovesti do slučajne implementacije stenta ili do oštećenja uvodnog katetera.

Pogurivanje proizvoda

- Pogurujte sustav do točke pri kojoj se distalni markeri stenta nalaze izvan područja lezije.
- Povlačite sustav dok stent ne bude u ravnni s lezijom.
- Uverjite se da se dio sustava za isporuku koji se nalazi izvan bolesnikova tijela slobodno proteže i da je ravan.

Oprez: ako se sustav za isporuku ispravno ne proteže, stent bi se mogao implementirati izvan područja liječene lezije.

Ugradnja i proširivanje stenta

- Jednom rukom čvrsto držec rukču, provjerite jesu li radiokontrastni markeri postavljeni proksimalno i distalno s obzirom na položaj lezije.
- Uverite se da se omotač uvodnice ne pomiče tijekom implementacije stenta.
- Sigurnosni kluč na ručci okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (slika 1, dio označen slobom B) kako biste je otključali (1. KORAK), a zatim ga u cijelosti izvucite (2. KORAK).
- Držeci rukču u nepomičnom položaju: odnosu na bolesnika, još jednom provjerite jesu li radiokontrastni markeri u željenom položaju u odnosu na leziju; otpočnite implementaciju stenta palcem okrećući kotačić (slika 1, stavka 9) u smjeru naznačenom strelicom, a kako se prikazuje na slici 1.
- Tijekom primjene fluorokopije, kada se distalni kraj stenta dobro pričvrsti za stijenke krvne žile, nastavite implementaciju okrećući kotačić dok se kraj stenta ne otvori te dok se on u cijelosti ne ugradi u stijenke krvne žile.
- Ako je potrebna brza implementacija, postupite kako se navodi u nastavku: pobrinite se da na stražnjem kraju ručke nema prepreka (npr. pritegnite je ženski pričvršni element luer), drugom rukom uhvatite stražnji kraj proizvoda (dio za povlačenje, slika 1, stavka 11) i povucite ga, pritom držeći prednji dio ruke što je više moguće nepomičnim u odnosu na bolesnika, a kako se prikazuje na slici 1.
- Fluoroskopski provjerite je li se stent u potpunosti proširo.
- Stent se, ako je to potrebno, dodatno može proširiti balonskim kateterom za PTA. Pri odabiru promjera balonskog katetera i pri provođenju postupka nakon širenja, pogledajte promjer krvne žile koja se procijenila postupkom angiografije. U svakom je slučaju potrebno posebno paziti da se stent ne proširi na promjer veći od nazivnog promjera, a koji se navodi na oznaci proizvoda.
- Krajnji promjer stenta mora odgovarati referentnom promjeru krvne žile.

15. MOGUĆI ŠTETNI DOGĀDAJI

U moguće štetne događaje u vezi s ugradnjom perifernog stenta ubrajuju se rizici u vezi s perkutanim transluminalnom angioplastikom i dodatni rizici u vezi s upotrebom stentova, a kako je naznačeno u nastavku.

- Infekcija na mjestu uvođenja, bol i hematom
- Alergijska ili štetna reakcija na kontrastno sredstvo, lijekove koji se upotrebljavaju tijekom postupka ili na materijale od kojih je stent izrađen
- Spazm arterije
- Arterijska tromboza ili tromboza stenta
- Aneurizma ili pseudoaneurizma femoralne arterije
- Aterosklerotska distalna embolizacija
- Krvarenje
- Smrt
- Disekcija, perforacija ili ruptura krvne žile u koju se ugradio stent
- Embolija
- Zatajenje bubrega
- Ishemija donjih ekstremiteta (za koju je potrebna kirurška intervencija)
- Restenoza arterije u koju se ugradio stent
- Embolizacija stenta
- Okluzija krvne žile ili neizlijječena stenoza

16. ODGOVORNOST I JAMSTVO

Proizvođač osigurava da je proizvod dizajniran, proizveden i zapakiran uz najveću pažnju, uz primjenu tehniku koja su se procijenile najprikladnijima među trenutačno dostupnim tehnikama na postojećoj razini razvijenosti tehnologije i uz primjenu načela integracije sigurnosnih standarda u dizajnu i izradi, a kako bi se omogućila sigurnost upotrebe proizvoda pod utvrđenim uvjetima i u namijenjene svrhe, poštujući pritom mjeru opreza opisane u prethodnim odlomcima, što u svakom slučaju za cilj ima u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti rizike u vezi s upotrebom ovog proizvoda, ali ne i u potpunosti ih otkriti.

Uredaj se mora upotrebljavati isključivo pod odgovornošću specijaliziranoga medicinskog osoblja, uzimajući u obzir preostealte rizike te moguće nuspojave i komplikacije liječenja kojem je proizvod namijenjen, uključujući i one spomenute u drugim odjeljcima ove knjižice s uputama.

Tehničkom složenošću i iznimno ozbiljnom naravi odabira liječenja i postupaka primjene proizvoda isključuje se bilo kakvo jamstvo proizvođača, izričito ili prešutno, u vezi s učinkovitošću rezultata nakon upotrebe proizvoda te u vezi s njegovom učinkovitošću u otklanjanju stanja invaliditeta ili bilo kojim drugim patološkim ili zdravstvenim problemom. U stvari, s kliničkog stajališta i kada je riječ o funkcionalnosti i trajanju proizvoda, rezultati ovise i o brojnim čimbenicima koji su izvan kontrole proizvođača, a među kojima se, isključivo kao primjeri, ne iscrpno, navode i stanje bolesnika, kirurški postupak ugradnje ili upotrebe te postupci rukovanja proizvodom nakon otvaranja pakiranja.

Imajući u vidu ove čimbenike, odgovornost proizvođača postoji samo ako je dokazano da su na proizvod utjecali njegovi nedostaci u trenutku stavljanja u optjecaj. U tu svrhu, korisnik smješta mora proizvod staviti na raspolažanje proizvođača, u skladu s uvjetima isteka i propisivanja predviđenih zakonom; proizvođač zadržava pravo pregleda proizvoda koji se smatra neispravnim i utvrđivanja postoje li uistinu nedostaci kojima se može utjecati na njegovu sigurnost. Proizvođač je oslobođen odgovornosti ako je (i) utvrđeni nedostatak nastao zbog usklađenosti proizvoda s obaveznim pravilom ili obvezujućom odredbom i/ili ako (ii) nedostatak kojim se prouzrokovala šteta nije postojao u vrijeme kada je proizvođač proizvod stavio u promet i/ili (iii) ako se, u okviru

tehnoloških i znanstvenih saznanja, u vrijeme kada je proizvođač proizvod stavio u promet, dotični proizvod nije mogao smatrati neispravnim i/ili (iv) u bilo kojem drugom slučaju, također različitim od prethodno navedenih, u kojem se zakonom izričito isključuju ili ograničava odgovornost proizvođača za štetu nastalu uslijed neispravnosti proizvoda. Jamstvo se isključivo odnosi na zamjenu neispravnog proizvoda drugim proizvodom iste ili istovrijedne vrste izrade dotičnog proizvođača. Jamstvo vrijedi samo ako se proizvod pravilno vratio proizvođaču uz detaljan pisani izveštaj o utvrđenim nedostatcima i, u slučaju kirurški ugrađenog proizvoda, o razlozima zašto se proizvod uklonio iz bolesnikova tijela. Utvrđeni nedostaci moraju se žurno prijaviti proizvođaču u skladu s uvjetima odricanja od prava i zakonske zastare.

Nakon zamjene proizvoda, proizvođač će korisniku nadoknaditi troškove koji su nastali zbog vraćanja dokazano neispravnog proizvoda.

Proizvođač odbija svaku odgovornost za bilo koje slučajevje u kojima se ne poštuju metode upotrebe proizvoda i mjere opreza koje se navode u ovom priručniku te u slučaju upotrebe proizvoda nakon isteka roka valjanosti upotrebe koji je otisnut na pakiranju.

Nadalje, proizvođač odbija svaku odgovornost u vezi s posljedicama medicinskih odluka i postupcima upotrebe ili primjene proizvoda te se stoga ni u kakvim okolnostima neće kažneno progoliti ni za kakvu materijalnu, biološku ili moralnu štetu uslijed primjene proizvoda i izbora tehnike na koju se rukovat prolazvoda odlučio pri postupku kirurške ugradnje.

Posrednici i predstavnici proizvođača nemaju ovlasti mijenjati nijedan od prethodno navedenih uvjeta, preuzeći ikiju dodatnu obavezu ni pružati ikakva jamstva u vezi s ovim proizvodom, osim kako se gore navelo. Ovo se jamstvo regulira talijanskim zakonom, osim ako se ne primjenjuju obavezni zakoni druge države, a u slučaju da je proizvođač odobrio optjecaj proizvoda u jednoj državi izvan Italije ili u većem broju njih.

ROMÂNĂ

NiTIDES

Sistem cu stent periferic autoexpandabil cu elutie Amphilimus™ (Sirolimus+acizi grași) îmbrăcat în „Carbofilm”™

1. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Familia de dispozitive NiTiDES constă dintr-un stent autoexpandabil și un sistem pentru poziționarea și dispunerea corectă a acestuia.

Stentul este un dispozitiv implantabil autoexpandabil, flexibil. Dispozitivul este realizat din aliaj de nichel și titan (Nititol) și este îmbrăcat în „Carbofilm”™, un strat subțire de carbon cu o structură turbostratică cu densitate înaltă, identică în mare parte cu cea a carbonului pirolitic.

Procesul de îmbrăcare a substratului îl oferă acestuia caracteristicile biocompatibile și hemocompatible ale carbonului pirolitic, fără să afecteze proprietățile fizice și structurale ale substratului în sine.

Pe stent sunt aplicati sâșii markeri radioopaci de tantal (trei la fiecare capăt) care să permită poziționarea corectă la locul leziunii întărită.

Suprafața exterioară a stentului are caneluri dedicate, îmbrăcate complet în „Carbofilm”™, pentru a contine preparatul farmaceutic Amphilimus™, care este compus din medicamentul Sirolimus și un amestec de acizi grași cu lanț lung. Dozajul specific de medicament pentru suprafață tratată a vasului este de aproximativ 0,9 µg/mm², care corespunde unei doze minime de 270 µg pe stentul mai mic (6,0x20 mm) și unei doze maxime de 2420 µg pe stentul mai mare (8,0x150 mm).

Sistemul de livrare utilizat este de tip „peste fir”, asigurând poziționarea și dispunerea în siguranță a stentului la locul leziunii. Este reprezentat schematic în Figura 1 și constă din:

- un corp al cateterului (7) 6F în diametru, compus din:
 - o teacă exterioară retractabilă, secțiune distală, semi-transparentă (3) care conține stentul (4); teaca are un guler radioopac (13) în apropierea vârfului cateterului;
 - un lumen intern ce conține o bobină (6) și un tub intern (2) prin care poate trece un fir de ghidaj de 0,035 inci; lumenul intern se întinde de-a lungul cateterului începând de la o piesă luer (12) fixată în apropierea mânerului și se încheie distal, la vârful (1) realizat din material radioopac, astfel încât să faciliteze amplasarea și poziționarea stentului atunci când acesta este vizualizat pe un sistem de imagistică. O piedică (5) integrală cu un lumen intern previne deplasarea axială a stentului pe durata retragerii tecii exterioare;
 - un mâner (8) cu sistem de livrare integrat, care permite poziționarea cateterului și eliberarea stentului la locul potrivit.
- Mânerul are un design ergonomic care îl permite operatorului să îl țină și să îl folosească chiar și cu o singură mână. Are un orificiu luer (12) la capătul proximal, care este utilizat pentru a spăla lumenul firului de ghidaj, o cheie de siguranță (10), o rotație (9) și o parte terminală care se trage (11).

Producătorul poate direcționa stentul periferic + sistemul de cateter de dispunere și implementează totalele procedurile de control al călătirii atât pe parcursul producției, cât și la produsele finite, în conformitate cu instrucțiunile de Bune practici de fabricație.

2. SCOPUL UTILIZĂRII DISPOZITIVULUI

Sistemul cu stent periferic autoexpandabil este destinat tratamentului bolii arteriale periferice care afectează artera femurală superficială și artera poplitea proximală.

3. INDICAȚIA DISPOZITIVULUI

Dispozitivul este indicat pentru tratamentul stenozelor arteriale femuro-poplitee deasupra genunchiului la pacienții adulți simptomatici [categoria Rutherford 2-5]. Leziunea tratată, cu o lungime maximă de 14 centimetri, trebuie să fie cu ocluzie sau stenoză mai mare de 50%, de novo sau restenotică, nefratață anterior cu un stent.

4. CONTRAINDICAȚII

Utilizarea stentului este contraindicată în următoarele situații:

- Leziuni considerate imposibil de tratat prin ATP sau prin alte tehnici de intervenție.
- Femei însărcinate și care alăptează.
- Leziuni localizate în cele două treimi distale ale arterei poplitee sau la articulația genunchiului.
- Afecțiuni clinice care împiedică utilizarea terapiei antitrombotice și/sau anticoagulante.

5. AVERTISMENTE

- Utilizarea dispozitivului nu este recomandată pentru pacienții cu hiperSENSIBILITATE sau alergii cunoscute la Sirolimus, la acizi grași (precum acidul stearic, acidul palmitic, acidul behenic) sau la componente metalice ale stentului (precum nichel, titan și tantal).
- Aceasta este un dispozitiv de unică folosință. A nu se reutiliza, reprelucra sau resteriliza. Aceste acțiuni pot genera riscuri de contaminare a dispozitivului și/sau infecții ale pacientului, inflamații și transmitere a unor boli infecțioase de la un pacient la altul.
- Dispozitivul este conceput pentru a funcționa ca un sistem. Nu utilizați componentele acestuia separat.
- Nu utilizați dispozitivul dacă ambalajul a fost deschis sau deteriorat, depozitat incorrect sau dacă data de expirare a fost depășită. În astfel de situații, nu este garantat caracterul steril al produsului.
- Dispozitivul trebuie utilizat numai de către medici special instruiți pentru a efectua angioplastie transluminală percutană (ATP) și implantare de stenturi periferice.
- În cazul întăririi unei rezistențe în orice moment pe parcursul procedurii de introducere, nu forțați sistemul: retrageți sistemul cu stent și întregul cateter

de livrare, firul de ghidaj și teaca de introducere ca o singură unitate. Aplicarea unei forțe excesive și/sau manevrarea incorrektă pot duce la dispunerea accidentală a stentului sau la deteriorarea cateterului de poziționare.

- În orice moment de pe parcursul procedurii, manevrarea incorrektă poate provoca dissecția, perforarea sau ruperea vasului.
- Nu avansați sau nu retrageți sistemul cu stent în timpul poziționării: acest lucru poate provoca leziuni grave în peretei vaselor.
- Implantarea unui stent periferic autoexpandabil poate duce la dissecția vasului distal și/sau proximal față de stent și poate provoca, de asemenea, ocluzia acută a vasului, creând astfel necesitatea unei intervenții chirurgicale suplimentare (operatie de înlocuire vasculară chirurgicală, dilatație suplimentară, poziționarea de stenturi suplimentare sau altă procedură).
- Odată ce a fost dispus parțial, stentul nu poate fi recuperat utilizând sistemul de livrare.

6. PRECAUȚII

- Nu utilizați niciodată sistemul de eliberare rapidă la începutul expandării stentului. Utilizați-l doar dacă este necesar, după eliberarea a cel puțin jumătate din lungimea stentului.
- Dispozitivul trebuie manevrat cu atenție pentru a evita orice contact cu instrumente metalice sau abrazive care l-ar putea deteriora sau care ar putea produce modificări mecanice.
- Dispozitivul nu trebuie să vină în contact cu lichide înainte de pregătire și poziționare.
- Sistemul de poziționare a dispozitivului nu este destinat utilizării împreună cu injectoare de substanță de contrast.
- În situațiile în care stenturile sunt implantate succesiv, markerii radioopaci respectivi se vor suprapune. Suprapunerea nu trebuie să implice mai mult de două stenturi.
- În cazul stenturilor suprapuse, se recomandă o suprapunere mai mică de 20 mm.
- Pentru a evita deteriorarea stentului, se va acorda o atenție deosebită la fiecare trecere a firului de ghidaj sau a cateterului cu balon printr-un stent care tocmai a fost dispus.

7. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA IRM

Testarea non-clinică a demonstrat că liniile de produse de stent Nitinol ale producătorului prezintă condiții pentru RMN. Un pacient căruia i-s-a implantat un astfel de dispozitiv poate fi scanat în siguranță într-un sistem RMN, în următoarele condiții:

- Câmp magnetic static de 1,5 Tesla (1,5T) sau 3 Tesla (3T)
- Gradientul spațial maxim al cimpului de 6.140 G/cm (61,40 T/m)
- Sistem RM maxim raportat, rata de absorbtie specifică (SAR) medie pentru tot corpul de:
 - 1 W/kg (mod de operare normal) la 1,5T
 - 1 W/kg (mod de operare normal) la 3T

Încălcarea RF

În condițiile de scanare prezentate mai sus, este de așteptat ca liniile de produse stent Nitinol ale producătorului să producă o creștere maximă a temperaturii sub 6,8 °C după 15 minute de scanare continuă într-un sistem RMN raportat, cu o rată de absorbtie specifică (SAR) pentru întregul corp de 1,0 W/kg.

1,5 T 3 T

Configurare stent unic	Cea mai mare modificare de temperatură	≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
Configurare stent suprapus	Cea mai mare modificare de temperatură	≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C

Artefact RMN

În testarea non-clinică, artefactualul imagistic provocat de dispozitiv se extinde la aproximativ 0,7 cm de la stenturile Nitinol ale producătorului în cazul imaginisticii cu sevențe de impuls de ecou gradient și de ecou de spin într-un sistem RMN 3T.

8. MOD DE PREZENTARE

Dispozitivul NiTiDES este furnizat steril (utilizând un amestec de oxid de etilenă și CO₂), de unică folosință și ambalat în două pungi care nu trebuie aduse într-o zonă sterilă. **NOTA: punga interioară este singura barieră sterilă.**

Caracterul steril și stabilitatea chimică sunt garanteate atât timp cât ambalajul rămâne intact și până la data de expirare tipărită pe ambalaj (A SE UTILIZA PÂNĂ LA).

Conținut: un (1) sistem cu stent periferic autoexpandabil cu elutie Amphilimus™ (Sirolimus+acizi grași) îmbrăcat în „Carbofilm”™

9. DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat conform indicațiilor de pe ambalaj, într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură de depozitare de maxim 25 °C.

10. MODELE

Dispozitivul NiTiDES este identificat printr-un cod de model și un număr de lot; codurile produselor disponibile sunt prezentate în Tabelul 1.

11. SCHEMĂ DE TRATAMENT

Studiile din literatura clinică indică necesitatea administrării tratamentului antitrombotic pre-operator, a tratamentului anticoagulant în timpul procedurii și a tratamentului antitrombotic post-operator.

Tratamentul antitrombotic pe durata perioadei ulterioare procedurii implică administrarea de:

- Tienvopridine (ticlopidin sau clopidogrel sau prasugrel în dozele indicate în broșura de instrucții corespunzătoare sau conform prescripției medicale)
- Aspirină în cantitate minimă de 100 mg/z pe termen nelimitat

Având în vedere complexitatea procedurii și factorii principali care influențează starea pacientului, stabilirea terapiei adecvate rămâne la latitudinea medicului.

12. INTERACȚIUNI CU MEDICAMENTE

Deși nu sunt disponibile niciun fel de date clinice concrete, anumite medicamente, precum Tacrolimus, care acionează prin aceeași proteină de legare (FKBP), pot afecta siroliumin. Siroliumin este metabolizat de către CYP3A4. Inhibitorii puternici ai CYP3A4 pot determina o expunere mai mare la Siroliumin, în special în cazul implantului multiplu. Trebuie avută în vedere și expunerea sistemică la Siroliumin în cazul în care pacientul își se administrează concomitant medicamente imunosupresoare sistemic.

13. STUDIU CLINIC CU NITIDES

Siguranța și eficacitatea de bază ale stentului Nitides au fost determinate prin studiu clinic pivot pre-comercializare ILLUMINA.

Proiectul studiului: În cadrul unui studiu multicentric, cu un singur brat, 100 de pacienți cu boala femuro-poplitee simptomatică cu o lungime maximă a leziunii de 14 cm au fost tratați cu stentul Nitides. Eficacitatea primară (permeabilitatea primară) și obiectivul primar de siguranță (compus din evenimente adverse majore: deces, amputarea membrului întărit, ischemia membrului întărit care necesită intervenție chirurgicală sau reparație chirurgicală a vasului întărit sau revascularizare a leziunii întărită realizată clinic, agravație scorului Rutherford cu 2 clase, sau până la clasa 5 sau 6) au fost comparate cu un obiectiv de performanță obiectiv (OPG) la 12 luni.

Rezultate: Succesul procedural a fost obținut în proporție de 100%.

Rezultatele la ecografia Doppler arată o permeabilitate primară de 87% (77/89, interval de încredere 95% de 80-94), îndeplinind cerințele OPG (73%).

Permeabilitatea primară la 24 de luni a fost 81% (63/78).

Obiectivul primar de siguranță pe 12 luni a fost 96,8% (90/93), îndeplinind cerințele OPG (19,6%), 2,2% (2/93) dintre pacienți au prezentat revascularizare a leziunii întărită realizată clinic, 1,1% (1/93) au murit, 0 au suferit amputarea membrului întărit.

Ou au prezentat ischemie a membrului întărit care necesită intervenție chirurgicală sau reparări chirurgicale ale vasului întărit și 0 au prezentat o agravație cu două clase sau clasa 5 și 6 a scorului Rutherford.

Obiectivul de siguranță pe 24 luni a fost 87,8% (79/90), 6,7% (6/90) dintre pacienți au prezentat revascularizare a leziunii întărită realizată clinic, 3,3% (3/90) au murit, 0 au suferit amputarea membrului întărit, 1,1% (1/90) au prezentat ischemie a membrului întărit care necesită intervenție chirurgicală sau reparări chirurgicale ale vasului întărit și 1,1% (1/90) au prezentat o agravație cu două clase sau clasa 5 și 6 a scorului Rutherford.

14. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Selectarea dispozitivului

Pentru a stabili lungimea stentului necesar, se va măsura lungimea leziunii întărită. Pentru a acoperi în mod corespunzător leziunea, lungimea stentului poziționat trebuie să fie cu cel puțin 5 mm mai lungă decât leziunea în sine, pe ambele părți. Pentru a stabili dimensiunea corespunzătoare a stentului, se va măsura diametrul vasului, proximal și distal față de leziune. Pentru a asigura o poziționare sigură a stentului, utilizați diametrul mai mare ca bază pentru alegerea dimensiunii adecvate a stentului. La selectarea modelului, se vor consulta informațiile din tabelul 1.

Pregătirea dispozitivului

Înainte de livrarea stentului, administrați heparină și verificati dacă timpul de coagulare activat (ACT) al pacientului este în conformitate cu practica Centrului. În timpul pregătirii sistemului, aveți grijă să nu permiteți niciunui lichid să intră în contact cu stentul.

- Deschideți cutia și scoateți punga care conține punga sterilă.
- După examinarea ambalajului pentru eventuale deteriorări, deschideți punga externă din folie de aluminiu nesterilă, apoi scoateți conținutul din punga internă. (Notă: Punga din folie de aluminiu și suprafața exterñă a punghii interne din plastic NU SUNT STERILE). Doar conținutul punghii din plastic este STERIL.
- Asigurați-vă că poziționați suportul pe o suprafață plană într-o zonă sterilă, desfaceți banda din jurul mânerului și scoateți cateterul din folia protectoare.
- Verificați dacă există răscruzi, îndoiri sau alte deteriorări ale cateterului de livrare. Este posibil ca deteriorarea dispozitivului să-i afecteze performanța.
- Umpleți o seringă de 3 ml cu soluție fiziologică cu heparină, conectați la piesa luer de spârle (figura 1, elementul 12) și aplicați presiune pozitivă. Continuați spârarea până când soluția fiziologică ieșe prin capătul distal al cateterului.
- Înspectați capătul distal al cateterului, asigurăți-vă că stentul (figura 1, elementul 4) este acoperit complet de teaca externă.

Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau dacă stentul este expandat parțial.

Compatibilitate cu accesoriu

Tecile de introducere cu diametrul de 6F (2,0 mm) sau mai mare pot fi utilizate cu dispozitivele Nitides.

Firele de ghidare de 0,035 inci (0,89 mm) sau mai mici pot fi utilizate cu dispozitivele Nitides. Alegerea rigidității firului de ghidaj și a configurației vârfului va depinde de experiența clinică a medicului.

În eventualitatea în care este necesară utilizarea unui cateter de ghidaj, sistemele sunt compatibile cu cateterul de ghidaj cu un diametru egal cu 8 F (2,7 mm) sau superior. În acest caz, asigurați-vă că valva hemostatică este complet deschisă înaintea de a introduce ansamblul selectat.

Introducerea stentului

- Asigurați-vă că cheia de siguranță (figura 1, elementul 10) a mânerului se află în poziția închisă (detaliul B).
- Spălați partea expusă a firului de ghidaj cu o soluție fiziologică cu heparină pentru a îndepărta urmele de sânge și de substanță de contrast.
- Înaintați cu sistemul peste firul de ghidaj până când stentul ajunge la locul de tratament.

Dacă se întâmpină o rezistență neobișnuită în orice moment, nu forțați sistemul; retrageți teaca de introducere, firul de ghidaj și dispozitivul ca o singură unitate.

Aplicare unei forțe excesive și/sau manevrarea incorectă pot duce la dispunerea accidentală a stentului sau la deteriorarea cateterului de poziționare.

Avansarea cu dispozitivul

- Înaintați cu sistemul până în punctul în care stentul se află dincolo de leziune.
- Retrageți sistemul până când stentul este aliniat cu leziunea.
- Verificați ca parteau sistemului de livrare situată în exteriorul corpului pacientului să fie extinsă liber și dreaptă.

Atenție: dacă sistemul de livrare nu este întins corespunzător, stentul ar putea fi dispus dincolo de leziunea întărită.

Implantarea și expandarea stentului

- Apucând ferm mânerul cu o mână, verificați dacă markerii radioopaci de pe stent sunt poziționați proximal și distal în raport cu leziunea.
- Asigurați-vă că teaca de introducere nu se mișcă pe parcursul dispernării stentului.
- Rotiti cheia de siguranță de pe mâner în sens antiorar (figura 1, detaliul B) pentru a îl debloca (PASUL 1), apoi trageți-l afară complet (PASUL 2).
- Mintenăti mânerul în poziție fixă față de pacient, verificați încă o dată că markerii radioopaci sunt în poziția dorită față de leziune; începeți disperarea stentului răsucind rotita (figura 1, elementul 9) cu degetul în direcția săgelei, așa cum este indicat în figura 1.
- Sub fluoroscopic, când capătul distal al stentului este bine atașat de peretii vasului, continuați disperarea răsucind rotita până când capătul stentului este deschis și este implantat complet în peretii vasului.
- Dacă este necesară o disperare rapidă, procedați după cum urmează: asigurați-vă că nu există obstrucții (de ex. piesă luer mamă înșurubată) în capăt din spate al mânerului, apucăți capătul din spate al dispozitivului (în spate, figura 1, elementul 11) cu cealaltă mână și trageți-l, înținând parte din fată a mânerului față de pacient perfect nemicșată, așa cum este indicat în figura 1.
- Verificați fluoroscopic dacă stentul s-a expandat complet.
- Dacă este necesar, stentul poate fi expandat suplimentar, utilizând un cateter cu balon PTA. În selectarea diametrului cateterului cu balon și în realizarea post-expandării, vă rugăm să vă raportați la diametrul vasului, evaluat prin intermediu angiografiei. Indiferent de situație, acordați o atenție deosebită pentru a nu expanda stentul peste diametrul nominal specificat menționat pe etichetă.
- Diametrul final al stentului trebuie să fie adecvat diametrului de referință al vasului.

15. POSIBILE EFECTE ADVERSE

Possiblele efecte adverse ce ar putea fi asociate cu implantarea stentului periferic includ riscuri legate de angioplastia transluminálă percutană și riscuri suplimentare cu utilizarea stenturilor, după cum este indicat mai jos.

- Infecție, durere și hematom la locul de introducere
- Reacție alergică sau adversă la substanța de contrast, la medicamentele utilizate în timpul procedurii sau la materialele din care este alcătuit stentul
- Spasim ent arterial
- Tromboza arterială sau de stent
- Anevrism sau pseudoanevrism arterial femural
- Embolizare distală atherosclerotică
- Hemoragie
- Deces
- Dissecție, perforare sau ruperea vasului la care este implantat stentul
- Embolie
- Insuficiență renală
- Ischemie membrelor inferioare (care necesită intervenție chirurgicală)
- Restenoza arterei în care este implantat stentul
- Embolizarea stentului
- Ocluzia vasului sau stenoza nerezolvată

16. RESPONSABILITATE SI GARANTIE

Producătorul garantează că dispozitivul a fost proiectat, fabricat și ambalat cu atenție, folosind tehnicii considerate cele mai potrivite dintre cele disponibile conform tehnologiei actuale și aplicând principiile integrării siguranței în proiectare și construcție, pentru a garanta o utilizare sigură atunci când produsul este utilizat în condiții și în scopurile preconizate, respectând măsurile de precauție indicate în paragrafele anterioare și vizând, în orice situație, reducerea pe cât posibil, însă fără eliminarea totală, a riscurilor legate de utilizarea dispozitivului.

Dispozitivul trebuie utilizat exclusiv sub responsabilitatea personalului medical specializat și luând în considerare riscurile reziduale și posibilele efecte secundare și complicații ale terapiei pentru care a fost destinat, inclusiv cele menționate în celelalte secțiuni ale acestei broșuri de instrucții.

Complexitatea tehnică și natura critică a deciziilor medicale și a metodelor de aplicare a dispozitivului exclud orice garanție a Producătorului, explicită sau implicită, cu privire la eficacitatea rezultatului în urma utilizării dispozitivului sau la eficacitatea acestuia în rezolvarea unei stări de dizabilitate sau a oricărui altă patologii sau probleme medicale. În realitate, rezultatele, atât din punct de vedere clinic, cât și din punct de vedere al funcționalității și duratăi dispozitivului, depind, de asemenea, de numeroși factori care sunt dincolo de controlul producătorului, dintr-un amintim doar ca exemplu și nu drept condiții exhaustive pacientul, procedura chirurgicală de implantare sau utilizare, metodele de manipulare a dispozitivului după deschiderea ambalajului.

Având în vedere acești factori, răspunderea Producătorului există numai dacă s-a constatat că dispozitivul a prezentat defecți în momentul punerii sale în circulație. În acest scop, Clientul trebuie să pună imediat dispozitivul la dispoziția Producătorului, în conformitate cu termenele de expirare și prescripție cerute de lege; Producătorul își rezervă dreptul de a examina dispozitivul considerat defect și de a stabili dacă acesta prezintă într-adevăr defecți care pot afecta siguranța produsului. Răspunderea Producătorului este excludată dacă (i) defectul reclamat se datorăză conformității dispozitivului cu o regulă obligatorie sau o dispoziție obligatorie și/sau (ii) defectul care a cauzat dauna nu a existat atunci când Producătorul a eliberat dispozitivul și/sau (iii) dacă starea cunoștințelor tehnice și științifice din momentul în care Producătorul a eliberat dispozitivul nu a permis ca dispozitivul să fie considerat defect și/sau (iv) în orice alt caz, diferit

de cele menționate mai sus, în care legea exclude în mod expres sau limitează responsabilitatea Producătorului pentru daune cauzate de produse defecte. Garanția constă exclusiv în înlocuirea dispozitivului defect cu un alt dispozitiv al Producătorului, de fabricație similară sau echivalentă.

Garanția se aplică doar dacă dispozitivul este returnat Producătorului ambalat corect, alături de un raport scris detaliat privind defectele reclamate și, în cazul unui dispozitiv implantat, de motivele pentru care acesta a fost îndepărtat de la pacient. Defectele reclamate trebuie raportate imediat Producătorului, în conformitate cu condițiile de penalizare și prescripția legală.

După efectuarea înlocuirii, Producătorul va rambursa Clientului cheltuielile suportate de acesta pentru returnarea dispozitivului defect recunoscut.

Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării metodelor de utilizare și a măsurilor de precauție indicate în acest manual de instrucțiuni și în cazul utilizării după data de expirare indicată pe ambalaj.

În plus, Producătorul își declină orice responsabilitate legată de consecințele care apar din alegerea terapeutice și metodelor de utilizare sau de aplicare a dispozitivului; în consecință, Producătorul nu poate fi răspunzător în nicio situație pentru nicio vătămare de orice natură, materială, biologică sau morală, care rezultă din aplicarea dispozitivului și din tehnica de implantare utilizată de operator.

Agentii și reprezentanții Producătorului nu sunt autorizați să modifice niciuna dintre condițiile menționate mai sus și nici să ia angajamente suplimentare sau să ofere vreo garanție în legătură cu acest produs, altele decât cele indicate mai sus. Această garanție este reglementată de legislația italiană, cu excepția cazului în care se aplică legile obligatorii ale altui stat, în cazul în care Producătorul a autorizat circulația produsului în unul sau mai multe state, altele decât Italia.

POLSKI

NITIDES

powlekany warstwą „Carbofilm™ samorozprężalny stent obwodowy uwalniający Amphilius™ (połączenie sirolimusu i kwasu tłuszczyowego)

1. OPIS WYROBU

Linia narzędzi NITIDES składa się z samorozprężalnego stentu i systemu wprowadzania do jego prawidłowego umieszczenia i wprowadzania.

Stent jest elastycznym, samorozprężalnym urządzeniem przeznaczonym do implantacji. Jest wykonyany ze stopu niklu i tytanu (Nitilon) i pokryty cienką warstwą węgla „Carbofilm™ o dużej gęstości i budowie turbostratycznej, zasadniczo identycznej z budową węgla pyrolyticznego.

Pokrycie substratu nadaje mu właściwości bio- i hemokompatybilne węgla pyrolyticznego, bez wpływu na fizyczne i strukturalne właściwości samego substratu. Stent posiada sześć radiocjenniujących znaczników wykonanych z tantalum (trzy na każdym końcu), umożliwiających prawidłowe umieszczenie stentu w miejscu docelowej zmiany.

Zewnętrzna powierzchnia stentu posiada specjalne rowki, w całości pokryte węglem „Carbofilm™ do pokrywania substancją farmaceutyczną Amphilius™, która składa się z leku Sirolimus i mieszaniny długochowuchowych kwasów tłuszczyowych.

Specyficzna dawka leku w stosunku do powierzchni leczonego naczynia wynosi około 0,9 µg/mm², co odpowiada minimalnej dawce 270 µg na mniejszym stentie (6,0 x 20 mm) oraz maksymalnej dawce 2420 µg na większym stencie (8,0 x 150 mm).

Zastosowany system wprowadzający typu przewodowego (ang. over-the-wire), zapewniający bezpieczne umieszczenie i zwolnienie stentu w miejscu zmiany. Schemat systemu przedstawiono na Rycinie 1. System składa się z następujących elementów:

- Korpusu cewnika (7) o średnicy 6F, złożonego z:
 - przesuwnej osłony zewnętrznej, której połółprzezroczysta część dystalna (3) obejmuje stent (4); osłona posiada kończer radiocjenniujący (13) przy końcach cewnika;
 - kanału wewnętrznego zawierającego cewkę (6) i rurkę wewnętrzną (2), kompatybilnego z prowadnikiem o średnicy 0,035 cala; kanał wewnętrzny biegnie wzdłuż cewnika od złącza typu Luer (12) zamocowanego proksymalnie do uchwytu i kończy się dystalnie na końcach (1) materiału radiocjenniującego, aby ułatwiać umieszczenie stentu przy podglądzie w systemie obrazowania. Ogranicznik (5) zintegrowany z kanałem wewnętrznym zapobiega przemieszczeniu osiowemu stentu podczas wysuwania zewnętrznej osłony;
 - Uchwytu (8) z systemem podającym, który umożliwia umieszczenie cewnika i uwolnienie stentu na miejscu.

Uchwyt ma ergonomiczny kształt, który umożliwia operatorowi jego chwycenie i używanie, także jedną ręką. Na końcu proksymalnym znajduje się port typu Luer (12), który służy do przekładki kanału prowadnika, kluczki zabezpieczającej (10), kółko (9) oraz odciągane zakończenie (11).

Producent wytwarza stent do różnych obwodowych i system wprowadzający z cewnikiem bezpośrednio oraz przestrzeg wszystkich procedur kontroli jakości, zarówno podczas produkcji, jak i w gotowym produkcie, zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania.

2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Samorozprężalny stent obwodowy jest przeznaczony do stosowania w leczeniu choroby tętnic obwodowych wpływającej na powierzchniową tętnicę udową i proksymalną tętnicę podkolanową.

3. WSKAZANIA DO STOSOWANIA URZĄDZENIA

Urządzenie jest przeznaczone do leczenia zwężeń tętnic udowych i podkolanowych u pacjentów dorosłych z objawami [skala Rutheforda 2–5]. Leczona zmiana o maksymalnej długości 14 cm musi być albo niedrożna albo zwężona o ponad 50% – orginalnie lub restenotycznie i nie leczona uprzednio za pomocą stentu.

4. PRZECIWWSKAZANIA

Zastosowanie stentu jest niewskazane w następujących sytuacjach:

- zmiany niedające się leczyć za pomocą zabiegów PTA lub innych technik chirurgicznych;
- u kobiet w ciąży i karmiących;
- zmiany umiejscowione w dystalnych dwóch trzecich tętnicy podkolanowej lub na wysokości stawu kolanowego;
- choroby ograniczające zastosowanie leczenia przeciwpylkowego i/lub przeciwkrzepkiego.

5. OSTRZEŻENIA

Użycie urządzenia nie jest zalecane u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością lub alergią na Sirolimus, kwasę tłuszczyową (np. kwas stearynowy, palmitynowy, behenowy) lub metalowe części stentu (nikiel, tytan i tantal).

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie wolno ponownie używać, ponownie dezynfekować ani sterylizować. Grozi to zanieczyszczeniem urządzenia i/lub zakażeniem pacjenta, stanem zapalnym i przeniesieniem chorób zakaźnych pomiędzy pacjentami.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy jako system. Nie stosować jego elementów oddzielnie.

Nie wolno używać urządzenia, jeśli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone, było niewłaściwie przechowywane lub upłynęła data ważności. W takich przypadkach nie gwarantuje się sterility produktu.

Urządzeniem powinno się posługiwać wyłącznie lekarze przeszkołeni konkretne w wykonywaniu zabiegów przezskórnej śródnczyniowej angioplastyki (percutaneous transluminal angioplasty, PTA) oraz wszczepianiu stentów obwodowych.

- W przypadku nietypowego oporu, nie należy używać siły: wyjąć system stentu i cały cewnik wprowadzający oraz prowadnik i introdutor jako jedną całość. Używanie nadmiernej siły i/lub nieprawidłowe posługiwanie się narzędziem może spowodować przypadkowe umieszczenie stentu w naczyniu lub uszkodzenie cewnika.
- Niewłaściwa obsługa urządzenia może spowodować przecięcie, perforację lub rozerwanie naczynia.
- Nie wsuwać ani nie wyciągać systemu stentu podczas wprowadzania: może to spowodować poważne uszkodzenie ścianek naczyni.
- Implantacja samorozprężalnego stentu obwodowego może spowodować przecięcie naczynia dystalnie i/lub proksymalnie do stentu oraz spowodować ostry zator naczynia, wymagający dodatkowego zabiegu (wyjmiana fragmentu naczynia, dalsze poszerzanie, umieszczenie dodatkowych stentów itp.).
- Po częściowym wprowadzeniu stentu nie można go wyjąć za pomocą systemu wprowadzającego.

6. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- W żadnym wypadku nie wolno stosować** systemu szybkozwalniającego na początku rozszerzania stentu. Wolno stosować go **tylko w koniecznych przypadkach**, po rozprężeniu co najmniej **połowy długości** stentu.
- Urządzeniem należy posługiwać się ostroźnie, aby uniknąć kontaktu z przyrządami metalowymi lub ściernymi, mogącymi je uszkodzić lub spowodować mechaniczne pogorszenie funkcjonowania.
- Urządzenie przed przygotowaniem i umieszczeniem nie może mieć styczności z cieciami.
- System wprowadzający urządzenia nie jest przeznaczony do stosowania z wstrzykiwaczami środka kontrastowego.
- W przypadku implantacji stentów jeden za drugim odpowiednie znaczniki radiocjenni powinny nachodzić na siebie. Nachodzenie może obejmować maksymalnie dwa stenty.
- W przypadku nachodzenia na siebie stentów, zakładka nie powinna przekraczać 20 mm.
- Aby uniknąć uszkodzenia stentu, należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu prowadnika, cewnika balonowego lub innego narzędzia poprzez świeżo rozprężony stent.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA MRI

Badania niekliniczne wykazały, że stenty z linii Nitinol są warunkowo bezpieczne w środowisku MR. Pacjenci z wszczepionym takim urządzeniem może bezpiecznie być poddawany badaniu rezonansem magnetycznym w następujących warunkach:

- Statyczne pole magnetyczne 1,5 tesli (1,5 T) lub 3 tesle (3 T)
- Maksymalny gradient przestrzenny pola 6140 G/cm (61,40 T/m)
- Maksymalny podawany dla systemu MR współczynnik absorpcji swoistej SAR wynoszący:
 - 1 W/kg (normalny tryb pracy) przy 1,5 T
 - 1 W/kg (normalny tryb pracy) przy 3 T

Nagrzewanie w wyniku RF

W warunkach obrazowania zdefiniowanych powyżej stenty z serii Nitinol nie powinny powodować wzrostu temperatury maksymalnej o więcej niż 6,8°C po 15 minutach ciągłego skanowania zgłoszonym systemem MR, przy współczynniku absorpcji swoistej (SAR) rzędu 1,0 W/kg.

	1,5 T	3 T
Najwyższa zmiana temperatury	≤6,3°C	≤6,2°C
Konfiguracja z nakładającymi się stentami Najwyższa zmiana temperatury	≤6,8°C	≤6,3°C

Artefakty obrazu MRI

W badaniach nieklinicznych artefakt obrazu wytworzony przez przyrząd rozciąga się na ok. 0,7 cm od stentów Nitinol, w przypadku obrazowania sekwencją impulsową gradient-echo i spin echo impuls w systemie MRI 3 T.

8. FORMA DOSTAWY

Urządzenie NiTiDES jest dostarczane sterylnie (sterylizacja mieszaniną tlenku etylenu i CO₂), jest jednorazowe i zapakowane w dwa worki, których nie wolno umieszczać w środowisku jałowym. **UWAGA: Jedyną ochroną sterility jest opakowanie wewnętrzne.**

Sterylność i stabilność chemiczna są gwarantowane pod warunkiem nienaruszenia opakowania i nieprzekroczenia daty ważności wydrukowanej na opakowaniu (DATA WAŻNOŚCI, ang. USE BEFORE DATE).

Zawartość: jeden (1) powlekony warstwą eCarbofilm™ samorozprężalny stent obwodowy uwalniający Amphilimus™ (połączenie sirolimusu i kwasu tłuszczykowego)

9. PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w sposób podany na opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu o temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

10. MODELE

Każde narzędzie NiTiDES jest identyfikowane za pomocą kodu modelu i numeru seryjnego, dostępne modele znajdują się w Tabeli 1.

11. STOSOWANIE LEKÓW

Literatura kliniczna wskazuje na konieczność leczenia przeciwpłytkowego przed zabiegiem, leczenia przeciwrzępielowego podczas niego oraz leczenia przeciwpłytkowego po zabiegu.

Leczenie przeciwpłytkowe w okresie po zabiegu obejmuje podawanie:

- tienoprydyn (tiklopidyn, klopidożerel lub prasigrelu w dawkach podanych w odpowiednich instrukcjach lub zgodnie z zaleceniem medycznym);
- aspiryny w minimalnej dawce 100 mg/dobę, do odwołania.

Biorąc pod uwagę złożoność zabiegu i wiele czynników wpływających na stan pacjenta, wybór odpowiedniego leczenia pozostaje w gestii lekarza.

12. INTERAKCJE Z LEKAMI

Mimo braku konkretnych danych klinicznych, niektóre leki, takie jak Tacrolimus, które wykorzystują te same białka wiążące (FKBP), mogą zaburzać skuteczność leku Sirolimus. Sirolimus jest metabolizowany przez CYP3A4. Silne inhibitory CYP3A4 mogą powodować większą ekspozycję na Sirolimus, zwłaszcza w przypadku kilku implantów. Należy także wziąć pod uwagę możliwość ogólnoustrojowej ekspozycji na Sirolimus, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie ogólnoustrojowe leki immunosupresyjne.

13. BADANIA KLINICZNE NITIDES

W kluczowym badaniu klinicznym przed wypuszczeniem na rynek, ILLUMINA, potwierdzono podstawowe bezpieczeństwo i skuteczność stentu NiTiDES. Przebieg badania: W wielośrodowiskowym badaniu prowadzonym w jednej grupie, stent NiTiDES wszczepiono 100 pacjentom z objawową miażdżycową niedrożnością tętnicy udowej i podkolanoowej o maksymalnej długości zmiany 14 cm. Po 12 miesiącach porównano podstawową skuteczność (drożność) oraz kryterium oceny skuteczności (składowa znaczących zdarzeń niepożądanych: amputacji leczonej kończyny, niedokrwienia leczonej kończyny wymagające interwencji chirurgicznej lub chirurgicznej naprawy leczonego naczynia albo reewaskularyzacji leczonej zmiany, pogorszenie na skali Rutherforda o 2 klasy, albo do klasy 5 lub 6) z obiektywnym celu zabiegu.

Wyniki: Sukces zabiegowy osiągnięty w 100%.

Badanie ultrasonograficzne Dopplera wykazało drożność podstawową rzędu 87% (77/89, 95% zakres pewności 80–94), co spełnia obiektywny cel zabiegu (73%). Drożność podstawowa po 24 miesiącach wyniosła 81% (63/78).

Po 12 miesiącach kryterium oceny skuteczności wyniosło 96,8% (90/93) co spełnia obiektywny cel zabiegu (19,6%). 2,2% (2/93) pacjentów poddano wymaganej klinicznie reewaskularyzacji leczonej zmiany, 1,1% (1/93) zmarno, 0 poddano amputacji leczonej zmiany, 0 miało niedokrwienie leczonej kończyny wymagające interwencji chirurgicznej lub chirurgicznej naprawy leczonego naczynia i u 0 wystąpiło pogorszenie na skali Rutherforda o dwie klasy, albo do klasy 5 lub 6. Po 24 miesiącach kryterium oceny skuteczności wyniosło 87,8% (79/90). 6,7% (6/90) pacjentów poddano wymaganej klinicznie reewaskularyzacji leczonej zmiany, 3,3% (3/90) zmarno, 0 poddano amputacji leczonej zmiany, 1,1% (1/90) miało niedokrwienie leczonej kończyny wymagające interwencji chirurgicznej lub chirurgicznej naprawy leczonego naczynia i u 1,1% (1/90) wystąpiło pogorszenie na skali Rutherforda o dwie klasy, albo do klasy 5 lub 6.

14. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wybór urządzenia

Zmierzyć długość zmiany docelowej w celu ustalenia długości wymaganego stentu. Aby właściwie zaopatrzyć zmianę, długość rozprężonego stentu powinna przekraczać długość zmiany o co najmniej 5 mm w każdą stronę.

Należy zmierzyć średnicę naczynia proksymalnie i dystalnie od zmiany w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru stentu. Aby zapewnić bezpieczne umieszczenie stentu, do wyboru odpowiedniego rozmiaru stentu użyć większej średnicy. Podczas dobierania modelu należy się odnosić do informacji przedstawionej w tabeli 1.

Przygotowanie urządzenia

Przed założeniem stentu należy podać pacjentowi heparynę i sprawdzić, czy jego aktywowany czas krzepnięcia (ACT) jest zgodny z przyjętym w ośrodku.

W trakcie przygotowywania systemu należy zachować szczególną ostrożność, aby zabezpieczyć stent przed kontaktem z cieciami.

- Otworzyć pudelko i wyjąć torbkę zawierającą sterile opakowanie.
- Po sprawdzeniu, czy opakowanie nie jest uszkodzone, otworzyć zewnętrzną niejalową torbkę z folii aluminiowej, a następnie z torbki wewnętrznej wyjąć zawartość. (Uwaga: Torbka z folii aluminiowej i zewnętrzna powierzchnia wewnętrznej torbki foliowej **NIE SA STERYLNE**. STERYLNA jest tylko zewnętrzna torbka plastikowa).
- Ostrożnie umieścić wspólnik na płaskiej powierzchni w środowisku jałowym, rozpięta taśmą wokół uchwytu i zdjąć cewnik z cewki ochronnej.
- Upewnić się, że cewnik wprowadzający nie ma zagięć, załamania ani innych uszkodzeń. Uszkodzenie urządzenia mogą pogorszyć jego funkcje.
- Napełnić strzykawkę 3 ml roztworem fizjologicznym zawierającym heparynę, podłączyć do złącza typu Luer do przepłykiwania (rys. 1, pkt 12) i zastosować ciśnienie dodatkowe. Kontynuować przepłykiwanie do momentu, kiedy roztwór fizjologiczny zacznie wypływać z części dystalnej cewnika.
- Oceneć dystalny koniec cewnika, upewniając się, że stent (rys. 1, pkt 4) jest całkowicie pokryty osłoną zewnętrzną.

Nie używać stentu, jeżeli jest częściowo rozprężony lub uszkodzony.

Zgodność z akcesoriami

Z urządzeniem NiTiDES można stosować osłony introduktora o średnicy 6F (2,0 mm) lub większej.

Z urządzeniem NiTiDES można stosować prowadniki o średnicy 0,035 cala (0,89 mm) lub większej. Sztynośń i konfiguracja końcówek prowadnika jest dobrana przez lekarza na podstawie doświadczenia klinicznego.

W razie potrzeby użycia cewnika wprowadzającego, systemy są zgodne z cewnikami wprowadzającymi o średnicy 8 F (2,7 mm) lub większej. W takim przypadku przed wprowadzeniem wybranego narzędzia należy się upewnić, że zawór hemostatyczny jest całkowicie otwarty.

Wprowadzanie stentu

- Sprawdzić, czy kluczyk zabezpieczający (rys. 1, pkt 10) na uchwycie jest w pozycji zablokowanej (detal B).
 - Należy przemyć odsłoniętą część prowadnika roztworem fizjologicznym zawierającym heparynę w celu usunięcia ślądów krwi i środka kontrastowego.
 - Wprowadzić system z pomocą prowadnika do momentu osiągnięcia przez stent miejsca docelowego.
- W przypadku nietypowego oporu nie używać siły: wyciągać jednocześnie introdutor, prowadnik i urządzenie, jako jedną całość. Używanie nadmiernej siły i/lub nieprawidłowe posługiwanie się narzędziem może spowodować przypadkowe umieszczenie stentu w naczyniu lub uszkodzenie cewnika.

Przesuwanie urządzenia

- a) Wprowadzić system do momentu umieszczenia stentu za zmianą.
- b) Wycofać system do momentu wyrownania stentu ze zmianą.
- c) Sprawdzić, czy część systemu wprowadzającego znajdująca się poza cialem pacjenta jest rozwinięta i prosta.

Przestroga: Jeżeli system wprowadzający nie jest odpowiednio rozwinięty, stent może zostać umieszczony poza zmianą docelową.

Umieszczenie i rozprężenie stentu

- a) Mocno chwytając uchwyt jedną ręką, sprawdzić czy radiocieniujące znaczniki na stencie są położone proksymalnie i dystalnie do zmiany.
- b) Upewnić się, że osłonka introduktora nie przesuwa się podczas umieszczenia stentu.
- c) Przekręcić kluczek zabezpieczający na uchwycie w lewo (rys. 1, detal B), aby odblokować (KROK 1), a następnie wyciągnąć do końca (KROK 2).
- d) Trzymając uchwyt w stałej pozycji względem pacjenta, sprawdzić ponownie, czy radiocieniujące znaczniki są położone odpowiednio względem zmiany; rozpoczęć rozprężenie stentu — w tym celu obracać kółko (rys. 1 poz. 9) kciukiem w kierunku strzałki, tak jak pokazano na ilustracji 1.
- e) Pod kontrolą fluoroskopową, gdy dystalny koniec stentu jest dobrze umocowany do ścianek naczynia, kontynuować wsuwanie stentu, obracając kółko do momentu otwarcia końcowki stentu i jego całkowitego wszczepienia w ścianki naczynia.
- f) Jeśli potrzebne jest szybkie wsunięcie, postępować w następujący sposób: sprawdzić, czy nie ma żadnych przeszkód (np. wkrccone gniazdo typu Luer) w tylnej końcowce uchwytu, uchwycić tuły koniec urządzenia (odciagnik, rys. 1 poz. 11) drugą ręką i pociągnąć go, trzymając przednią część uchwytu całkowicie nieruchomo względem pacjenta, tak jak pokazano na ilustracji 1.
- g) Sprawdzić fluoroskopowo, czy stent jest całkowicie rozprężony.
- h) W razie potrzeby stent można rozprężyć bardziej za pomocą cewnika balonowego do zabiegów PTA. Dobierając średnicę cewnika balonowego i wykonując dalsze rozprężanie, należy odnieść się do średnicy naczynia oszacowanej za pomocą angiografii. Należy zawsze zwrać szczególną uwagę, aby nie rozpręzać stentu ponad średnicę nominalną określoną na etykietce.
- i) Końcowa średnica stentu musi być zgodna ze średnicą referencyjną naczynia.

15. MOŻLIWE ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE

Możliwe zdarzenia niepożądane związane z implantacją stentu obwodowego obejmują zagrożenia wynikające z przeskórnej śródnczynowej angioplastyki oraz dodatkowe zagrożenia związane ze stosowaniem stentu, podane poniżej.

- infekcja w miejscu dostępu, ból i krwiak,
- reakcja alergiczna lub niepożądana na środek kontrastowy, leki stosowane podczas zabiegu lub materiały, z których wykonany jest stent,
- skurcz tętnicy,
- zakrzepica tętnicy lub stentu,
- tętniak lub tętniak rzekomy tętnicy udowej,
- miażdżycowy zator dystalny,
- krwawienie,
- zgon,
- przecięcie, perforacja lub rozerwanie naczynia ze stentem,
- zator,
- niedowolność nerek,
- niedokrwienie kończyn dolnych (wymagające zabiegu chirurgicznego),
- restenoza tętnicy, do której implantowano stent,
- zator w stencie,
- zatkanie naczynia lub nieusunięte zwężenie.

16. ODPowiedzialność i Gwarancja

Producent gwarantuje, że urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i zapakowane z dbałością i użyciem najbardziej odpowiednich, aktualnie dostępnych, technik oraz z zastosowaniem zasad włączenia bezpieczeństwa w fazie projektowania i konstrukcji, aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie w określonych warunkach oraz zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem środków ostrożności wymienionych w poprzednich ustępach, a także ograniczyć do minimum (choć nie wyeliminować) ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia.

Urządzenie można stosować wyłącznie na odpowiedzialność specjalistycznego personelu medycznego, z uwzględnieniem ryzyka szczątkowego, możliwych działań niepożądanych i powikłań leczenia, do którego zostało przeznaczone, w tym wymienionych w innych częściach tej instrukcji.

Złożoność techniczna oraz krytyczny charakter decyzji medycznych i metod aplikacji urządzenia wykluczają jakąkolwiek, wyrządzoną wprost lub dorozumianą, gwarancję producenta w odniesieniu do osiągnięcia skutku działania urządzenia, jego skuteczności w leczeniu niepełnosprawności albo innej patologii lub problemu medycznego. Z klinicznego punktu widzenia, jeśli chodzi o funkcjonalność i czas używania urządzenia, skutki zależą od wielu czynników, na które producent nie ma wpływu, w tym, między innymi: stanu pacjenta, zabiegu implantacji lub sposobu użycia, metody postępowania z urządzeniem po otwarciu opakowania.

W świetle tego odpowiedzialność producenta ogranicza się jedynie do sytuacji, w których można zapewnić, że w chwili wprowadzenia urządzenia do obiegu posiadało wady. W tym celu klient musi niezwłocznie przekazać urządzenie do dyspozycji producenta, zgodnie z warunkami ważności i przepisami prawa. Producent zastrzega sobie prawo do sprawdzenia urządzenia, które potencjalnie jest wadliwe i ustalone, czy faktycznie posiada wady naruszające jego bezpieczeństwo. Odpowiedzialność producenta jest wykluczona, jeśli (i) wada, której dotyczy roszczenie, wynika z konieczności zapewnienia zgodności urządzenia z obowiązkiem prawnym lub wiążącym postanowieniem i/lub (ii) wada spowodowana jest uszkodzeniem, które nie występowało w chwili wypuszczenia urządzenia na rynek przez producenta i/lub (iii) jeśli stan wiedzy technicznej i naukowej w chwili wprowadzenia urządzenia do obrotu przez producenta nie zezwalał na uznanie urządzenia za wadliwe i/lub (iv) w każdym przypadku innym niż opisane powyżej, w którym prawo zdecydowanie wyklucza lub ogranicza

odpowiedzialność producenta za uszkodzenia wadliwych produktów. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwego narzędzia na inne o takim samym lub zamiennym typie wyprodukowane przez producenta.

Gwarancja będzie honorowana wyłącznie w przypadku zwrotu prawidłowo zapakowanego urządzenia producentowi wraz ze szczegółowym pisemnym raportem dotyczącym stwierdzanych wad, a w przypadku urządzenia implantowanego, z uzasadnieniem usunięcia go z ciała pacjenta. Wady, których dotyczy roszczenie, należy niezwłocznie zgłosić producentowi zgodnie z warunkami konfiskaty i przepisami prawa.

Po dokonaniu wymiany producent wróci klientowi poniesione przez niego koszty związane ze zwrotem urządzenia uznanego za wadliwe.

Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania metod stosowania i środków ostrożności wymienionych w instrukcji oraz w przypadku stosowania po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Ponadto producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z konsekwencjami dokonanego wyboru sposobu leczenia oraz metod zastosowania urządzenia i nie będzie w żadnych okolicznościach odpowiadać za jakiekolwiek szkody dowolnej natury, materialnej, biologicznej lub moralnej, wynikające z zastosowania urządzenia lub techniki implantacji wybranej przez użytkownika.

Przedstawiciele producenta nie są upoważnieni do zmiany żadnych warunków określonych powyżej, ani do proponowania dodatkowych warunków lub gwarancji związanych z niniejszym produktem poza opisanymi powyżej. W sprawach dotyczących niniejszej gwarancji obowiązuje prawo włoskie, chyba, że producent zezwoli na wprowadzenie produktu do obrotu w krajach innych niż Włochy – wówczas obowiązują przepisy wymagane prawem innych krajów.

БЪЛГАРСКИ

NiTIDES

Саморазгъваща се периферна стентова система с покритие
„Carbofilm™, отделяща Amphilimus™ (сиоролимус + мастна киселина)

1. ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Семейството на изделия NiTiDES се състои от саморазгъващ се стент и система за доставяне за правилно разполагане и разгъване на стента.

Стентът представлява гълка, саморазгъващ се, имплантируемо изделие. То е изработено от сплав на никел и титан (нитинол) и е покрито с „Carbofilm™“ тънък въглероден слой с турбостатична структура с висока плътност, която по същество е идентична с тази на пиролитичния въглерод. Покриването на субстрата му осигурява биосъвместимите и хемосъвместимите характеристики на пиролитичния въглерод, без да влияе върху физичните и структурните свойства на самия субстрат.

Върху стента са поставени шест рентгеноконтрастни маркери от тантал (по три на всеки край), за да позволяват правилното разполагане в мястото на прицелната лезия.

По външната повърхност на стента има специални вдлъбнатини, покрити изцяло с „Carbofilm™“, които имат за цел да съдържат на лекарствената форма Amphilimus™, съставена от лекарството сиоролимус и смес от дълговерики mastни киселини.

Специфичната лекарствена дозировка за лекуваната съдова повърхност е приблизително 0,9 µg/mm², което съответства на минимална доза 270 µg за по-малкия стент (6,0x20 mm) и максимална доза 2420 µg за по-големия стент (8,0x150 mm).

Използваната система за доставяне е от тип „over-the-wire“ и гарантира, че стентът може да бъде разположен и разгънат безопасно в лезията. Тя е показана схематично на Фигура 1 и се състои от:

- тяло на катетъра (7) с диаметър 6F, състоящо се от:
 - изтеглящо се външно дезиле, дистален полуопръжен участък (3), в който се съдържа стентът (4); дезилето има рентгеноконтрастна яичка (13) в близост до върха на катетъра;
 - вътрешен лумен, състоящ се от спирала (6) и вътрешна тръбичка (2), съвместима с 0,035 inchов водач; вътрешният лумен се простира до дължината на катетъра, като започва от луверов фитинг (12), закрепен проксимално към дръжката, и свързва дистално на върха (1) с рентгеноконтрастен материал, така че да улесни разполагането и поставянето на стента, когато бъде наблюдаван чрез система за образно изследване. Интегриран във вътрешния лумен стонер (5) предотвратява аксиално разместяване на стента по време на изтегляне на външното дезиле;
 - дръжка (8) със система за доставяне, която позволява позиционирането на катетъра и поставянето на стента *in situ*.

Дръжката има ергономичен дизайн, който позволява операторът да я хване и използва дори с една ръка. Има луер порт (12) на проксималния край, който се използва за промиване на лумена на водача, обезопасявайки ключ (10), колело-бутона за управление (9) и пристосъбиение за издръжване (11). Производителят произвежда директно периферния стент + катетърната система за разгъване и прилага всички процедури за контрол на качеството както по време на производство, така и по отношение на готовите продукти, в съответствие с правилата за добра производствена практика.

2. ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА НА ИЗДЕЛИЕТО

Периферната саморазгъваща се стентова система е предвидена за лечение на периферна артериална болест, засягаща повърхноста бедрена артерия и проксимална поплитеална артерия.

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Изделието е показано за лечение на стеноза на феморопоплитеалните артерии над коляното при възрастни симптоматични пациенти (категория 2-5 по Rutherford). Лекуваната лезия с максимална дължина 14 сантиметра трябва да бъде или окулдирана, или със стеноза над 50%, нововъзникнала или рестенотична, непекувана преди това със стент.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на стента е противопоказана в следните ситуации:

- Лезии, считани за нелечими с PTA процедура или други интервенционални техники.
- Бременни жени, кърмачки.
- Лезии, локализирани в двете дистални третини на поплитеалната артерия или в колянната става.
- Клинични състояния, възпрепятстващи употребата на антиагрегантна и/или антикоагулантна терапия.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Употребата на изделието не се препоръчва при пациенти с известна свръхчувствителност или алергии към сиоролимус и мастни киселини (като стеаринова киселина, палимитинова киселина и бехенова киселина) или към металните компоненти на стента (като никел, титан и тантал).
- Изделието е предназначено само за еднократна употреба. Да не се допуска повторно използване, обработване и стерилизация. Това може да причини рискове от замърсяване на изделието и/или инфекции на пациента, възпаление и пренасяне на инфекционни болести от пациент към пациент.
- Изделието е предназначено да функционира като система. Не използвайте компонентите му поотделно.
- Не използвайте изделието, ако опаковката му е била отворена или повредена, ако е било неправилно съхранявано, или ако срока му на годност е истекъл. В такива случаи стерилността на продукта не е гарантирана.

- Изделието трябва да се използва единствено от лекари, специално обучени да извършват перкутанса транслуминална ангиопластика (PTA) и имплантация на периферни стентове.
- Ако са срещнати съпротивления в кийто и да било етап на процедурата, не прилагайте натиск върху системата: изтеглете системата на стента и целия катетър за доставяне, водача и интродюсера като едно цяло. Прилагането на прекомерна сила и/или неправилното боравене могат да доведат до разгъване на стента по невнимание или до повреда на катетъра за поставяне.
- Във всеки момент от операцията неправилното боравене би могло да причини дисекция, перфорация или разкъсване на кръвоносния съд.
- Не придвижвайте напред и не изтегляйте системата на стента по време на разгъване: това може да доведе до сериозно увреждане на стентите на съда.
- Имплантирането на саморазгъващ се периферен стент може да причини дисекция на съда, дистално и/или проксимално от стента, и също така може да причини остра блокиране на кръвоносния съд, налагашо допълнителна операция (хирургична намеса за подмяна на кръвоносния съд, допълнителна дилатация, разгъване на допълнителни стентове или други процедури).
- След като стентът веднъж е бил разгънат частично, той не може да се върне в същото състояние чрез системата за доставяне.

6. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Никога не използвайте системата за бързо освобождаване при започване на разширяването на стента. Използвайте я само ако е необходимо, след като сте освободили поне половината от дължината на стента.
- С изделието трябва да се борави внимателно, така че да се избегне всяка контакт с метални или абразивни инструменти, които биха могли да доведат до повреждане или да причинят механични изменения.
- Изделието не трябва да влиза в контакт с течности преди подготовката и позиционирането му.
- Системата за поставяне на изделието не е предназначена за употреба с инжектори за контрастно вещество.
- Когато стентовете се имплантират tandemно, съответните рентгеноконтрастни маркери трябва да се приложат. Приложението не трябва да обхваща повече от два стента.
- В случай на приложението се стентове се препоръчва дължина на приложението, по-малка от 20 mm.
- За да не повредите стента, работете с изключително внимание всеки път, когато прекарвате водач или балонен катетър или друго изделие през стента, който е бил разгънат.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В СРЕДА НА ЯМР

Неклиничните тестове показват, че продуктовите линии за нитинолови стентове на производителя са определени като МР условно безопасни. Пациент с това изделие може безопасно да бъде сканиран в ЯМР система при следните условия:

- Статично магнитно поле от 1,5-Tesla (1,5T) или 3-Tesla (3T)
- Максимален пространствен градиент на магнитното поле 6,140 G/cm (61,40 T/m)
- Максимална отчетена от системата за МР усреднена целотелесна специфична степен на абсорбция от:
 - 1 W/kg (нормален режим на работа) при 1,5T
 - 1 W/kg (нормален режим на работа) при 3T

Радиочестотно затопляне

При определените условия на сканиране продуктовите линии за нитинолови стентове се предвижда за предизвика максимално повишаване на температурата с по-малко от 6,8°C след 15-минути непрекъснато сканиране при посочената система за МР усреднена целотелесна специфична степен на абсорбция (SAR) от 1,0 W/kg.

Конфигурация на единичен стент

Най-висока промяна в температурата

Конфигурация на приложението се стентове

Най-висока промяна в температурата

1,5 T 3 T

≤ 6,3 °C ≤ 6,2 °C

≤ 6,8 °C ≤ 6,3 °C

Артефакти в ЯМР изображенията

При неклиничните изпитвания артефактът на изображението, причинен от изделието, се простира на около 0,7 см от нитиноловите стентове на производителя при изобразяване с импулси последователности с градиентно ехо и спин ехо при 3T ЯМР система.

8. КАК СЕ ДОСТАВЯ

Изделието NiTiDES се доставя стерилно (стерилизирано със смес от етилен оксид и CO₂), за еднократна употреба и опаковано индивидуално в две торбички, които не трябва да се внесат в стерилна среда. **ЗАБЕЛЕЖКА: вътрешната торбичка от фолио е единствената стерилна барiera.** Стерилността и химическата стабилност са гарантирани, докато опаковката остане цела и до краяния срок на годност, отпечатан върху опаковката (СРОК НА ГОДНОСТ).

Съдъръжение: една (1)-саморазгъщаща се периферна стентова система с покритие „Carbofilm™“, отделяща Amphilimus™ (сиоролимус + мастна киселина)

9. СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява, както е посочено на опаковката, на хладно и сухо място, при температура на съхранение максимум 25°C.

10. МОДЕЛИ

Изделието NiTiDES може да се идентифицира чрез код на модел и партиден номер; наличните продуктови кодове са изброени в Таблица 1.

11.ЛЕКАРСТВЕН РЕЖИМ

Проучванията в клиничната литература показват необходимостта от прилагане на антиагрегантна терапия предоперативно, антикоагулантна терапия по време на процедурата и следоперативна антиагрегантна терапия. Антитромбоцитната терапия през периода след процедурата включва прилагането на:

- Тиенопиридини (тиколипидин или клопидогрел или пазутрел в дозите, показани в съответните листовки с указания, или в съответствие с медицинското предписание)
- Аспирин в минимална доза 100 mg/дневно за неопределен период от време

Вземайки под внимание сложността на процедурата и многото фактори, влияещи върху състоянието на пациента, определянето на подходящата терапия е оставено на преценката на лекаря.

12.ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛЕКАРСТВА

Въпреки че лиспват налични конкретни клинични данни, някои лекарства, като таクロнимус, които действа чрез съзия свързващ протеин (ФКБР), могат да повлият на ефикасността на сиролимус. Сиролимус се метаболизира от изoenзима CYP3A4. Силните инхибитори на CYP3A4 могат да повишат експозицията на сиролимус, особено в случаи на множество импланти. Системната експозиция на сиролимус, ако пациентът едновременно с това е на система имуносупресивна терапия, също трябва да бъде взета под внимание.

13.КЛИНИЧНИ ИЗПITVANIA С NITIDES

Основната безопасност и ефективност на стента NiTiDES са установени от ключовото клинично изпитване ILLUMINA, проведено преди пускането му на пазара.

План на изследването: В рамките на многоцентрово проучване с едно рамо 100 пациенти със симптоматично феморополелито заболяване с максимална дължина на лезията 14 см са лекувани със стента NiTiDES. Първичната ефикасност (първична проходимост) и първичната краина точка за безопасност (съвкупност от големи нежелани събития: смърт, ампутация на целиевия крайник, исхемия на целиевия крайник, налагаща хирургична интервенция или хирургично възстановяване на целиевия съд или клинично обусловена реваскуларизация на целиевата лезия, влошаване на оценката по Rutherford с 2 класа или до клас 5 или 6) са сравняни с обективната цел за ефективност (OPG) за 12 месеца.

Резултати: Успех на процедурата, постигнат на 100%.

Резултатите от доплеров ултразвук показват първична проходимост от 87% (77/89, 95% доверителен интервал 80-94), което отговаря на изискванията на OPG (73%). Първичната проходимост след 24 месеца е била 81% (63/78). Първичната краина точка за безопасност след 12 месеца е била 96,8% (90/93), което отговаря на изискванията на OPG (19,6%), 2,2% (2/93) от пациентите са имали клинично обусловена реваскуларизация на таргетната лезия, 1,1% (1/93) са починали, 0 са имали ампутация на таргетния крайник, 0 са имали исхемия на таргетния крайник, налагаща хирургична интервенция или хирургично възстановяване на целиевия съд и 0 са имали влошаване на резултата по Rutherford с два класа или клас 5 и 6.

Първичната краина точка за безопасност след 24 месеца е била 87,8% (79/90). 6,7% (6/90) от пациентите са имали клинично обусловена реваскуларизация на таргетната лезия, 3,3% (3/90) са починали, 0 са имали ампутация на таргетния крайник, 1,1% (1/90) са имали исхемия на таргетния крайник, налагаща хирургична интервенция или хирургично възстановяване на целиевия съд и 1,1% (1/90) са имали влошаване на резултата по Rutherford с два класа или клас 5 и 6.

14.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Избор на изделието

Използвайте като отправна точка дължината на прицелната лезия, за да установите дължината на необходимия стент. За да се покрие правилно лезията, дължината на разположения стент трябва да бъде поне с 5 mm по-голяма от самата лезия от двете страни.

Използвайте като отправна точка диаметъра на кръвоносния съд проксимално и дистално от лезията, за да установите подходящ размер стент. За да гарантирате сигурно поставяне на стента, използвайте по-големия диаметър като основа за избор на подходящ размер на стента. Когато избирате модел, вижте информацията, дадена в таблица 1.

Подготовка на изделието

Преди доставяне на стента, приложете хепарин и проверете дали активираното време на съсирване (ACT) на пациента е достатъчно в съответствие с практиката на клиничното заведение.

По време на подготовката на системата, обрънете специално внимание на не допускат никаква течност да има контакт със стента.

- a) Отворете кутията и изведете торбичката, съдържаща стерилния плик.
- b) След като прегледате опаковката за евентуални повреди, отворете външната нестерилина торбичка от алуминиево фолио, след което изведете съдържанието от вътрешната торбичка. (Забележка: Торбичката от алуминиево фолио и външната повърхност на вътрешната найлоновата торбичка **НЕ СА СТЕРИЛНИ**. Само съдържанието на найлоновата торбичка е СТЕРИЛНО).
- c) Като внимавате да поставите опората на равна повърхност в стерилна среда, освободете лентата около дръжката и изведете катетъра от предпазната спирала.
- d) Проверете дали по катетъра за доставяне няма видими чупки, гънки или други увреждания. Повреда на изделието може да влоши неговото функциониране.
- e) Напълнете една спринцовка от 3 ml с физиологичен разтвор, съдържащ хепарин, свържете я към луеровия фитинг за промиване (фигура 1, предмет 12) и приложете положително налягане. Продължете да промивате докато физиологичният разтвор изтече от дисталния край на катетъра.

- f) Проверете дисталния край на катетъра, като се уверите, че стентът (фигура 1, указание 4) е изцяло покрит от външното дезиле. Не използвайте изделието, ако е повредено или ако стентът е частично разгънат.

Съвместимост с допълнителни принадлежности

Въвеждащите дезилета с диаметър 6 F (2,0 mm) или по-голям, могат да се използват с изделието NiTiDES. 0,035 (0,89 mm) инчовите водачи или по-малки, могат да се използват с изделията NiTiDES. Изброят на твърдостта на водача и конфигурацията на върха ще зависят от клиничния опит на лекаря.

Ако се наложи употребата на водещ катетър, системите са съвместими с водещи катетри с диаметър 8F (2,7 mm) или по-голям. В този случай се уверете, че хемостатичната клапа е напълно отворена преди въвеждане на избраната конфигурация.

Въвеждане на стента

- a) Уверете се, че безопасяващият ключ (фигура 1, указание 10) на дръжката е в заключено положение (детайл B).
- b) Промийте оголената част на теления водач с физиологичен разтвор, съдържащ хепарин, за да отстраните следите от кръв и контрастно вещество.
- c) Придвижвайте напред системата над водача, докато стентът достигне мястото, което трябва да се третира.

Ако се срещне необичайно съпротивление в който и да било момент, не прилагайте натиск върху системата: изтеглете интродюсера, водача и изделието заедно като едно цяло. Прилагането на прекомерна сила и/или неправилното боравене могат да доведат до разгъване на стента по невнимание или до повреда на катетъра за поставяне.

Придвижване на изделието

- a) Придвижете системата до точката, в която стентът е отвъд лезията.
- b) Изтеглете системата назад докато стентът застане на една линия с лезията.
- c) Проверете дали частта от системата за доставяне, която е извън тялото на пациента, е свободно разгънато и изправено.

Внимание: Ако системата за доставяне не е разгъната правилно, стентът може да се разгъне отвъд прицелната лезия.

Имплантиране и разширяване на стента

- a) Като хванате здраво дръжката с една ръка, проверете дали рентгеноконтрастните маркери на стента са разположени проксимално и дистално по отношение на лезията.
- b) Уверете се, че въвеждащото дезиле не се движи по време на разгъването на стента.
- c) Завъртете обезопасяващия ключ на дръжката по посока обратна на часовниковата стрелка (фигура 1, детайл B), за да го отключите (СТЪПКА 1), а след това го издърпайте напълно (СТЪПКА 2).
- d) Като държите дръжката в неподвижно положение спрямо пациента, проверете още веднъж дали рентгеноконтрастните маркери са в желаното положение спрямо лезията; започнете разгъване на стента като завъртите колело-бутона (фигура 1, указание 9) с палец си по посока на стрелката, както е показано на фигура 1.
- e) Под флуороскопско наблюдение, когато дисталният край на стента е добре прикрепен към стентите на съда, продължете разгъщането, като въртите колело-бутона, докато краят на стента бъде отворен и той бъде напълно имплантиран в стените на съда.
- f) Ако е необходимо бързо разгъщане, процедурайте по следния начин: уверете се, че няма запушвания (напр. завита женска луерова слюбка) в задния край на дръжката, хванете задния край на изделието (издърпване, фигура 1, указание 11) с другата си ръка и го издърпайте, като държите предната част на дръжката спрямо пациента абсолютно неподвижна, както е показано на фигура 1.
- g) Проверете с помощта на флуороскопия дали стентът се е разгънал напълно.
- h) Стентът може да се разшири още повече, ако е необходимо, като се използва балонен катетър за РТА процедура. При избора на диаметър на балонния катетър и при извършване на последващото разширяване, моля, вижте за справка диаметъра на кръвоносния съд, който е бил установлен чрез ангиография. Във всеки случай, обрънете особено внимание да не разширите стента над неговия номинарен диаметър, посочен върху етикетата.
- i) Окончателният диаметър на стента трябва да бъде подходящ за диаметъра на референтния съд.

15.ПОТЕНЦИАЛНИ НЕЖЕЛАНИ СЪБИТИЯ

Възможните нежелани събития, които могат да бъдат свързани с имплантирането на периферен стент, включват рискове, свързани с перкутанна транслуминална ангиопластика и допълнителни рискове, свързани с употребата на стентове, както е показано по-долу.

- Инфекция, болка и хематом на мястото на достъп
- Алергична или нежелана реакция към контрастно вещество, към лекарства, използвани по време на процедурата или към материали, съставящи стента
- Артериален спазъм
- Артериална или стент тромбоза
- Аневризма или псевдоаневризма на бедрена артерия
- Атеросклеротична дистална емболизация
- Кървене
- Смърт
- Дисекция, перфорация или разкъсване на стентирания кръвоносен съд
- Емболия
- Бъбречна недостатъчност

- Ишемия на долн крайник (изискваща хирургична интервенция)
- Повторна стеноза на артерията, в която е бил имплантиран стентът
- Емболизация на стента
- Оклузия на съд или неразрешена стеноза

16.ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИЯ

Производителят уверява, че изделието е проектирано, произведено и опаковано с най-голяма грижа, като са използвани техниките, които се считат за най-подходящи сред наличните при сегашното състояние на технологиите и като са прилагани интегрирани стандарти за безопасност при проектирането и конструирането, за да се осигури безопасна употреба, когато то се използва при условията и за предвидените цели, като се спазват предизвестните мерки, посочени в предходните параграфи, и във всеки случай с цел да се намалят, доколкото е възможно, но не и да се елиминират напълно рисковете, свързани с употребата на изделието.

Изделието трябва да се използва само под отговорността на специализиран медицински персонал и като се вземат предвид останните рискове и възможните странични ефекти и усложнения на терапията, за която е предназначено, включително тези, посочени в другите раздели на тази книжка с инструкции.

Техническата сложност и критичният характер на медицинския избор и методите на приложение на изделието изключват всяка гаранция от страна на производителя, изрична или косвена, за ефективността на резултата след използването на изделието или за неговата ефективност при разрешаването на състояние на инвалидност или каквато и да е друга патология или медицински проблем. Всъщност резултатите, както от клинична гледна точка, така и по отношение на функционалността и полезния живот на изделието, зависят от многообразни фактори, които са извън контрола на производителя, сред които са посочени само като неизчерпателни примери състоянието на пациента, хирургическата процедура на имплантацията или използване, методите на манипулиране с изделието след отваряне на опаковката.

С оглед на тези фактори отговорността на производителя е налице само ако е установено, че изделието е било засегнато от дефекти към момента на пускането му в обращение. За тази цел Клиентът трябва незабавно да предостави изделието на производителя, като спазва условията за срока на годност и предиспанията, изисквани от закона; производителят си запазва правото да прегледа изделието, считано за дефектно, и да установи дали то действително е засегнато от дефекти, които могат да повлияват на безопасността на продукта. Отговорността на производителя се изключва, ако (i) претендираният дефект се дължи на състоянието на изделието със задължително правила или обвързваща разпоредба, или (ii) дефектът, който е причинил вредата, не е съществувал, когато производителят е пуснал изделието на пазара, и/или (iii) ако състоянието на техническите и научните познания по времето, когато производителят е пуснал изделието на пазара, все още не е позволявало изделието да се счита за дефектно, и/или (iv) във всеки друг случай, различен от посочените по-горе, в който законът изрично изключва или ограничава отговорността на производителя за вреди от дефектни продукти. Гаранцията се състои изключително в замяната на дефектното изделие с друго от същия или еквивалентен тип, произведено от производителя.

Гаранцията ще се прилага само ако изделието бъде върнато на производителя, правилно опаковано, заедно с подробен писмен доклад за претендирани дефекти и, в случаи на имплантации изделия, причините за изваждането му от пациента. Претендирани дефекти трябва да бъдат незабавно съобщени на производителя в съответствие с условията за евентуална загуба на права и законовата давност.

След като бъде извършена замяната, производителят ще възстанови на клиента разходите, направени от него за въръщането на признатото дефектно изделие.

Производителят отхвърля всяка отговорност в случай на неспазване на методите на употреба и предизвестните мерки, посочени в настоящото ръководство за употреба, както и в случаи на употреба след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.

Освен това Производителят не поема отговорност за последиците от медицинския избор и методите на използване или прилагане на изделието и следователно при никакви обстоятелства няма да бъде преследван за материални, биологични или морални щети от каквото и да е вид, произтичащи от прилагането на изделието и от избора на техниката за имплантация, използвана от оператора.

Агентите и представителите на производителя не са упълномощени да променят което и да е от горепосочените условия, нито да поемат допълнителен ангажимент или да дават каквато и да е гаранция във връзка с този продукт, освен както е посочено по-горе. Тази гаранция се урежда от италианското законодателство, освен ако не се прилагат задължителните закони на друга държава, в случаи че производителят е разрешил разпространението на продукта в една или повече държави, различни от Италия.

РУССКИЙ

NITIDES

Система саморасширяющегося периферического стента с покрытием *Carbofilm™*, выделяющая *Amphilimus™* (сиорлимиус + жирную кислоту)

1. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Линейка устройств NITIDES включает саморасширяющийся стент и систему доставки для его правильной установки и раскрытия.

Стент представляет собой гибкий саморасширяющееся вживляемое устройство. Стент изготовлен из никелево-титанового сплава (нитинола) с покрытием *Carbofilm™*, которое представляет собой тонкий слой углерода с турбостратной структурой высокой плотности, по существу идентичной структуре природного углерода.

Покрытие субстрата обеспечивает ему био- и гемосовместимые характеристики природного углерода, не влияя на физические и структурные свойства самого субстрата.

На стент нанесены шесть рентгеноконтрастных tantalевых маркеров (по три с каждого конца), позволяющих правильно разместить его в месте целевого поражения.

Наружная поверхность стента имеет специальные канавки, полностью покрыты с помощью *Carbofilm™*, которые содержат фармацевтический состав *Amphilimus™*, состоящий из препарата сиорлимиус и смеси длинноцепочечных жирных кислот.

Удельная доза препарата для обрабатываемой поверхности сосуда составляет примерно 0,9 мкг/мм², что соответствует минимальной дозе 270 мкг для меньшего стента (6,0 × 20 мм) и максимальной дозе 2 420 мкг для большего стента (8,0 × 150 мм).

Используемая **система доставки** работает по принципу доставки по проводнику, обеспечивая безопасное размещение и высвобождение стента в очаге поражения. Эта система схематически изображена на рис. 1 и состоит из следующих компонентов:

- корпус катетера (7) диаметром 6F, состоящий из
 - втягиваемой внешней канюли, в дистальном попупрозрачном участке (3) которой находится стент (4); канюла оснащена рентгеноконтрастным кольцом (13) в области кончика катетера
 - внутреннего канала, состоящего из катушки (6) и внутренней трубы (2), совместимой с проводником диаметром 0,035 дюйма; внутренний канал проходит вдоль всего катетера от разъема Люзора (12); проксимальный его конец закреплен на рукоятке, а дистальный — на кончике (1) из рентгеноконтрастного материала, что облегчает расположение и размещение стента под контролем системы визуализации.
 - ограничитель (5), встроенный во внутренний канал, предотвращает осевое смещение стента во время втягивания внешней канюли;
 - рукоятки (8) с системой доставки, которая обеспечивает позиционирование катетера и размещение стента в месте установки.

Рукоятка имеет эргономичный дизайн, поэтому хирург может держать ее и работать с ней даже одной рукой. На ее проксимальном конце находится разъем Люзора (12), используемый для промывания просвета проводника, предохранительный ключ (10), колесико (9) и оттягиваемая задняя часть (11). Производитель непосредственно производит периферический стент и систему раскрытия катетера с соблюдением всех процедур контроля качества как в процессе производства, так и для готовой продукции в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice).

2. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Система саморасширяющегося периферического стента предназначена для лечения стеноза бедренно-подколенных сегментов артерий выше колена у взрослых пациентов, имеющих симптомы [категории по Rutherford 2–5]. Поражение, по поводу которого проводится лечение, максимальной длины 14 см, должно иметь либо окклюзию, либо стеноз более 50 %, быть впервые обнаруженным или рестенотическим, без предыдущего лечения стентом.

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для лечения стеноза бедренно-подколенных сегментов артерий выше колена у взрослых пациентов, имеющих симптомы [категории по Rutherford 2–5]. Поражение, по поводу которого проводится лечение, максимальной длины 14 см, должно иметь либо окклюзию, либо стеноз более 50 %, быть впервые обнаруженным или рестенотическим, без предыдущего лечения стентом.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Использование стента противопоказано в следующих случаях:

- при поражениях, которые считаются неизлечимыми с помощью ЧТА или других хирургических методик;
- беременные женщины и женщины, кормящие грудью;
- поражения, локализованные в двух дистальных третях подколенной артерии или в области коленного сустава;
- клинические состояния, препятствующие использованию антиагрегантной и/или антикоагулянтной терапии.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Использование устройства не рекомендуется у пациентов с известной гиперчувствительностью или аллергией на сиорлимиус, жирные кислоты (например, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, бененовая кислота) или металлические компоненты стента (например, никель, титан и тантал).

• Устройство предназначено только для одноразового использования. Запрещается использовать, обрабатывать или стерилизовать его повторно. Это может создать риск контаминации устройства, инфицирования пациента, развития воспаления, а также передачи возбудителей инфекционных заболеваний от пациента к пациенту.

- Устройство предназначено для использования в качестве системы. Не используйте его компоненты отдельно.
- Не используйте устройство, если его упаковка была открыта или повреждена либо, если оно неправильно хранилось или истек срок его годности. В таких случаях стерильность устройства не гарантируется.
- Устройство должно использоваться только врачами, специально обученными для выполнения чрескожной транслюмinalной ангиопластики (ЧТА) и имплантации периферического стента.
- Если в любой момент в течение процедуры введение чувствуется сопротивление, запрещено прикладывать усилия к системе: выведите систему размещения стента, весь катетер доставки, проводниковый катетер и интродьюсер в виде единого блока. Приложение чрезмерных усилий /или/ неверное манипулирование может привести к непреднамеренному расширению стента или вызвать повреждение катетера для размещения.
- В любой момент вмешательства неверное манипулирование может привести к расслоению, перфорации или разрыву сосуда.
- Запрещается продвигать или вытаскивать систему стента во время раскрытия — это может привести к серьезным повреждениям стенок сосудов.
- Имплантация саморасширяющегося периферического стента может вызвать расслоение сосуда дистально либо проксимальнее стента, а также привести к острой закупорке сосуда с необходимостью дополнительного вмешательства (хирургического вмешательства по замене сосуда, дополнительной дилатации, установки дополнительных стентов либо других процедур).
- После частичного расширения стента он не может быть возвращен через систему доставки.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не используйте** систему быстрого высвобождения в начале расширения стента. Использование такой системы **только в случае необходимости** возможно после высвобождения как минимум половины длины стента.
- С устройством необходимо обращаться осторожно, чтобы избежать любого контакта с металлическими или абразивными инструментами, которые могут повредить его или привести к механическим изменениям.
- Устройство не должно вступать в контакт с жидкостями до подготовки и позиционирования.
- Система размещения устройства не предназначена для использования с инъекторами контрастного вещества.
- При установке стентов рядом друг с другом их рентгеноконтрастные маркеры должны перекрываться. Наложение более двух стентов не допускается.
- В случае наложения стентов рекомендуется, чтобы длина этого наложения была менее 20 мм.
- Для предотвращения повреждения стента будьте очень осторожны каждый раз, когда проводите проводник, баллонный катетер или другое устройство через стент, который уже был раскрыт.

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МРТ

Неклиническое тестирование показало, что линейки нитиноловых стентовых изделий производителя позволяют проводить МРТ-томографию при определенных условиях. Пациент с таким устройством может безопасно проходить МРТ-томографию при следующих условиях:

- Статическое магнитное поле 1,5 тесла (1,5 Тл) или 3 тесла (3 Тл).
- Максимальный пространственный градиент магнитного поля 6 140 Гс/см (61,40 Тл/м).
- Усредненный (для всей поверхности тела) удельный коэффициент поглощения, определенный для МРТ-системы (максимум):
 - Вт/кг (обычный режим эксплуатации) при 1,5 Тл.
 - Вт/кг (обычный режим эксплуатации) при 3 Тл.

РЧ-нагрев

При определенных выше условиях сканирования ожидается, что линейки нитиноловых стентовых изделий производителя создадут максимальное повышение температуры менее 6,8 °C после 15 минут непрерывного сканирования в указанной МРТ-системе, при этом усредненный (для всей поверхности тела) удельный коэффициент поглощения составит 1,0 Вт/кг.

1,5 Тл 3 Тл

Конфигурация с одним стентом

Максимальное изменение температуры	$\leq 6,3^{\circ}\text{C}$	$\leq 6,2^{\circ}\text{C}$
------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Конфигурация с наложением стентов

Максимальное изменение температуры	$\leq 6,8^{\circ}\text{C}$	$\leq 6,3^{\circ}\text{C}$
------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Артефакты МРТ

При неклиническом тестировании размер артефакта, обусловленного наличием устройства, примерно на 0,7 см больше размера нитиноловых стентов производителя при сканировании методом последовательности импульсов градиентного эха и спинового эха, с использованием системы МРТ 3 Тл.

8. ФОРМА ПОСТАВКИ

Устройство NiTiDES поставляется в стерильном виде (стерилизуется с помощью смеси этиленоксида и CO₂), предназначается для однократного использования и помещено в два пакета, которые запрещается проносить в стерильную зону. **ПРИМЕЧАНИЕ. Внутренний пакет — единственный стерильный барьер.**

Стерильность и химическая стабильность гарантируется, пока пакет не поврежден, а также до окончания срока годности, указанного на упаковке (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО).

Содержимое: 1 (одна) система саморасширяющегося периферического стента с покрытием «Carbofilm™», выделяющая Amphilimus™ (сиролимус + жирную кислоту).

9. ХРАНЕНИЕ

Изделие следует хранить, как указано на упаковке, в прохладном и сухом месте, при температуре макс. 25 °C.

10. МОДЕЛИ

Каждое устройство NiTiDES идентифицируется по коду модели и номеру партии; предлагаются модели, перечисленные в таблице 1.

11. СХЕМА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА

Исследования в клинической литературе указывают на необходимость назначения антитромбоцитарной терапии до операции, антикоагулянтной терапии во время процедуры и антитромбоцитарного лечения после нее. Антитромбоцитарное лечение в период после процедуры включает в себя назначение:

- тиенопиридина (тиколидина, клопидогrela или прасугреля в дозах, указанных в соответствующих памятках, или по рецепту врача);
- аспирина (минимальная доза — 100 мг/сутки на неопределенный срок). Учитывая сложность процедуры и многочисленные факторы, влияющие на состояние пациента, определение необходимой терапии остается на усмотрение врача.

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕПАРАТАМИ

Несмотря на отсутствие конкретных клинических данных, некоторые препараты, такие как тиакролимус, которые действуют через один и тот же связывающий белок (FKBP), могут повлиять на эффективность сиролимуса. Метаболизм сиролимуса происходит с помощью изофермента CYP3A4. Сильные ингибиторы CYP3A4 могут усиливать воздействие сиролимуса, особенно в случае размещения нескольких имплантов. Если пациент принимает сопутствующие системные иммуносупрессивные препараты, следует также принять во внимание системное воздействие сиролимуса.

13. КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ С NITIDES

Важнейшие данные о безопасности и эффективности стента NITIDES были получены в результате предрегистрационного опорного клинического исследования ILLUMINA.

Дизайн исследования. В ходе многоцентрового исследования в одной группе 100 пациентов с симптоматическими заболеваниями бедренно-подколенных сегментов с поражениями максимальной длины 14 см проходили лечение стентом NiTiDES. Первичные данные об эффективности (первичное раскрытое состояние сосуда) и конечной точке безопасности (совокупность значительных существенных нежелательных явлений, к которым относятся: смерть, ампутация целевой конечности, ишемия целевой конечности с необходимостью хирургического вмешательства или хирургической коррекции целевого сосуда либо клинической реваскуляризации целевого поражения, с ухудшением категории по Rutherford на 2 класса либо до класса 5 или 6) сравнивали с целевым плановым показателем для 12 месяцев.

Результаты. Успех процедуры был достигнут в 100 % случаев.

Результаты допплеросонографии демонстрируют первичное раскрытое состояние сосуда 87 % (77/89, 95 % доверительный интервал 80—94), соответствует требованиям целевого планового показателя (73 %). Первичное раскрытое состояние сосуда через 24 месяца составило 81 % (63/78).

Первичная конечная точка безопасности для 12 месяцев составила 96,8 % (90/93), соответствует требованиям целевого планового показателя (19,6 %). 2,2 % (2/93) пациентов прошли клиническую реваскуляризацию целевого поражения, 1,1 % (1/93) умер, 0 прошли ампутацию целевой конечности, у 0 возникла ишемия целевой конечности, требующая хирургического вмешательства или хирургического восстановления целевого сосуда, и у 0 ухудшилась категория по Rutherford на два класса либо до класса 5 или 6. Конечная точка безопасности для 24 месяцев составила 87,8 % (79/90). 6,7 % (6/90) пациентов прошли клиническую реваскуляризацию целевого поражения, 3,3 % (3/90) умерли, 0 прошли ампутацию целевой конечности, у 1,1 % (1/90) возникла ишемия целевой конечности, требующая хирургического вмешательства или хирургического восстановления целевого сосуда, и у 1,1 % (1/90) ухудшилась категория по Rutherford на два класса либо до класса 5 или 6.

14. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выбор устройства

Учитывайте длину целевого поражения, чтобы определить необходимую длину стента. Чтобы приблизительно покрыть поражение, длина раскрытоого стента должна быть как минимум на 5 мм больше, чем само поражение, с обеих сторон.

Учитывайте диаметр сосуда проксимальнее и дистальнее участка поражения, чтобы определить подходящий размер стента. Чтобы обеспечить безопасное размещение стента, используйте больший диаметр в качестве основного для выбора правильного размера стента. При выборе модели воспользуйтесь информацией в таблице 1.

Подготовка устройства

Перед началом установки стента введите гепарин и проверьте, соответствует ли активированное время свертывания крови (АВСК) пациенту стандартам, принятым в лечебном учреждении.

В процессе подготовки системы проявляйте особую осторожность, чтобы не допустить контакта стента с какой-либо жидкостью.

- А. Откройте коробку и извлеките упаковку, содержащую стерильный пакет.
- Б. Проверив упаковку на отсутствие повреждений, откройте внешний нестерильный пакет из алюминиевой фольги и извлеките содержимое из внутреннего пакета. (Примечание. Пакет из алюминиевой фольги и наружная поверхность внутреннего пластикового пакета **НЕ СТЕРИЛЬНЫ**. СТЕРИЛЬНО только содержимое пластикового пакета.)
- В. Осторожно положите крепление на плоскую поверхность в стерильной зоне, удалите полоску вокруг рукавки и извлеките катетер из защитного колца.

- Г. Убедитесь, что катетер для размещения не имеет перекатий, сгибов или других повреждений. Повреждение устройства может нарушить его рабочие характеристики.
- Д. Заполните шприц на 3 мл физиологическим раствором, содержащим гепарин, подсоедините его к разъему Люзера для промывания. Продолжите промывание, пока физиологический раствор не начнет вытекать из дистального конца катетера.
- Е. Проверьте дистальный конец катетера, убедившись, что стент (рис. 1, поз. 4) полностью закрыт внешней канюлей.

Не используйте устройство, если оно повреждено или если стент частично расширен.

Совместимость с дополнительными принадлежностями

С устройством NiTiDES могут использоваться канюли интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм) и более.

С устройством NiTiDES могут использоваться проводники размером 0,035 дюйма (0,89 мм) или меньше. Выбор жесткости и конфигурации кончика проводника будет зависеть от клинического опыта врача.

При необходимости использовать проводниковый катетер данные наборы совместимы с проводниками катетерами диаметром 8F (2,7 мм) или больше. В этом случае перед введением выбранного устройства необходимо убедиться в том, что гемостатический клапан полностью открыт.

Введение стента

- А. Убедитесь, что предохранительный ключ (рис. 1, поз. 10) рукоятки находится в положении блокировки (деталь В).
- Б. Промоте открытою часть проводника физиологическим раствором, содержащим гепарин, для удаления с нее следов крови и контрастного вещества.
- В. Продвигайте систему по проводнику, пока стент не достигнет участка, подлежащего лечению.

Если в любой момент возникнет необычное сопротивление, не прилагайте к системе усилий: выведите интродьюсер, проводниковый катетер и устройство в виде единого блока. Приложение чрезмерных усилий и/или неверное манипулирование может привести к непреднамеренному расширению стента или вызвать повреждение катетера для размещения.

Продвижение устройства

- А. Продвигайте систему, пока стент не пройдет сквозь пораженный участок.
- Б. Потяните систему назад, чтобы стент находился на уровне пораженного участка.
- В. Убедитесь, что часть системы доставки, находящаяся за пределами тела пациента, развернута и выпрямлена.

Внимание: если система доставки не выпрямлена надлежащим образом, стент может быть развернут дальше участка поражения.

Имплантация и расширение стента

- А. Прочно удерживая рукоятку одной рукой, убедитесь, что рентгеноконтрастные маркеры на стенте расположены проксимально и дистально по отношению к пораженному участку.
- Б. Необходимо обеспечить неподвижность канюли интродьюсера в процессе расширения стента.
- В. Поверните предохранительный ключ на рукоятке против часовой стрелки (рис. 1, деталь В) для разблокировки (ШАГ 1), затем полностью вытяните его (ШАГ 2).
- Г. Удерживая рукоятку в фиксированном положении по отношению к пациенту, еще раз убедитесь, что рентгеноконтрастные маркеры расположены в нужном положении относительно пораженного участка; начните расширение стента, вращая колесико (рис. 1, поз. 9) большим пальцем в направлении, указанном стрелкой, как показано на рисунке 1.
- Д. Под рентгеноскопическим контролем, когда дистальный конец стента будет хорошо прикреплен к стенкам сосуда, продолжайте развертывание стента, вращая колесико до высвобождения конца стента и его полной имплантации в стенки сосуда.
- Е. Если требуется быстрое развертывание стента, действуйте следующим образом: убедитесь в отсутствии препятствий (таких как затянутый фиксатор разъема Люзера) в задней части рукоятки, захватите задний конец устройства (потяните назад, рис. 1, поз. 11) другой рукой и потяните его, удерживая переднюю часть рукоятки неподвижно по отношению к пациенту, как показано на рис. 1.
- Ж. Посредством рентгеноскопии убедитесь в том, что стент полностью расширен.
- И. При необходимости может быть выполнено дополнительное расширение стента с использованием баллонного катетера для ЧТА. При выборе диаметра баллонного катетера и выполнении дополнительного расширения необходимо учитывать диаметр сосуда, определенный с помощью ангиографии. Во всех случаях необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не расширять стент до диаметра выше номинального, указанного на его этикетке.
- К. Окончательный диаметр стента должен соответствовать справочному диаметру сосуда.

15. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ниже перечислены нежелательные явления, которые могут возникнуть при имплантации периферического стента, включая осложнения, связанные с процедурой чрескожной транслюминальной ангиопластики, и дополнительные риски, связанные с использованием стентов.

- Инфекция, боли и гематома в месте доступа.
- Аллергическая или нежелательная реакция (на контрастное вещество, препараты, используемые во время процедуры, или материалы, используемые для изготовления стента).
- Артериальный спазм.

- Артериальный или стентовый тромбоз.
- Аневризма или псевдоаневризма бедренной артерии.
- Атеросклеротическая дистальная эмболия.
- Кровотечение.
- Смерть.
- Расслоение, перфорация или разрыв стентированного сосуда.
- Эмболия.
- Почечная недостаточность.
- Ишемия нижних конечностей (требующая хирургического вмешательства).
- Рестеноз артерии, в которую был имплантирован стент.
- Эмболизация стента.
- Окклюзия сосуда или неустраненный стеноз.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует, что это устройство было разработано, изготовлено и упаковано с максимальной тщательностью и использованием методик, которые считаются наиболее подходящими среди доступных на текущем уровне развития технологий, а также с применением принципов интеграции безопасности в проектировании и изготовлении, что гарантирует его безопасное использование при указанных условиях и в указанных целях при соблюдении мер, описанных в параграфах выше, и в любом случае нацелено на максимальное снижение рисков, связанных с использованием устройства, хотя полностью их исключить невозможно.

Устройство необходимо использовать исключительно под ответственность медработника-специалиста, учитывая все остаточные риски и возможные побочные эффекты и осложнения лечения, для которого оно предназначено, в том числе описанные в других разделах этого буклета-инструкции.

Техническая сложность, критический характер выбора лечения и способы использования устройства исключают какую-либо ответственность производителя, явную или подразумеваемую, за эффективность использования устройства или эффективность устранения с его помощью нарушения функций либо других патологических или медицинских проблем. Фактически результаты как с клинической точки зрения, так и в отношении функциональности и продолжительности применения устройства зависят также от многочисленных факторов, которые не контролируются производителем; в качестве примера можно привести, не ограничиваясь перечисленными, следующие: состояние пациента, хирургическая процедура имплантации или использования, методы обращения с устройством после открытия упаковки.

В свете упомянутых факторов ответственность производителя существует, только если было подтверждено, что на устройство негативно повлияли дефекты во время выпуска. Для этого Заказчик должен оперативно представить устройство в распоряжение Производителя с соблюдением сроков и предписаний законодательства; Производитель сохраняет за собой право на проверку устройства, указанного как неисправное, и выяснение, действительно ли на это устройство негативно повлияли дефекты, которые могли отразиться на безопасности изделия. Ответственность производителя исключается, если: (i) заявленный дефект возник из-за соблюдения необходимого правила или обвязывающего положения, распространяемого на устройство, и/или (ii) дефект, ставший причиной повреждения, не существовал в тот момент, когда устройство было выпущено Производителем, и/или (iii) если технические и научные знания, существовавшие на момент выпуска устройства Производителем, не позволяли считать устройство дефективным, и/или (iv) в любом другом случае, также отличающемся от вышеупомянутых, в котором законодательство явно исключает или ограничивает ответственность Производителя за ущерб, нанесенный дефективными изделиями. Гарантийные обязательства заключаются исключительно в замене дефектного устройства на такое же устройство или его эквивалент; выпускаемый этим же производителем.

Гарантия применяется только в том случае, если устройство правильно возвращено производителю вместе с письменным подробным отчетом о заявленных дефектах, а в случае имплантации устройства — с изложением причин извлечения из пациента. О заявленных дефектах необходимо оперативно сообщать Производителю с соблюдением условий отчуждения и предписаний законодательства.

После замены Производитель обязуется возместить Заказчику расходы, понесенные на возврат устройства, признанного неисправным.

Производитель полностью отказывается от ответственности в любом случае несоблюдения способов использования и мер предосторожности, указанных в данной инструкции, и в случае использования устройства после даты окончания срока действия, указанного на упаковке.

Кроме того, Производитель не берет на себя никакой ответственности в отношении последствий медицинского выбора и способов использования или применения устройства и поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть привлечен к ответственности за любой ущерб любого характера, материальный, биологический или моральный, результате применения устройства и выбора техники имплантации, используемой хирургом.

Агенты и представители Производителя не имеют права вносить изменения в какие-либо вышеупомянутые условия, брать какие-либо другие обязательства или давать иные гарантии на данный продукт, помимо указанных выше. Эта гарантия регулируется законодательством Италии, если не применяются обязательные законы другого государства в тех случаях, когда Производитель уполномочен поставлять изделие в одно или больше других государств, помимо Италии.

简体中文

NiTIDES ·Carbofilm™ 涂层自扩张 Amphilimus™ (西罗莫司+脂肪酸) 洗脱外周支架系统

1. 器械说明

NiTIDES 器械系列由自扩张支架和递送系统组成，用于正确放置和置入。支架是一种柔性自扩张型可植入器械。它由镍钛合金（镍钛诺）制成，并涂有·Carbofilm™ 涂层，这是一种高密度乱层结构的碳薄膜，相当于热解碳薄层。该涂层既能为基体提供热解碳的生物相容和血液相容特性，又不会影响基体本身物理的和结构性质。

支架上共有六个不透射线标记（每端三个），以便将支架正确放置到靶病灶部位。

支架的外表面有完全涂覆·Carbofilm™ 的专用凹槽，用于容纳药物制剂Amphilimus™，该制剂由药物西罗莫司和一种长链脂肪酸混合物组成。

治疗的血管表面的特定药物剂量大约为 0.9 µg/mm²，相当于较小支架 (6.0x20 mm) 的最小剂量 270 µg，较大支架 (8.0x150 mm) 的最大剂量 2420 µg。

本器械所采用的递送系统为整体交换型，可确保支架安全定位并在病灶部位安全释放。其结构如图 1 所示，由以下部分组成：

- 一个直径为 6F 的导管 (7)，包括：

- 一个可伸缩型外鞘，即预装有支架 (4) 的远端半透明部分 (3)；在导管尖端附近，外鞘还具有一个不透射线套环 (13)；
- 一个内腔，由线圈 (6) 和内管 (2) 构成，其中内管兼容直径为 0.035 in 的导丝；内管沿导管延伸，近端为固定在手柄上的 luer 接头 (12)，远端一直延伸到用不透射线材料制成的尖端 (1)，以便医生通过成像系统准确定位和放置支架。挡块 (5) 与内腔连在一起，用于防止支架在外鞘撤回时发生轴向位移；
- 一个带有递送系统的手柄 (8)，用于定位导管并在原位置入支架。

手柄采用人体工学设计，便于手术者抓握和使用，即使是单手操作也非常方便。它包括一个 luer 接头 (12)（位于近端，用于冲洗导丝腔）、一个安全锁 (10)、一个滚轮 (9) 和一个回拉尾管 (11)。

生产商直接生产外周支架和导管置入系统，并根据《药品生产质量管理规范》标准，在生产过程中以及成品完工后执行所有质量控制程序。

2. 器械预期用途

自扩张型外周支架系统用于治疗影响股浅动脉和胭动脉近端的外周动脉疾病。

3. 器械适应症

本器械适用于治疗成人患者症状性 [Rutherford 2-5 级] 膝上股胭动脉狭窄。最大长度为 14 厘米的已治疗病灶的堵塞或狭窄程度必须超过 50%，是新发狭窄或再狭窄，并且之前并未使用支架进行过治疗。

4. 禁忌症

本支架禁用于以下情形：

- 被认为 PTA 或其他介入术无法治疗的病灶。
- 孕妇、哺乳期妇女。
- 病灶位于胭动脉远端三分之二处或膝关节。
- 禁止使用抗血小板和/或抗血凝治疗的临床病情。

5. 警告

- 对于对西罗莫司、脂肪酸（例如硬脂酸、棕榈酸、山嵛酸）或支架的金属组件（例如镍、钛和钽）有已知超敏或过敏症的患者，建议不要使用本器械。
- 本器械仅限一次性使用。请勿重复使用，重新加工处理或重复灭菌。否则可能使器械受到污染和/或给患者带来感染、炎症以及导致患者之间传播感染性疾病。
- 器械仅作为一个完整的系统使用。请勿单独使用其组件。
- 如果器械包装已经打开或破损，或者器械未正确储存或已过期，请勿使用。因为在这些情况下，不能保证产品无菌。
- 本器械仅限通过经皮腔内血管成形术 (PTA) 和外周支架植入术专门培训的医生使用。
- 在手术的任何阶段遇到阻力时都不要强行插入系统：请将支架系统、整个递送管、导丝和导引器作为一个整体撤回。用力过度和/或操纵不当可能导致支架意外置入或损坏放置导管。
- 在手术的任何阶段，操作不当可能会导致血管夹层、穿孔或破裂。
- 在置入过程中，请勿将支架系统向前推或向后拉：这可能会对血管壁造成严重损伤。
- 自扩张型外周支架的植入可能导致支架远端和/或近端形成血管夹层，也可能导致血管急性阻塞，需要额外的手术（外科血管置换手术、进一步扩张、置入额外的支架或其他手术）。
- 支架一旦部分展开，便无法使用递送系统恢复原状。

6. 注意事项

- 在支架开始扩张时，切勿使用快速释放系统。如有必要，只能在支架释放一半后再使用。
- 操作器械时应小心谨慎，避免接触任何金属或研磨工具，否则可能会对其造成损伤或造成机械改变。
- 准备和定位之前，器械不得接触液体。
- 本器械的放置系统不得与造影剂注射器配合使用。
- 若要一前一后地植入支架，则对应的不透射线标记应该重叠。重叠不应涉及超过两个支架。
- 如果支架出现重叠，则建议的重叠长度不超过 20 mm。
- 为了避免损坏支架，在将导丝或球囊导管或其他器械穿过已经置入的支架时，一定要非常谨慎。

7. MRI 安全信息

经非临床测试证明生产厂商的 Nitinol 支架产品系列在 MR 特定条件下是安全的。符合以下条件时，使用本器械的患者可在 MR 系统中安全进行扫描：

- 1.5-Tesla (1.5T) 或 3-Tesla (3T) 静磁场
- 6.140 G/cm (61.40 T/m) 的最高空间磁场梯度
- 所报告的最高 MR 系统，全身平均比吸收率 (SAR)：
 - 1 W/kg (正常工作模式) @ 1.5T
 - 1 W/kg (正常工作模式) @ 3T

RF 加热

在上文定义的扫描条件下，在 MR 系统进行 15 分钟的持续扫描且全身比吸收率 (SAR) 为 1.0 W/kg 的情况下，生产厂商的 Nitinol 支架产品系列预计会产生不超过 6.8°C 的温升。

1.5 T 3 T

单个支架配置	最高温度变化	≤ 6.3°C	≤ 6.2°C
重叠支架配置	最高温度变化	≤ 6.8°C	≤ 6.3°C

MRI 伪影

在非临床测试中，在 3T MRI 系统中使用梯度回波和自旋回波脉冲序列进行成像时，因器械产生的图像伪影会从生产厂商的 Nitinol 支架伸出大约 0.7 cm。

8. 包装方式

NiTIDES 器械采用无菌独立包装（使用环氧乙烷和 CO₂ 混合气体灭菌），仅限一次性使用，用两个包装袋进行包装且无需存放于无菌区。注意：内部包装袋是唯一的无菌屏障。

在包装上打印的到期日（有效期）之前，只要包装完好无损，即可保证无菌和化学稳定性。

包装内物品：— (1) 个·Carbofilm™ 涂层自扩张 Amphilimus™ (西罗莫司+脂肪酸) 洗脱外周支架系统

9. 储存

本产品应储存在包装所示的凉爽、干燥环境中，储存温度不超过 25°C。

10.型号

NiTIDES 器械使用一个型号代码和一个批号进行识别，可用的产品代码列于表 1 中。

11.给药方案

临床文献中的研究表明，在术前、术中和术后需要分别进行抗血小板治疗、抗凝治疗和抗血小板治疗。

术后阶段的抗血小板治疗包括使用以下药物：

- 噻吗并吡啶（噻氯匹啶或氯吡格雷或普拉格雷，剂量为其各自说明书中的剂量或视医疗处方而定）
- 阿司匹林，最小用量 100 mg/天，无限期

鉴于手术的复杂性以及多种影响患者病情的因素，医生需要自行决定合适的疗法。

12.药物相互作用

虽然没有具体的临床数据，但某些通过相同的结合蛋白 (FKBP) 起作用的药物（例如他克莫司）可能会影响西罗莫司的功效。西罗莫司由 CYP3A4 代谢。强效 CYP3A4 抑制剂可能会使西罗莫司暴露量升高，特别是在有多个植入物的情况下。如果患者伴随使用系统性免疫抑制药物，那么也必须考虑到西罗莫司的系统性暴露量。

13.NiTIDES 临床试验

NiTIDES 支架的主要安全性和有效性已通过上市前关键临床试验 ILLUMINA 得到确认。

研究的设计：在一项多中心单臂研究中，100 名最大病灶长度为 14cm 的有症状股腘疾病患者接受了 Nitinol 支架治疗。一期疗效（一期通畅率）和一期安全终点（主要不良事件的综合：死亡、靶肢体截肢、需要进行外科手术或手术修复靶血管，或进行临床靶病灶血管重建的靶肢体缺血，Rutherford 评分恶化了 2 级，或达到 5 级或 6 级）与 12 个月时的客观表现目标 (OPG) 进行比较。结果：手术成功率 100%。

多普勒超声结果表明，一期通畅率为 87% (77/89, 95% 置信区间 80-94)，符合 OPG (73%) 的要求。24 个月的一期通畅率为 81% (63/78)。

12 个月的一期安全终点为 96.8% (90/93)，符合 OPG (95.6%) 的要求。2.2% (2/93) 的患者进行了临床靶病灶血管重建，1.1% (1/93) 的患者死亡，靶肢体截肢的患者为 0，需要进行外科手术或手术修复靶血管的靶肢体缺血患者为 0。Rutherford 评分恶化了 2 级或达到 5 级和 6 级的患者为 0。

24 个月的一期安全终点为 87.8% (79/90)。6.7% (6/90) 的患者进行了临床靶病灶血管重建，3.3% (3/90) 的患者死亡，进行了靶肢体截肢的患者为 0，1.1% (1/90) 的患者存在需要进行外科手术或手术修复靶血管的靶肢体缺血，1.1% (1/90) 的患者的 Rutherford 评分恶化了 2 级或达到 5 级和 6 级。

14.使用说明

选择器械

请参考靶病灶的长度，以确定所需的支架长度。为了适当覆盖病灶，扩张的支架长度应至少比两侧病灶本身长 5 mm。

请参考病灶近端和远端血管的直径，以确定适当的支架尺寸。为确保支架安全放置，请使用较大的直径作为选择合适支架尺寸的基础。选择型号时，请参考表 1 中的信息。

准备器械

递送支架前，请为患者注射肝素，确定患者的活化凝血时间 (ACT) 是否足够且符合中心的操作规范。

系统准备期间，须特别小心不要让任何液体接触到支架。

- 打开包装盒，取出装有无菌包装袋的袋子。

- b) 检查包装是否有任何损坏后，打开外部非无菌铝箔袋，然后从内袋中取出物品。(注：铝箔袋和塑料内袋的外表面**并非无菌**。只有塑料袋中的物品是无菌的)。
- c) 在无菌环境下小心地将支撑架放在平面上，解开手柄周围的捆扎带，将导管从保护环中取出。
- d) 检查确认递送导管没有扭结、弯曲或其他损坏。器械损坏可能会降低其性能。
- e) 在 3 mL 注射器中充注含肝素的生理溶液，然后将注射器连接到 luer 接头进行冲洗(图 1, 第 12 项)并施加正压。继续冲洗，直到生理溶液从导管远端流出。
- f) 检查导管远端，确保支架(图 1, 第 4 项)完全被外鞘包裹。
- 如果器械已经损坏或支架已部分扩张，则请勿使用。

与附件的兼容性

直径为 6F (2.0 mm) 或更大的导引器鞘管可与 NITIDES 器械配合使用。
直径为 0.035 in (0.89 mm) 或更小的导丝可与 NITIDES 器械配合使用。导丝的刚度和尖端形状的选择取决于医生的临床经验。
如有必要使用引导导管，则系统必须与直径为 8F (2.7 mm) 或更大的引导导管兼容。在这种情况下，请在推送所选组件之前，确保止血阀完全打开。

支架插入

- a) 确保手柄上的安全锁(图 1, 第 10 项)处于锁定位置(细节 B)。
- b) 用含肝素的生理溶液清洗导丝的露出部分，以清除上面的血迹和造影剂。
- c) 沿导丝推送系统，直至支架抵达治疗部位。
- 不管在任何时候遇到异常阻力，都不要强行插入系统：将导引器、导丝和器械作为一个整体撤回。用力过度和/或操纵不当可能导致支架意外置入或损坏放置导管。

推送器械

- a) 推送系统，直至支架超出病灶区域。
- b) 将系统向后拉，直至支架刚好对准病灶区域。
- c) 检查留在患者体外的递送系统，确保该部分能自由延伸且没有弯曲。

注意：如果递送系统延伸不当，支架的置入位置可能超出靶病灶部位。

支架植入和扩张

- a) 一只手牢牢抓住手柄，检查确认支架两端的不透射线标记分别位于病灶的近端和远端。
- b) 确保导引器鞘在支架置入期间不会移动。
- c) 逆时针旋转手柄上的安全锁(图 1, 详图 B)以解锁(第 1 步)，然后将其完全拉出(第 2 步)。
- d) 握住手柄，在相对于患者的固定位置保持不动，再次检查确认不透射线标记位于相对于病灶的理想位置：用拇指沿箭头方向拨动滚轮(图 1, 第 9 项)，开始置入支架，如图 1 所示。
- e) 在荧光透视下，当支架的远端充分连接到血管壁时，继续拨动滚轮置入支架，直到支架末端张开，并且支架完全植入血管壁中。
- f) 如果需要快速置入，请按以下步骤操作：首先确保手柄后端无障碍物(如用螺丝固定的 luer 母接头)，然后用另一只手抓住器械后端(图 1, 第 11 项)往后拉，同时让手柄前部相对患者保持不动，如图 1 所示。
- g) 通过荧光透视检查确认支架完全张开。
- h) 如有必要，您还可以使用 PTA 球囊导管进一步扩张支架。在选择球囊导管的直径，以及执行进一步扩张时，请参考通过血管造影法计算得出的血管直径。无论在何种情况下，请务必特别注意不要将支架扩张至超过标签上注明的标称直径。
- i) 支架的最终直径必须适合参考血管直径。

15. 不良反应

外周支架的植入可能导致一些不良事件，包括与经皮腔内血管成形术相关的风险以及其他与支架使用相关的风险，具体如下所示。

- 入路部位感染、疼痛和血肿
- 对造影剂、手术期间所用药物或支架的制造材料有过敏或不良反应
- 动脉痉挛
- 动脉或支架血栓形成
- 股动脉瘤或假股动脉瘤
- 动脉粥样硬化远端栓塞
- 出血
- 死亡
- 已植入支架的血管出现夹层、穿孔或破裂
- 栓塞
- 肾衰竭
- 下肢缺血(需进行外科手术)
- 已植入支架的动脉再狭窄
- 支架栓塞
- 血管闭塞或未解决的狭窄

16. 责任与保修

生产厂商保证此器械之设计、制造和包装过程中已经做到最大程度之谨慎，在当前技术可用的范围内使用了最合适的技术，并在设计和制造中采用了一体化安全原则，可确保其在相应条件下能够安全使用，以及在遵守上述各段所述注意事项的前提下用于规定的用途，在各种情况下旨在尽可能降低使用本器械的相关风险，但不能完全消除这些风险。

本器械只能由专业医务人员使用，并需考虑目标治疗可能产生的其他风险及副作用和并发症，这些内容在本说明书的其他部分均有提及。

技术的复杂性、医疗选择的关键特性和运用器械的方法并不包含生产厂商对于使用器械后的效用，或对其解决残疾状态或其他病理学或其他医学问题的效用的明示或暗示保证。事实上，无论是从临床角度还是在器械的功能和持续时间方面，结果还取决于生产厂商无法控制的许多因素，其中仅作为示例引用，并非详尽无遗的患者条件：植入或使用时所进行的外科手术、打开包装后操作器械的方法。

鉴于这些因素，只有在确定器械在流通时受到缺陷影响的情况下，生产厂商才会承担责任。为此，客户必须根据法律规定的有效期和处方，立即将器械交由生产厂

商进行处置；生产厂商保留以下权利：对被认为有缺陷的器械进行检查，并确定其是否确实受到可能影响产品安全的缺陷的影响。如果出现以下情况，生产厂商不承担任何责任：(i)声称的缺陷是由于器械符合强制性规则或具有约束力的规定，和/或(ii)生产厂商发布器械时，导致损坏的缺陷尚未存在，和/或(iii)如果生产厂商发布器械时的技术和科学知识状态尚无法将器械视作有缺陷，和/或(iv)在任何其他情况下，同时不同于上述情况，其中法律明确排除或限制生产厂商对缺陷产品造成的损害的责任。该保证规定只能使用生产厂商生产的其他相同或等同类型的器械来更换有缺陷的器械。

保修仅在将器械以正确方式退回生产厂商并附上关于声称缺陷的书面详细报告时才适用，如果是已经植入的器械，则说明从患者身上取出的原因。根据没收和法定时效条款，必须立即向生产厂商报告声称的缺陷。

更换完成后，生产厂商将补偿客户因退回已确认的故障器械而产生的费用。

对于不遵守本说明书所述之使用方法和注意事项以及在包装所注有效期之后使用器械的情况，生产厂商概不承担任何责任。

此外，对因医疗选择和使用方法或应用本器械所产生的后果，生产厂商亦不承担任何责任；因此，对于应用本器械和手术者使用所选植入技术之后造成任何材料、生物或道德方面的损害，生产厂商概不负责。

代理商和生产厂商的代表均无权修改上述条件，也无权对本产品作出任何额外承诺或作出任何保证，但上述情况除外。本保证受意大利法律管辖，除非如果生产厂商已授权产品在意大利以外的一个或多个国家流通且适用其他国家的强制性法律。

BAHASA INDONESIA

NiTIDES

Sistem stent periferal mengembang mandiri berlapis *Carbofilm™* dengan elusi Amphilius™ (Sirolimus+asam lemak)

1. DESKRIPSI ALAT

Rangkaian alat NiTiDES terdiri dari stent yang dapat mengembang secara otomatis dan sistem penghantaran untuk penempatan dan pemasangan yang benar.

Stent adalah alat implan fleksibel yang dapat mengembang secara otomatis. Stent dibuat dari campuran Nikel dan Titanium (Nitinol) dan dilapisi *Carbofilm™*, lapisan karbon tipis dengan struktur turbostratik berkepadatan tinggi yang secara substansial identik dengan karbon pirolisis.

Melalui substrat akan memberikan karakteristik biokompatibel dan hemokompatibel dari karbon pirolisis, tanpa memengaruhi sifat fisik dan struktural dari substrat itu sendiri.

Enam penanda tantalum radiopak digunakan pada stent (masing-masing tiga untuk setiap ujung) untuk memungkinkan penempatan yang benar di lesi target. Permuakaan luar stent memiliki alur khusus, dilapisi sepenuhnya dengan *Carbofilm™*, untuk memuat formulasi farmasi Amphilius™, yang terdiri dari obat Sirolimus dan campuran asam lemak rantaian panjang.

Dosis obat khusus untuk permukaan pembuluh darah yang dirawat kira-kira 0,9 µg/mm², yang sesuai dengan dosis minimum sebesar 270 µg untuk stent yang lebih kecil (6,0x20 mm) dan dosis maksimum sebesar 2420 µg untuk stent yang lebih besar (8,0x150 mm).

Sistem penghantaran menggunakan tipe melalui kawat, yang memastikan bahwa stent dapat diposisikan dan dilepaskan dengan aman pada lesi. Secara skematis ditunjukkan dalam Gambar 1 dan terdiri dari:

- badan kateter (7) berdiameter 6F terdiri dari:
 - selubung luar yang dapat ditarik, distal, bagian semi-transparan (3) yang berisi stent (4); selubung memiliki kerah radiopak (13) di dekat ujung kateter;
 - lumen dalam yang terdiri dari gulungan (6) dan tabung dalam (2) kompatibel dengan kawat pemandu 0,035 inci; lumen dalam akan memanjang di sepanjang kateter mulai dari penyesuaian luer (12) yang ditempatkan secara proksimal ke pegangan dan berhenti secara distal di ujung (1) dalam bahan radiopak, sehingga memudahkan pencapaian lokasi dan penempatan stent saat dililit dari sistem pencitraan. Penghenti (5) integral dengan lumen dalam mencegah perpindahan stent akisial selama penarikan selubung luar;
 - pegangan (8) dengan sistem penghantaran, yang memungkinkan pemosisian kateter dan pemasangan stent *in situ*.
- pegangan (8) dengan sistem penghantaran, yang memungkinkan pemosisian kateter dan pemasangan stent *in situ*.

Pegangan memiliki desain ergonomis yang memungkinkan operator menggenggam dan menggunakan meski dengan satu tangan. Pegangan memiliki port luer (12) pada ujung proksimal, yang digunakan untuk menyirami lumen kawat pemandu, kunci pengaman (10), roda (9), dan ekor penarik (11). Produsen memproduksi stent periferal + sistem kateter pemasangan secara langsung dan menerapkan semua prosedur kontrol kualitas, baik selama produksi dan pada produk jadi sesuai dengan pedoman Good Manufacturing Practice.

2. PENGGUNAAN ALAT YANG DIMAKSUDKAN

Sistem stent periferal yang mengembang secara otomatis ditujukan untuk perawatan Penyakit Arteri Perifer yang menyerang arteri femoral superfisial dan arteri popliteal proksimal.

3. INDIKASI ALAT

Alat ini diindikasikan untuk perawatan stenosis arteri femoropopliteal di atas lutut pada pasien dewasa dengan gejala [kategori Rutherford 2-5]. Lesi yang dirawat, dengan panjang maksimum 14 sentimeter, harus disumbat atau dengan stenosis yang lebih besar dari 50%, de-novo atau restenotik, sebelumnya tidak dirawat dengan stent.

4. KONTRAINDIKASI

Penggunaan stent dikontraindikasikan dalam situasi berikut:

- Lesi dianggap tidak dapat dirawat dengan PTA atau teknik intervensi lainnya.
- Wanita hamil dan menyusui.
- Lesi yang berlokasi di dua distal ketiga arteri popliteal atau di sendi lutut.
- Kondisi klinis yang menghalangi penggunaan terapi anti-platelet dan/atau antikoagulan.

5. PERINGATAN

- Tidak dianjurkan untuk menggunakan alat pada pasien yang diketahui hipersensitif atau alergi terhadap Sirolimus, asam lemak (seperti asam stearat, asam palmitat, asam behenat) atau komponen logam stent (seperti Nikel, Titanium, dan Tantalum).
- Alat ini hanya digunakan untuk sekali pakai. Jangan digunakan ulang, diproses ulang, atau sterilisasi ulang. Hal ini dapat menyebabkan risiko kontaminasi pada alat dan/atau infeksi pada pasien, peradangan serta transmisi penyakit menular antarpasien.
- Alat ini dirancang untuk bekerja sebagai sistem. Jangan menggunakan komponennya secara terpisah.
- Jangan menggunakan alat jika kemasannya telah terbuka atau rusak, disimpan dengan tidak benar, atau jika telah melewati tanggal kedaluwarsa yang ditetapkan. Jika demikian, kesterilan produk tidak terjamin.
- Alat ini hanya boleh digunakan oleh dokter yang terlatih secara khusus dalam melakukan angioplasti transluminal perkutan (PTA) dan penanaman stent periferal.
- Jika ditemukan resistansi pada tahapan prosedur, jangan memaksakan sistem: tarik sistem stent dan keseluruhan kateter penghantar, kawat pemandu, dan penghantar secara bersamaan. Pemberian tekanan berlebih dan/atau penanganan yang salah dapat mengakibatkan stent terpasang secara tidak sengaja atau menyebabkan kerusakan pada kateter penempatan.

- Selama operasi, penanganan yang salah dapat menyebabkan diseksi, perforasi, atau pecahnya pembuluh darah.
- Jangan memasukkan atau menarik sistem stent selama pemasangan: hal ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada dinding pembuluh darah.
- Penanaman stent periferal yang mengembang secara otomatis dapat menyebabkan diseksi pembuluh darah secara distal dan/atau proksimal terhadap stent serta dapat menyebabkan pernyambatan akut pada pembuluh darah, sehingga diperlukan operasi tambahan (operasi bedah vaskular pengganti, dilatasi lanjut, pemasangan stent tambahan, atau prosedur lainnya).
- Setelah stent dipasang sebagian, stent tidak dapat ditarik kembali menggunakan sistem penghantar.

6. PENCEGAHAN

- Jangan pernah menggunakan sistem pelepasan cepat di awal pengembangan stent. Gunakan sistem pelepasan cepat **hanya jika diperlukan**, setelah melepaskan setidaknya **setengah panjang stent**.
- Alat harus ditangan dengan hati-hati untuk menghindari kontak dengan instrumen logam atau abrasif yang dapat merusak atau menghasilkan perubahan pada alat.
- Alat tidak boleh bersentuhan dengan cairan sebelum persiapan dan pemasian.
- Sistem penempatan alat tidak ditujukan untuk penggunaan dengan penyuntik media kontras.
- Jika stent ditanam berpasangan, penanda radiopak relatif harus saling menindih. Tidak boleh ada penyambungan pada lebih dari dua stent.
- Jika stent saling tersambung, panjang penyambungan yang disarankan adalah kurang dari 20 mm.
- Agar tidak merusak stent, berhati-hatilah setiap kali melewati kawat pemandu, kateter balon, atau alat lainnya pada stent yang telah dipasang.

7. INFORMASI KESELAMATAN MRI

Pengujian non-klinis telah menunjukkan bahwa lini produk stent Nitinol dari produsen ini adalah MR Bersyarat. Pasien dengan alat ini dapat dipindai dengan aman dalam sistem MR yang memenuhi ketentuan berikut:

- Medan magnet statis sebesar 1,5-Tesla (1,5T) atau 3-Tesla (3T)
- • Gradien medan spasial maksimum sebesar 6,140 G/cm (61,40 T/m)
- Sistem MR maksimum yang dilaporkan, rata-rata tingkat absorpsi spesifik (SAR) seluruh tubuh sebesar:
 - 1 W/kg (Mode Operasi Normal) pada 1,5T
 - 1 W/kg (Mode Operasi Normal) pada 3T

Pemanasan RF

Berdasarkan kondisi pemindaian yang ditentukan di atas, lini produk stent Nitinol dari produsen ini diperkirakan menghasilkan peningkatan suhu maksimum kurang dari 6,8 °C setelah 15 menit pemindaian berkelanjutan pada sistem MR yang dilaporkan, rata-rata tingkat absorpsi spesifik (SAR) seluruh tubuh sebesar 1,0 W/kg.

Konfigurasi Stent Tunggal	1,5 T	3 T
Perubahan suhu tertinggi	≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
Konfigurasi Stent Sambungan	≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C

Artefak MR

Dalam pengujian non-klinis, artefak gambar yang disebabkan oleh alat memanjang kira-kira 0,7 cm dari stent Nitinol produsen saat dicitrakan dengan rangkaian denyut gema spiral dan gradien-gema dalam sistem MRI 3T.

8. PENDISTRIBUSIAN

Alat NiTiDES didistribusikan dalam keadaan steril (menggunakan campuran etilen oksida dan CO₂), untuk sekali pakai, dan dikemas dalam dua kantong yang tidak boleh dibawa ke area steril. **CATATAN: kantong dalam adalah satu-satunya penghangat steril.**

Kestiran dan kestabilan bahan kimia dijamin selama kemasan tetap utuh dan sampai tanggal kedaluwarsa yang dicetak pada kemasan (TANGGAL GUNAKAN SEBELUM).

Isi satu (1) sistem stent periferal mengembang otomatis berlapis *Carbofilm™* dengan elusi Amphilius™ (Sirolimus+asam lemak)

9. PENYIMPANAN

Produk harus disimpan sebagaimana ditunjukkan pada kemasan, di tempat yang sejuk dan kering, dengan suhu penyimpanan maksimum 25 °C.

10. MODEL

Alat NiTiDES diidentifikasi dengan kode model dan nomor lot; kode produk yang tersedia tercantum pada Tabel 1.

11. REZIM OBAT

Penelitian klinis menunjukkan perlunya pemberian terapi anti-platelet sebelum operasi, terapi antikoagulan selama prosedur, dan perawatan anti-platelet setelah operasi.

Perawatan antiplatelet selama periode setelah prosedur melibatkan pemberian:

- Thienopyridine (Clopidogrel, Prasugrel) dalam dosis yang ditunjukkan pada masing-masing brosur petunjuk atau sesuai dengan resep medis)
- Aspirin dengan jumlah minimum 100 mg/hari tanpa batas Mengingat kerumitan prosedur dan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pasien, penentuan terapi yang tepat diserahkan pada kebijaksanaan dokter.

12. INTERAKSI DENGAN OBAT

Meskipun data klinis spesifik tidak tersedia, beberapa obat, seperti Takrolimus, yang bertindak melalui protein pengikat yang sama (FKBP), dapat mengganggu

keefektifan Sirolimus. Sirolimus dimetabolisme oleh CYP3A4. Inhibitor CYP3A4 yang kuat dapat menyebabkan peningkatan paparan Sirolimus, terutama jika terdapat banyak implan. Jika pasien menggunakan obat imunosupresif sistemik penyerta, paparan sistemik terhadap Sirolimus juga harus dipertimbangkan.

13. PERCOBAAN KLINIS DENGAN NITIDES

Keamanan dan keefektifan utama stent NiTiDES telah ditetapkan dari uji klinis penting pra-pasar ILLUMINA.

Kerangka studi: Dalam studi single arm di beberapa klinik, 100 pasien dengan gejala penyakit femoropopliteal dengan panjang lesi maksimum 14 cm dirawat dengan stent NiTiDES. Keefektifan primer (patensi primer) dan titik akhir keamanan primer (gabungan dari efek samping utama: kematian, amputasi anggota tubuh target, iskemia anggota tubuh target yang memerlukan intervensi bedah atau perbaikan bedah pembuluh darah target atau revascularisasi lesi target yang terjadi secara klinis, membruuknya skor Rutherford sebesar 2 kelas, atau menjadi kelas 5 atau 6) dibandingkan dengan Objective Performance Goal (OPG) selama 12 bulan.

Hasil: Keberhasilan prosedur yang diraih sebesar 100%.

Hasil USG Doppler menunjukkan patensi primer sebesar 87% (77/89, interval konfidensi 95% sebesar 80-94), memenuhi persyaratan OPG (73%). Patensi primer 24 bulan sebesar 81% (63/78).

Titik akhir keamanan primer 12 bulan sebesar 96,8% (90/93), memenuhi persyaratan OPG (19,6%), 2,2% (2/93) pasien memiliki revascularisasi lesi target yang terjadi secara klinis, 1,1% (1/93) meninggal, 0 pasien memerlukan amputasi anggota tubuh target, 0 pasien memiliki iskemia anggota tubuh target yang memerlukan intervensi bedah atau perbaikan bedah pembuluh darah target, dan 0 pasien dengan skor Rutherford memburuk sebesar dua kelas, atau menjadi kelas 5 dan 6.

Titik akhir keamanan 24 bulan sebesar 87,8% (79/90). 6,7% (6/90) pasien memiliki revascularisasi lesi target yang terjadi secara klinis, 3,3% (3/90) meninggal, 0 pasien memerlukan amputasi anggota tubuh target, 1,1 (1/90) pasien memiliki iskemia anggota tubuh target yang memerlukan intervensi bedah atau perbaikan bedah pembuluh darah target, dan 1,1 (1/90) pasien dengan skor Rutherford memburuk sebesar dua kelas, atau menjadi kelas 5 dan 6.

14. PETUNJUK PENGGUNAAN

Pemilihan alat

Lihat panjang lesi target untuk menentukan panjang stent yang diperlukan. Untuk menutup lesi dengan benar, panjang stent yang dipasang harus setidaknya 5 mm lebih panjang pada kedua sisi lesi.

Lihat diameter pembuluh darah proksimal dan distal dari lesi untuk menentukan ukuran stent yang tepat. Untuk memastikan penempatan stent yang aman, gunakan diameter yang lebih besar sebagai landasan pemilihan ukuran stent yang tepat. Saat memilih model, lihat informasi yang tercantum pada tabel 1.

Persiapan alat

Sebelum penghantaran stent, berikan heparin dan pastikan bahwa Waktu Pembekuan Teraktivasi (ACT) pasien memadai dan sesuai dengan praktik dari Pusat.

Selama persiapan sistem, berhati-hatilah agar stent tidak bersentuhan dengan cairan apa pun.

- Buka kotak dan keluaran wadah yang berisi kantong steril.
- Setelah memastikan tidak ada kerusakan pada kemasan, buka kantong aluminium foil eksternal non-steril, lalu keluarkan isinya dari kantong internal. (Catatan: Kantong aluminium foil dan permukaan luar kantong plastik dalam **TIDAK STERIL**. Hanya isi dari kantong plastik yang **STERIL**).
- Tempatkan pendukung dengan hati-hati pada permukaan datar di area steril, longgaran pita di sekitar pegangan dan lepaskan kateter dari gulungan pelindung.
- Pastikan bahwa kateter penghantaran tidak melekat, melengkung, atau memiliki kerusakan lainnya. Kerusakan pada alat dapat merusak kinerjanya.
- Isi jarum suntik 3 mL dengan larutan fisiologis berisi heparin, hubungkan penyelesaian luer untuk penyiraman (gambar 1, item 12) dan berikan tekanan positif. Lanjutkan penyiraman hingga larutan fisiologis keluar dari ujung distal kateter.
- Periksa ujung distal kateter, pastikan bahwa stent (gambar 1, item 4) tertutup sepenuhnya oleh selubung luar.

Jangan digunakan jika alat rusak atau stent mengembang sebagian.

Kesesuaian dengan aksesoris

Selubung penghantaran berdiameter 6F (2,0 mm) atau lebih dapat digunakan dengan alat NiTiDES.

Kawat pemandu 0,035 inci (0,89 mm) atau kurang dapat digunakan dengan alat NiTiDES. Pilihan kekakuan kawat pemandu dan konfigurasi ujung akan bergantung pada pengalaman klinik dokter.

Jika diperlukan penggunaan kateter pemandu, sistem kompatibel dengan kateter pemandu berdiameter 8F (2,7 mm) atau lebih. Dalam hal ini, pastikan bahwa katup hemostatik terbuka sepenuhnya sebelum memasukkan raktan yang dipilih.

Pemasangan stent

- Pastikan kunci pengaman (gambar 1, item 10) pegangan berada pada posisi terkunci (detail B).
- Bersihkan bagian luar kawat pemandu dengan larutan fisiologis berisi heparin untuk menghilangkan sisik darah dan media kontras.
- Masukkan sistem ke kawat pemandu hingga stent mencapai tempat yang akan dirawat.

Jika ditemukan resistansi tidak wajar, jangan memaksanya sistem: tarik penghantaran, kateter pemandu, dan alat secara bersamaan. Pemberian tekanan berlebihan dan/atau penanaman yang salah dapat mengakibatkan stent terpasang secara tidak sengaja atau menyebabkan kerusakan pada kateter penempatan.

Memasukkan alat

- Masukkan sistem hingga stent melewati lesi.

- Tarik kembali sistem hingga stent sejajar dengan lesi.

c) Pastikan bahwa bagian sistem penghantaran di luar tubuh pasien memanjang dengan bebas dan lurus.

Peringatan: jika sistem penghantaran tidak memanjang dengan benar, stent dapat terpasang di luar lesi target.

Penanaman dan pengembangan stent

- Genggam pegangan dengan kuat menggunakan satu tangan, pastikan penanda radiopak pada stent diposisikan secara distal dan proksimal terhadap lesi.
- Pastikan bahwa selubung penghantaran tidak bergerak selama pemasangan stent.
- Putar kunci pengaman pada pegangan berlawanan arah jarum jam (gambar 1, detail B) untuk membuka kuncinya (LANGKAH 1), lalu tarik seluruhnya ((LANGKAH 2)).
- Terkait pasien, genggam pegangan dalam posisi yang tetap. Terkait lesi, periksa sekali lagi bahwa penanda radiopak berada pada posisi yang dinginkan; mulai masukkan stent dengan memutar roda (gambar 1, item 9) menggunakan jempol Anda ke arah tanda panah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.
- Dibawah fluoroskopi, saat ujung distal stent terpasang dengan baik ke dinding pembuluh darah, lanjutkan memasukkan stent dengan memutar roda hingga ujung stent terbuka dan tertanam sepenuhnya di dinding pembuluh darah.
- Jika diperlukan pemasangan cepat, lanjutkan seperti berikut: pastikan bahwa tidak ada penghalang (misalnya penyesuaian luer betina yang disekrup) di bagian ujung belakang pegangan, genggam ujung belakang alat (tarik, gambar 1, item 11) dengan tangan Anda yang lain lalu tarik, sembari tetap memegang bagian depan pegangan yang searah dengan pasien, seperti ditunjukkan pada gambar 1.
- Pastikan dengan fluoroskopi bahwa stent telah mengembang sepenuhnya.
- Jika diperlukan, stent dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan kateter balon PTA. Dalam memilih diameter kateter balon dan melakukan pasca-pengembangan, harap lihat diameter pembuluh darah yang telah dihitung dengan menggunakan angiografi. Dalam situasi apa pun, berhati-hatilah agar tidak mengembangkan stent melebihi diameter nominalnya, yang tercantum pada label.
- Diameter akhir stent harus sesuai dengan diameter pembuluh darah acuan.

15. POTENSI TERJADINYA EFEK SAMPING

Kemungkinan efek samping yang mungkin terkait dengan penanaman stent periferal mencakup risiko terkait angioplasti transluminal perkutan dan risiko tambahan terkait dengan penggunaan stent, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

- Infeksi, nyeri, dan hematom pada tempat akses
- Reaksi alergi atau efek samping terhadap media kontras, obat yang digunakan selama prosedur, atau bahan gabungan stent
- Spasme arteri
- Trombosia arteri atau stent
- Aneurisma arteri femoral atau pseudoaneurisma
- Embolisma distal aterosklerosis
- Pendarahan
- Kematian
- Diseksi, perforasi, atau pecahnya pembuluh yang ditanami stent
- Embolisme
- Gagal ginjal
- Iskemia anggota tubuh bagian bawah (memerlukan intervensi bedah)
- Restenosis pada arteri tempat stent ditanam
- Embolisme stent
- Oklusi pembuluh darah atau stenosis yang tidak tertangani

16. PERTANGGUNGJAWABAN DAN GARANSI

Produsen memastikan bahwa alat ini telah dirancang, diproduksi, dan dikemas dengan sangat hati-hati menggunakan teknik yang dianggap paling sesuai di antara teknik yang tersedia dalam kondisi teknologi saat ini dan menerapkan prinsip integrasi keamanan dalam desain dan pembuatan untuk memastikan penggunaan yang aman saat alat digunakan pada kondisi dan tujuan yang dimaksudkan terkait dengan pencegahan yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dan dalam keadaan apa pun ditujukan untuk mengurangi sejauh mungkin, tetapi tidak menghilangkan sepenuhnya, risiko yang terkait dengan penggunaan alat.

Alat hanya boleh digunakan di bawah tanggung jawab personel medis spesialis dan mempertimbangkan risiko residual serta kemungkinan efek samping dan komplikasi dari terapi yang dimaksud, termasuk yang telah disebutkan di bagian lain dari buku petunjuk ini.

Kerumitan teknik, sifat kritis dari pilihan medis, serta pilihan dan metode penggunaan alat tidak termasuk garansi dari Produsen, tersurat atau tersirat, atas keefektifan hasil setelah penggunaan alat, atau keefektifannya dalam mengatasi cacat, atau patologi atau masalah medis lainnya. Kenyataannya, baik dari sudut pandang klinik, maupun dalam hal fungksionalitas dan durasi alat, hasinya juga bergantung pada berbagai faktor yang berada di luar kendali produsen, yang di antaranya hanya disebutkan sebagai contoh dan bukan kondisi lengkap dari pasien, prosedur pembedahan penanaman atau penggunaan, metode manipulasi alat setelah membuka kemasan.

Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, produsen hanya bertanggung jawab jika telah dipastikan bahwa alat tersebut cacat pada saat diedarkan. Untuk tujuan ini, Pelanggan harus segera menyerahkan alat kepada Produsen, sesuai dengan ketentuan keduawarsa dan keputusan yang diwajibkan oleh hukum; Produsen berhak untuk memeriksa alat yang dianggap rusak dan menentukan apakah alat tersebut benar-benar cacat yang dapat memengaruhi keamanan produk. Tanggung jawab produsen dikecualikan jika (i) cacat yang diklaim disebabkan oleh kepatuhan alat dengan aturan wajib atau ketentuan yang mengikat, dan/atau (ii) cacat yang menyebabkan kerusakan tidak ada saat Produsen mengeluarkan alat dan/atau (iii) jika keadaan pengetahuan teknis dan ilmiah pada saat Produsen mengeluarkan alat, belum memungkinkan untuk menganggap alat tersebut cacat,

dan/atau (iv) dalam hal lain, juga berbeda dari yang dinyatakan di atas, yang dikecualikan hukum secara tersurat, atau dibatasi, tanggung jawab Produsen atas kerusakan dari produk yang cacat. Garansi secara khusus berupa penggantian alat yang cacat dengan jenis alat lain yang sama atau setara dari produsen. Garansi hanya berlaku jika alat dikembalikan dengan benar kepada produsen bersama dengan laporan tertulis dan tepercaya mengenai cacat yang diklaim dan, dalam kasus alat implan, tentang alasan pelepasan dari pasien. Cacat yang diklaim harus segera dilaporkan kepada Produsen sesuai dengan ketentuan penyataan dan keputusan undang-undang.

Setelah penggantian dilakukan, Produsen akan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pelanggan untuk pengembalian alat yang diakui cacat.

Produsen menolak segala tanggung jawab jika terjadi kegagalan dalam mengamati metode penggunaan dan tindakan pencegahan yang telah dinyatakan dalam buku petunjuk ini, serta jika terjadi penggunaan alat setelah tanggal kadaluwarsa yang tertera pada kemasan.

Selain itu, Produsen menolak segala tanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan medis dan metode penggunaan atau penerapan alat; oleh karena itu, dalam keadaaan apa pun Produsen tidak akan dituntut atas kerusakan material, biologis, atau moral apa pun, setelah aplikasi alat dan pilihan teknik penanaman yang digunakan oleh operator.

Agen dan perwakilan Produsen tidak berwenang untuk mengubah segala ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, membuat komitmen tambahan, atau menawarkan garansi apa pun yang terkait dengan produk ini, selain ketentuan yang telah disebutkan di atas. Garansi ini diatur oleh undang-undang Italia, kecuali undang-undang wajib negara lain diterapkan, jika Produsen telah mengesahkan peredaran produk di satu atau lebih negara selain Italia.

УКРАЇНСЬКИЙ

NiTIDES

Система периферійного саморозширюваного стента, що виділяє Amphilimus™ (сиролімус + жирну кислоту), з покриттям Carbofilm™

1. ОПИС ПРИСТРОЮ

Лінійка пристріїв NiTiDES складається із саморозширюваного стента й системи доставки для його належного розташування та розгортання.

Стент являє собою гнукий, саморозширюваний і придатний для імплантації пристрій. Його виготовлено зі сплаву нікелю та титану (нітінолу) та вкрито покриттям Carbofilm™, тонким шаром вулпеща з турбостратною кристалічною структурою високої щільності, практично ідентичною до структури піролітичного вулпеща.

Покриття надає субстрату біо- та гемосумісні характеристики піролітичного вулпеща, не впливаючи на фізичні та структурні властивості власне субстрату. На стент нанесені шість рентгенконтрастних танталових маркерів (по три з кожного кінця), що дозволяють належним чином розташувати його в місці цільового ураження.

Зовнішня поверхня стента має спеціальні борозени, повністю вкриті матеріалом Carbofilm™, що містить фармацевтичну сполуку Amphilimus™, яка складається з лікарського препарату сиролімусу й суміші довголанцюгових жирних кислот.

Конкретна доза препарату для поверхні судини, що підлягає лікуванню, складає приблизно 0,9 мкг/мм², що відповідає мінімальний дозі 270 мкг для маленького стента (6,0 × 20 мм) та максимальний дозі 2 420 мкг для великого стента (8,0 × 150 мм).

Система доставки, що використовується, є провідникою і забезпечує безпечно розташування та вивільнення стента в місці ураження. Її схему наведено на рис. 1, вона складається з:

- корпусу катетера (7) діаметром 6F, що складається з:
 - в'язкої зовнішньої канюлі, дистальна напівпрозора ділянка якої (3) містить стент (4); канюла має рентгенконтрастне кільце (13) поблизу кінчика катетера;
 - внутрішнього канала, що складається з котушки (6) та внутрішньої трубки (2), сумісної з дротовим провідником діаметром 0,035 дюйма; внутрішній канал проходить повзводом катетера від роз'єму Люера (12), закріпленим проксимально на ручці, та закінчується дистально на кінчику (1) з рентгенконтрастного матеріалу, що полегшує розташування та розміщення стента під контролем системи візуалізації. Обмежуєвач (5), вбудований у внутрішній канал, запобігає осьовому зсуєнню стента під час втягування зовнішньої канюлі;
 - ручки (8) із системою доставки, що дозволяє розміщувати катетер і розкривати стент у місці ураження.

Ручка має ергономічний дизайн, тому хірург може утримувати її та працювати з нею навіть однією рукою. На її проксимальному кінці розташовані: роз'єм Люера (12), який використовується для промивання просвіти провідника, запобіжний клюп (10), коліщатко (9) та відтяжка задня частина (11).

Виробник безпосередньо виготовляє периферійний стент і систему розміщення катетера, а також виконує всі процедури контролю якості під час виробництва та якості кінцевого продукту відповідно до норм належної виробничої практики.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

Система саморозширюваного периферійного стента призначена для лікування захворювання периферійної артерії, яке негативно впливає на поверхневу стегнову артерію та проксимальну ділянку підколінної артерії.

3. ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Пристрій показаний для лікування стеноzu артерій стегново-підколінного сегмента вище коліна в дорослих пацієнтів із симптомами [категорія 2–5 за Rutherford]. Місце ураження для лікування повинно мати довжину не більше 14 см, оклюзію або стеноz вище 50 %, уперше виявлені або повторні, які раніше не лікували за допомогою стента.

4. ПРОТИПОКАЗАННЯ

Використання стента протипоказано в таких ситуаціях:

- Ураження вважаються невиліковними за допомогою ЧТА або інших хірургічних методик.
- Жінки, що годують грудю, або вагітні жінки.
- Ураження, локалізовані на двох дистальних третинах підколінної артерії або поряд із колінним суглобом.
- Клінічні стани, що переважають застосуванню антиагрегаційної та/або антикоагуляційної терапії.

5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використання пристрою не рекомендуються в пацієнтів із відомою підвищеною чутливістю або алергією до сиролімусу, жирних кислот (як-от стерапінової, пальмітінової та бегеневої кислоти) або металевих компонентів стента (таких, як нікель, титан і tantal).
- Пристрій призначений лише для одноразового використання. Заборонено використовувати, обробляти чи стерилізувати його повторно. Це призводить до ризику забруднення пристрою та/або інфікування пацієнта, запалення та передачі інфекційних захворювань від пацієнта до пацієнта.
- Пристрій розроблено для функціонування як системи. Не використовуйте його компоненти окремо.
- Не використовуйте пристрій, якщо його упаковку було розкрито або пошкоджено, якщо його зберігали неналежним чином або якщо минула зазначена дата закінчення строку придатності. У таких випадках стерильність продукту не гарантується.
- Пристрій повинен використовуватися лікарями, що пройшли спеціальне

- навчання з виконання черезшикарної трансплюмінальної ангіопластики (ЧТА) та імплантування периферійних стентів.
- Якщо в будь-який момент під час процедури введення виникне опір, не прикладайте до системи зусиль: витягніть систему стента й увесь катетер для доставки, дротовий провідник та інтродьюсер як одне ціле. Докладання надмірних зусиль та/або невірне маніпулювання може привести до випадкового розміщення стента або спричинити пошкодження катетера для розміщення.
 - У будь-який момент під час операції неправильне маніпулювання може привести до розшарування, перфорації або розриву судини.
 - Забороняється просувати або витягувати стентову систему під час розкриття — це може привести до серйозного пошкодження стінок судин.
 - Імплантання саморозширяючогося периферійного стента може викликати розшарування дистальній та/або проксимальної частини судини (відносно стента), а також гостру оклюзію судини, що приведе до необхідності виконання додаткової операції (хірургічного втручання із заміни судини, подальшого розширення, розміщення додаткових стентів або інших процедур).
 - Після часткового розширення стента його неможливо витягнути за допомогою системи доставки.

6. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Ніколи не використовуйте** систему швидкого вивільнення на початку розширення стента. Використовуйте її **лише за необхідності**, після вивільнення щонахімніше **половини довжини** стента.
- З пристроям необхідно поводитися обережно, щоб уникнути будь-якого контакту з металевими або абразивними інструментами, які можуть його пошкодити або механічно змінити.
- Пристрій не повинен контактувати з будь-якими рідинами до підготовки й розширення.
- Систему розміщення пристрою не призначено для використання з ін'єкторами контрастної речовини.
- У разі імплантання стентів один поряд з іншим відповідні рентгеноконтрастні маркери повинні перетинатися. Накладання більше двох стентів забороняється.
- У разі накладання стентів рекомендується, щоб довжина накладання становила менше 20 мм.
- Щоб запобігти ушкодженню стента, будьте дуже обережні щораз, коли проводите дротовий провідник, баллонний катетер або інший пристрій крізь стент, який щойно було розгорнуто.

7. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ МРТ-СКАНУВАННЯ

- Доклінічні випробування продемонстрували, що лінійки нітінолових стентів виробника є МР-сумісними за певних умов. Пациєнт із цим пристроям може безпечно проходити сканування в МР-системах, якщо виконуються такі умови:
- Статичне магнітне pole 1,5 тесла (1,5 Тл) або 3 тесла (3 Тл).
 - Максимальний просторовий градієнт поля 6 140 Гс/м (6,140 Тл/м).
 - Усереднений (для всієї поверхні тіла) питомий коефіцієнт поглинання, визначений для МР-систем (максимум):
 - Bt/kg (звичайний режим роботи) за 1,5 Тл.
 - Bt/kg (звичайний режим роботи) за 3 Тл.

РЧ-нагрівання

За визначених вище умов сканування очікується, що лінійки нітінолових стентів виробника створять максимальне підвищення температури менше 6,8 °C після 15 хвилин безперервного сканування в зазначеній МР-системі, при цьому усереднений (для всієї поверхні тіла) питомий коефіцієнт поглинання складе 1,0 Bт/кг.

	1,5 Тл	3 Тл
Конфігурація з одним стентом Найвища зміна температури	≤ 6,3 °C	≤ 6,2 °C
Конфігурація з накладанням стентів Найвища зміна температури	≤ 6,8 °C	≤ 6,3 °C

Артефакт МР-зображення

У доклінічних випробуваннях артефакт зображення, обумовлений пристроям, простягався приблизно на 0,7 см від нітінолових стентів виробника під час сканування з послідовністю імпульсів градієнтного відлучння й спінового відлуння в МР-системі 3 Тл.

8. ЯК ПОСТАЧАЄТЬСЯ

Пристрій NiTiDES постачається в стерильному вигляді (стерилізація відбувається з використанням суміші етиленоксиду та CO₂), для одноразового використання, у двох пакетах, які не можна приносити до стерильного поля.

ПРИМІТКА. Внутрішній пакет є єдиним стерильним бар'єром.

Стерильність і хімічна стабільність гарантується, доки пакет залишається неушкодженим, до дати закінчення строку придатності, надрукованого на упаковці (ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ПРИДАТНОСТІ).

Вміст: 1 (одна) система периферійного саморозширяючогося стента, що виділяє Amphilius™ (сиролімус + жирну кислоту), з покриттям Carbofil™

9. ЗБЕРІГАННЯ

Виріб потрібно зберігати, як зазначено на упаковці, у прохолодному сухому місці за температурою макс. 25 °C.

10. МОДЕЛІ

Кожний пристрій NiTiDES позначається кодом моделі та номером партії; доступні коди виробів перелічені в таблиці 1.

11. РЕЖИМ УВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТИВ

Дослідження в клінічній літературі вказують на необхідність проведення антитромбоцитарної терапії до процедури, антикоагуляційної терапії під час процедури та антитромбоцитарного лікування після процедури.

Антитромбоцитарне лікування після процедури включає введення:

- тіенопіридину (типоліпідину, клоподегрелю або прасугрелю в дозах, зазначених у відповідних буклетах з інструкціями або згідно з назначенням лікаря);
- аспірину в мінімальній дозі 100 мг/день протягом невизначеного терміну. Оскільки процедура складна, а на стан пацієнта впливають численні фактори, визначення необхідної терапії залишається на розсуд лікаря.

12. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Хоча не існує конкретних клінічних даних, певні препарати, наприклад таクロлімус, що діють за допомогою такого самого з'язувального білка (FKBP), можуть знижити ефективність сиролімусу. Сиролімус метаболізується за допомогою CYP3A4. Потужні інгібтори CYP3A4 можуть привести до більш інтенсивної дії сиролімусу, особливо в разі імплантання декількох стентів. Також необхідно розглянути вірогідність системного впливу сиролімусу, якщо пацієнт одночасно приймає системні імунодепресивні препарати.

13. КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ З NITIDES

Найважливіші дані про безпечності і ефективність стента NiTiDES були отримані в результаті передреєстраційного опорного клінічного дослідження ILLUMINA.

Дизайн дослідження. Під час багатоцентрового дослідження в одній групі 100 пацієнтів із симптоматичними захворюваннями стегново-підколінних сегментів з ураженнями максимальної довжини 14 см проходили лікування стентом NiTiDES. Первінні дані про ефективність (первинний розкритий стан судини) і кінцеву точку безпеки (скупність значних суттєвих небажаних явищ, до яких відносяться: смерть, ампутація цільової кінцевки, ішемія цільової кінцевки з необхідністю хірургічного втручання чи хірургічної корекції цільової судини або клінічної реваскуляризації цільового ураження, з погрішенням категорії за Rutherford на 2 класи або до класу 5 чи 6) порівнювали із цільовим плановим показником для 12 місяців.

Результати. Процедура була успішною в 100 % випадків. Результати додлероскопії демонструють первинний розкритий стан судини 87 % (77/89, 95 % довірчий інтервал 80—94), що відповідає вимогам цільового планового показника (73 %). Первінний розкритий стан судини через 24 місяці склав 81 % (63/78).

Первинна кінцева точка безпеки для 12 місяців склала 96,8 % (90/93), що відповідає вимогам цільового планового показника (19,6 %), 2,2 % (2/93) пацієнтів пройшли клінічну реваскуляризацію цільового ураження, 1,1 % (1/93) померли, 0 пройшли ампутацію цільової кінцевки, у 0 виникла ішемія цільової кінцевки з потребою в хірургічному втручанні чи хірургічному відновленні цільової судини, і в 0 погіршилася категорія за Rutherford на два класи або до класу 5 чи 6.

Кінцева точка безпеки для 24 місяців склала 87,8 % (79/90). 6,7 % (6/90) пацієнтів пройшли клінічну реваскуляризацію цільового ураження, 3,3 % (3/90) померли, 0 пройшли ампутацію цільової кінцевки, у 1,1 % (1/90) виникла ішемія цільової кінцевки з потребою в хірургічному втручанні чи хірургічному відновленні цільової судини, і в 1,1 % (1/90) погіршилася категорія за Rutherford на два класи або до класу 5 чи 6.

14. ВКЛАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ

Вибір пристроя

Урахуйте довжину цільового ураження для визначення необхідної довжини стента. Щоб приблизно покрити ураження, довжина розкритого стента повинна бути як мінімум на 5 мм більше, ніж ураження, з обох сторін.

Урахуйте діаметр судини в проксимальному та дистальному напрямку від ураження для визначення відповідного розміру стента. Щоб забезпечити безпечно розміщення стента, підбираєте розмір стента, використовуючи більший діаметр як основний. Обираючи модель, урахуйте інформацію, що міститься в таблиці 1.

Підготування пристрою

Перед установленням стента призначте гепарин і переконайтесь, що активований час згортання крові (АЧЗК) пацієнта відповідає прийнятим в установі стандартам.

Під час підготування системи уважно стежте за тим, щоб на стент не потрапляла рідина.

A. Відкрийте коробку та витягніть упаковку, що містить стерильний пакет. B. Перевірівши упаковку на відсутність пошкоджень, відкрийте зовнішній нестерильний пакет з алюмінієвої фольги й витягніть віміст із внутрішнього пакета. (Примітка. Пакет з алюмінієвої фольги й зовнішня поверхня внутрішнього пластикового пакета **НЕ СТЕРИЛЬНІ**. СТЕРИЛЬНИЙ тільки вміст пластикового пакета.)

C. Обережно розташуйте кріплення на рівній поверхні в стерильному полі, відстегніть ремінь навколо ручки та витягніть катетер із захисної котушки.

D. Переконайтесь, що катетер для введення не має перекручен, згинів чи інших ушкоджень. Пошкодження пристрою може негативно вплинути на його функціонування.

E. Заповніть шприц на 3 мл фізіологічним розчином, що містить гепарин, під'єднайте роз'єм Льюїра для промивання (рис. 1, поз. 12) та застосуйте позитивний тиск. Продовжуйте промивання, доки фізіологічний розчин не почне витикати з дистального кінця катетера.

F. Перевірте дистальний кінець катетера, переконавшись, що стент (рис. 1, поз. 4) повністю закритий зовнішньою канюлею.

Не використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений або якщо стент частково розшириений.

Сумісність з аксесуарами

З пристроєм NiTiDES можна використовувати канюлі інтродьюсера діаметром 6F (2,0 мм) або більше.

З пристроєм NiTiDES можна використовувати провідники розміром 0,035 дюйма (0,89 мм) або менше. Вибір жорсткості та конфігурації кінчика дротового провідника залежить від клінічного досвіду лікаря.

Якщо знадобиться використовувати провідниковий катетер, слід ураховувати, що системи сумісні з провідниковими катетерами діаметром 8F (2,7 мм) або більше. У такому разі перед введенням вибраного блока переконайтесь, що гемостатичний клапан повністю відкритий.

Введення стента

- A. Переконайтесь, що запобіжний ключ (рис. 1, поз. 10) ручки перебуває в позиції блокування (деталь В).
 - Б. Промігніть відкриту частину дротового провідника фізіологічним розчином, що містить гепарин, для видалення з неї слідів крові та контрастної речовини.
 - В. Введіть систему по дротовому провіднику, доки стент не досягне ділянки, що підлягає лікуванню.
- Якщо в будь-який момент під час процедури введення виникне незвичний опір, не прикладайте до системи зусиль: витягніть інтродьюсер, провідниковий катетер та пристрій як одніє ціле. Докладання надмірних зусиль та/або невірне маніпулювання може привести до випадкового розміщення стента або спричинити пошкодження катетера для розміщення.

Введення пристрію

- A. Введіть систему до точки, у якій стент пройде ураження.
- Б. Підтягніть систему назад, щоб стент опинився на одному рівні з ураженням.
- В. Переконайтесь, що частина системи доставки за межами тіла пацієнта вільно розпрацьована і прямі.

Увага: якщо систему доставки не вигримлено належним чином, стент може бути розміщено за межами цільового ураження.

Імплантация та розширення стента

- A. Міцно утримуючи ручку однією рукою, переконайтесь, що рентгенконтрастні маркери на стенті розташовані проксимально та дистально відносно ураження.
- Б. Переконайтесь, що зовнішня канюля інтродьюсера не рухається під час розміщення стента.
- В. Поверніть запобіжний ключ на ручці проти годинникової стрілки (рис. 1, деталь В) для розблокування (KРОК 1), потім повністю витягніть його (KРОК 2).
- Г. Утримуючи ручку у фіксованому положенні відносно пацієнта, ще раз переконайтесь, що рентгенконтрастні маркери знаходяться в необхідному положенні стосовно ураження; почніть розміщувати стент, обертаючи коліщатко, доки кінець стента не розкриється та його не буде повністю імплантовано в стінки судини.
- Д. Під рентгеноскопічним контролем, коли дистальний кінець стента добре прикріплене до стінок судини, продовжуйте розміщення, обертаючи коліщатко, доки кінець стента не розкриється та його не буде повністю імплантовано в стінки судини.
- Е. За необхідності швидкого розширення виконайте такі дії: переконайтесь у відсутності перешкод (наприклад, різьбового гніздового роз'єму Люера) у задньому кінці ручки, візміться за задню частину пристрою (потягніть назад, рис. 1, поз. 11) іншою рукою, утримуючи передню частину ручки абсолютно нерухомо відносно пацієнта, як показано на рис. 1.
- Є. За допомогою рентгеноскопічної перевірте, чи повністю розширеній стент.
- Ж. Стент можна розширити більше, якщо необхідно, використовуючи балонний катетер для ЧТА. Обираючи діаметр балонного катетера та виконуючи розширення після процедури, урахуйте діаметр судини, визначений за допомогою ангиографії. У будь-якому разі будьте дуже уважні, щоб не розширити стент до діаметра більше номінального, зазначеного на етикетці.

И. Кінцевий діаметр стента повинен відповідати належному діаметру судини.

15.МОЖЛИВІ НЕБАЖАНІ ЯВИЩА

Можливі небажані явища, які можуть бути пов'язані з імплантуванням периферійного стента, включають ризики, пов'язані із черезезшіркою трансплумінальною ангіопластикою, а також додаткові ризики, пов'язані з використанням стента, як указано нижче.

- Інфекція, біль і гематома в місці доступу.
- Алергічна або небажана реакція (на контрастну речовину, препарати, що використовуються під час процедури, або матеріали, що використовуються для виготовлення стента).
- Артеріальний спазм.
- Артеріальний або стентовий тромбоз.
- Аневризма або псевдоаневризма стегнової артерії.
- Атеросклеротична дистальна емболія.
- Кровотеча.
- Смерть.
- Розшарування, перфорація або розрив стентованої судини.
- Емболія.
- Ниркова недостатність.
- Ішемія нижніх кінцівок (що потребує хірургічного втручання).
- Рестеноз артерії, у яку було імплантовано стент.
- Емболізація стента.
- Оклюзія судини або неусунений стеноz.

15.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ГАРАНТІЯ

Виробник гарантує, що цей пристрій було розроблено, виготовлено й упаковано з максимальною ретельністю та використанням методик, які вважаються найбільш придатними серед доступних на сучасному рівні розвитку технологій, а також із застосуванням принципів інтеграції безпеки в проектуванні й виготовленні, що гарантує його безпечне використання за зазначених умов і в зазначених цілях у разі вживання заходів, описаних у попередніх параграфах, і в будь-якому випадку націлений на максимальне зниження ризиків, пов'язаних із використанням пристрію, хоча повністю їх виключити неможливо.

Пристрій необхідно використовувати виключно під відповідальність медпрацівника-спеціаліста, ураховуючи всі залишкові ризики та можливі побічні ефекти й ускладнення лікування, для якого призначений пристрій, окремо описані в інших розділах цього буклета-інструкції.

Технічна складність, критичний характер вибору лікування та способи використання пристрію виключають будь-яку відповідальність виробника, пряму або таку, що передбачається, за ефективність використання пристрію або ефективність усунення за його допомогою порушення функцій чи інших патологічних або медичних проблем. Фактично результати як із лінічної точки зору, так і щодо функціональності й тривалості застосування пристрію залежать також від численних чинників, які не контролюються виробником, зокрема таких: стан пацієнта, хірургічна процедура імплантації або використання, методи поведінки з пристрієм після відкриття упаковки.

З урахуванням згаданих чинників відповідальність виробника виникає, тільки якщо було підтверджено, що на пристрій негативно вплинули дефекти під час випуску. Для цього Замовник повинен оперативно надати пристрій у розпорядження Виробнику з дотриманням термінів і правил законодавства; Виробник зберігає за собою права перевірити пристрій, зазначений як несправний, і з'ясувати, чи дійсно на цей пристрій негативно вплинули дефекти, які могли позначитися на безпеці виробу. Відповідальність Виробника виключається, якщо: (i) заявлені дефекти виник через дотримання необхідного правила чи зобов'язуючого положення, яке розповсюджується на пристрій, і/або (ii) дефект, що став причиною пошкодження, не існував на момент випуску пристрію Виробником, і/або (iii) якщо технічні та наукові знання, що існували на момент випуску пристрію Виробником, не дозволяли вважати пристрій дефектним, і/або (iv) у будь-якому іншому випадку, що також відрізняється від перерахованих вище, у якому законодавство явно виключає або обмежує відповідальність Виробника за шкоду, завдану дефективними виробами. Гарантійні зобов'язання полягають виключно в заміні дефектного пристроя на такий самий пристрій або його еквівалент, що випускається цим виробником.

Гарантія застосовується, тільки якщо пристрій правильно повернуто виробнику разом із письмовим докладним звітом про заявлені дефекти, а в разі імплантації пристрію — з викладенням причин його виміння з пацієнта. Про заявлені дефекти необхідно оперативно повідомляти Виробнику з дотриманням умов відчуження та правил законодавства.

Після заміни Виробник зобов'язується відшкодувати Замовнику витрати, понесені на повернення пристроя, визнаного несправним. Виробник повністю відмовляється від відповідальності в усіх випадках, якщо не були дотримані способи використання та запобіжні заходи, викладені в цій інструкції, або якщо пристрій використовували після терміну дії, зазначеного на упаковці.

Крім того, Виробник не бере на себе жодної відповідальності щодо наслідків медичного вибору й способів використання або застосування пристрію і тому в жодному разі не може бути притягнитий до відповідальності за будь-які збитки будь-якого характеру, матеріальні, біологічні або моральні, що виникли в результаті застосування пристрію і вибору техніки імплантації, використаної хірургом.

Агенти та представники Виробника не мають права вносити зміни в будь-які вищезгадані умови, брати будь-які інші зобов'язання або давати інші гарантії на цей продукт, окрім зазначених вище. Ця гарантія регулюється законодавством Італії, якщо не застосовується обов'язкові закони іншої держави, коли Виробник уповноважений постачати виріб в одну або більше інших держав, окрім Італії.

BLANK PAGE

BLANK PAGE

BLANK PAGE



Amphilimus™(Sirolimus + Fatty Acid)
eluting Peripheral Self-Expanding stent

MGD

Maximum guidewire diameter / Diamètre maximum du fil-guide / Höchstdurchmesser Führungsdräht / Diametro massimo filo guida / Diámetro máximo del hilo guía / Maksimal diameter af guidewire / Diámetro máximo do fio-guia / Ohjausjänne enimmäiskalaisija / Maximal diameter mandräng / Maximum diameter voerdraad / Mέγιστη διάμετρος σύριγκα / Maksimum kilaav tel çapı / Maximální průměr vodivého drátu / Juhttraadi maksimaalne läbimõõt / Vezetődrót maximális átmérője / Maksimalais valitájstigas / Maksimalus kreipiamošios vienos skersmuo / Maximálny premer vodiaceho drútu / Največji premer vodilne žice / Maksimal ledaveiderdiámetre / Maksimalen dijametar na vodenčata žica / Maksimalni prečnik vodilice / Maksimalni promjer žice vodilice / Diametrul maxim al firului de ghidaj / Maksymalna średnica prowadnika / Maksimalen dijametar na vodacha / Maksimalnyj dijametр проводника / 最大导丝直径 / Diameter maksimum kawat pemandu / Maksymalnyj dijametр drogovogo provodnika

MSS

Minimum introducer size / Dimensions minimum de l'introducteur / Mindestgröße der Einführungsschleuse / Dimensione minima dell'introduttore / Tamaño mínimo del introductor / Minimal storrelse af indføringsanordning / Tamaño mínimo do introdutor / Sisälaivintieniholkin vähimäiskoko / Minimal storlek införare / Minimum maat introducer / Ελάχιστο μέγεθος εισογωγέα / Minimum introducer büyüklüğü / Minimální velikost zaváděcího pouzdra / Sisesti minimaalne suurus / A bevezetőhüvely minimális mérete / Minimális leívadítája izmērs / Minimalus įterpimo ītaiso dydis / Minimalna velkost zavádzacá / Najmanjsa velikost uvajalnika / Minimum innføringsenhets-storrelse / Minimalna golenjina na voveduvachot / Minimalna veličina uvodnika / Minimalna veličina uvodnice / Dimensiunea minima a teții de introducere / Minimalny rozmiar cewnika prowadzącego / Minimalen размер на интродюсера / Minimalnyj razmer introdyosera / 最小導引器尺寸 / Ukuran minimum penghantar / Mínimalnyj rozmiр інтродьюсера

UCL

Usable catheter length / Longueur utilisable du cathéter / Verwendbare Katheterlänge / Lunghezza utile catetere / Longitud útil del catéter / Anwendbarer Kateterlänge / Comprimento útil do cateter / Katetren käytettävä pituus / Användbar kateterlängd / Brukbare kateterlengde / Διαθέσιμη μήκος καθετήρα / Kullanılabilir introdüsör uzunluğu / Vyuzitelná délka katétru / Kasutatava kateetri pikkus / Hasznos katéterhossz / Izmantojamais katetra garums / Naudingasis katetori ilgis / Použitelná délka katétra / Uprabna dolžina katetra / Brukbar kateterlengde / Используемая длина катетера / Upotrebiva dužina katetera / Upotrebljiva dužina katetera / Lungimea utilizabilă a cateterului / Użytkowa długość cewnika / Извлекаема дължина на катетра / Рабочая длина катетера / 可用导管长度 / Panjang kateter yang dapat digunakan / Робоча довжина катетера

TABLE 1

Usable Catheter Length (UCL)		Unconstrained Stent Diameter (mm)	Vessel Diameter (mm)	Nominal Stent Length (mm)
85 cm	135 cm			
ICNI6020S	ICNI6020L	6.0	4-5	20
ICNI6040S	ICNI6040L	6.0	4-5	40
ICNI6060S	ICNI6060L	6.0	4-5	60
ICNI6080S	ICNI6080L	6.0	4-5	80
ICNI6100S	ICNI6100L	6.0	4-5	100
ICNI6120S	ICNI6120L	6.0	4-5	120
ICNI6150S	ICNI6150L	6.0	4-5	150
ICNI7020S	ICNI7020L	7.0	5-6	20
ICNI7040S	ICNI7040L	7.0	5-6	40
ICNI7060S	ICNI7060L	7.0	5-6	60
ICNI7080S	ICNI7080L	7.0	5-6	80
ICNI70100S	ICNI70100L	7.0	5-6	100
ICNI70120S	ICNI70120L	7.0	5-6	120
ICNI70150S	ICNI70150L	7.0	5-6	150
ICNI8020S	ICNI8020L	8.0	6-7	20
ICNI8040S	ICNI8040L	8.0	6-7	40
ICNI8060S	ICNI8060L	8.0	6-7	60
ICNI8080S	ICNI8080L	8.0	6-7	80
ICNI80100S	ICNI80100L	8.0	6-7	100
ICNI80120S	ICNI80120L	8.0	6-7	120
ICNI80150S	ICNI80150L	8.0	6-7	150

